



Kosmos sur iOS et Android

Manuel d'utilisation



CHAPITRE 1**Mise en route 1**

- Quelles sont les nouveautés de cette version ? 1
 - Fonctionnalités publiées précédemment 1*
- Contenu de la boîte 2
- Utilisateurs visés 3
- Utilisation prévue/Consignes d'utilisation 3
 - Contre-indications 6*
- Avertissements et mises en garde généraux 6
- Manuel d'utilisation 8
 - Symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation 9*
 - Conventions utilisées dans le manuel d'utilisation 9*
- Service clientèle EchoNous 10

CHAPITRE 2**Présentation du système
KOSMOS 11**

- En quoi consiste le système Kosmos ? 11
- Applications cliniques du système Kosmos 13
- Formation 14
- Classifications du système Kosmos 14
- Environnement du patient 15

CHAPITRE 3**Utilisation du système Kosmos 17**

- Présentation du système 17
 - Exigences de l'appareil 17*
- Matériel Kosmos 18
 - Kosmos Torso-One 19*
 - Kosmos Lexsa 19*
 - Kosmos Power Pack 19*
 - Charge avec adaptateur SW125-12-n CUI Inc. 19*
- Mise en route 20
 - Téléchargement de l'application EchoNous Kosmos
Ultrasound 20*
 - Branchement des sondes Kosmos 21*

Kosmos Power Pack pour Android	21
Configuration du Kosmos Power Pack	22
Démontage du Power Pack	23
Charge du Kosmos Power Pack	23
Interaction générale	25
Écran d'accueil : Kosmos Torso-One	25
Écran d'accueil : Kosmos Lexsa	25
Apprendre	25
Paramètres	26
Préférences d'imagerie	26
À propos de	28
DICOM	28
Gestion de MWL	31
Exportation USB	33
Paramètres de rapport	33
Fonctions	33
Caractéristiques techniques de connexion	34

CHAPITRE 4

Réalisation d'un examen	35
Présentation	35
Principaux processus d'examen	36
Processus standard	37
Processus FE assisté par l'IA	39
Gestion des examens	40
Démarrage d'un nouvel examen	40
Recherche d'un examen	40
Suppression d'examens	41
Finalisation des examens	41
Gestion des données patient	42
Ajout d'un nouveau patient	42
Accès aux données du patient avec MWL	42
Recherche d'un patient	42
Changement de patient	43
Modification d'un dossier patient	43
Fusion de deux dossiers patient	43
Suppression de dossiers patient	44
Préréglages d'organes	45

Modes et fonctionnalités d'imagerie	45
2D/Mode B	46
Mode M	47
Doppler couleur	48
Color Power Doppler	50
Doppler pulsé	50
Imagerie Doppler tissulaire	52
Doppler continu	52
Préréglage automatique (actuellement disponible uniquement pour Kosmos sur iOS)	54
Doppler automatique (actuellement disponible uniquement pour Kosmos sur iOS)	55
Commandes du mode d'imagerie	56
Utilisation du processus FE assisté par l'IA du système Kosmos et Kosmos Trio	57
Kosmos Trio : Étiquetage automatique, Évaluation automatique et Guidage automatique	58
Capture automatique	64
Capture intelligente	64
Calcul de la FE avec le processus FE assisté par l'IA	65
Analyse/réglage des images TD/TS et des contours du VG	67
Recommandations pour acquérir des clips A4C et A2C de qualité optimale pour des calculs précis de la FE	70
Conditions d'erreur et notifications système pour le processus FE assisté par l'IA Kosmos	71
Acquisition d'images et de clips	71
Finalisation d'un examen	72
Mesures cardiaques de Kosmos	72
Kosmos AI FAST	75
Utilisation de Kosmos AI pour un examen FAST	75
Calculs vasculaires Kosmos	77
Kosmos UP (Plate-forme universelle) clinique	78
Us2.ai et Kosmos (Android uniquement)	78
Mise en route	78
19Labs et Kosmos (Android uniquement)	79
Mise en route	80

CHAPITRE 5

Analyse d'un examen 81

- Démarrage de l'analyse d'un examen 81
- Annotation des images et des clips 81
 - Outils d'annotation* 83
 - Mesure avec un curseur* 83
 - Suppression d'annotations* 84
- Gestion des images et des clips 84
 - Filtrage des images et des clips* 84
 - Sélection d'images et de clips* 85
 - Découpage et enregistrement d'images et de clips* 85
 - Suppression d'images et de clips* 86
- Affichage et modification d'un rapport 86
 - Ouverture d'un rapport* 86
 - Modification d'un rapport* 86
- Exportation d'images et de clips sur une clé USB 88
- Finalisation de l'analyse d'un examen 89
- Archivage d'un examen sur un serveur PACS 90
- Suppression d'un examen 91

CHAPITRE 6

Sondes Kosmos 93

- Protections de sondes Kosmos 93
- Gels de contact pour échographie 94
- Stockage des sondes Kosmos 94
 - Stockage quotidien* 94
 - Stockage pour le transport* 94
- Vérification des éléments de la sonde 95

CHAPITRE 7

Sécurité 97

- Sécurité électrique 97
 - Références* 97
- Symboles d'étiquetage 98
 - Coordonnées* 105

- Sécurité biologique 107
 - Programme de formation ALARA* 107
 - Tableaux de puissances acoustiques*
 - Kosmos Torso-One* 110
 - Récapitulatif de puissance acoustique maximale du Kosmos Lexsa* 118
- Exactitude des mesures 125
 - Effets des commandes* 127
 - Références connexes* 127
 - Augmentation de la température de surface de la sonde* 128
- Ergonomie 128
- Mesures de sécurité de base 129
- Compatibilité électromagnétique 130
 - Émissions électromagnétiques* 131
 - Immunité électromagnétique* 132
 - Distances de séparation* 135
- Normes 136
 - HIPAA* 136
 - DICOM* 136

CHAPITRE 8

Entretien du système KOSMOS 137

- Nettoyage et désinfection 137
 - Mises en garde générales* 137
 - Tablette* 138
 - Kosmos Power Pack* 139
 - Sondes Kosmos* 140
- Lignes directrices pour les RA (Reprocesseurs automatiques) 145
- Recyclage et mise au rebut 146
- Dépannage 146
 - Inspection, maintenance et étalonnage préventifs* 146

CHAPITRE 9

Caractéristiques techniques 147

Caractéristiques du système 147

Conditions environnementales d'utilisation et de stockage des sondes Kosmos, du Kosmos Power Pack et des tablettes compatibles 147

Sondes Kosmos et tablettes : Plages de conditions d'utilisation, chargement, transport et stockage 148

Kosmos Power Pack : Plages de conditions d'utilisation, chargement, transport et stockage 148

Mode de fonctionnement 148

Caractéristiques électriques du

Kosmos Power Pack 149

Sortie 149

Batteries internes 149

Bloc d'alimentation (SW125-12-N CUI Inc.) 149

CHAPITRE 10

Réseau informatique 151

Utilisation d'un réseau sans fil 151

Fonctions 151

Sécurité 151

Réseau de connexion du dispositif 152

Mesures de récupération en cas de défaillance du réseau informatique 152

CHAPITRE 11

Glossaire 155

ANNEXE A

Politique d'application 161

Politique d'application pour les systèmes d'imagerie pendant l'urgence sanitaire publique liée à la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19), guide de la Food and Drug Administration pour l'industrie et le personnel, avril 2020 161

Indications 161

Performances du produit 162

Risques potentiels et atténuations 163

Avertissements et mises en garde généraux 168

Résumé des caractéristiques de l'ensemble de données utilisé pour développer l'outil d'étiquetage automatique 169

Résumé des caractéristiques de l'ensemble de données utilisé pour développer l'outil d'évaluation et de guidage 170

PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE

Quelles sont les nouveautés de cette version ?

Nouvelles fonctionnalités et changements pour Kosmos® :

- Lancement du logiciel Kosmos v2.2 pour Kosmos sur iOS
 - Tracé VTI (IA)
 - Préréglage automatique Torso-One
 - Doppler automatique Torso-One pour les modes PW et TDI (préréglage cardiaque)
 - Déroulement des examens (bouton 2D)

	Les fonctionnalités peuvent varier entre les logiciels iOS et Android. Contacter le représentant EchoNous pour plus d'informations concernant le logiciel.
	Pour obtenir les versions électroniques des manuels d'utilisation, consulter le site Web d'EchoNous à l'adresse echonous.com/product/resources .
	Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Vérifier leur disponibilité dans une région donnée auprès du représentant local.

Fonctionnalités publiées précédemment

Fonctionnalités précédemment publiées pour Kosmos sur Android v5.1 :

- Doppler pulsé sur Lexsa
- Color Power Doppler
- Ajout d'un bouton 2D et d'un mode de navigation
- Calculs cardiaques (manuel)
- Calculs vasculaires (manuel)

- DICOM SR pour les rapports cardiaques
- Tracé VTI (IA)
- Fonctionnalités sous licence Lexsa

Fonctionnalités précédemment publiées pour Kosmos sur iOS v2.1 :

- Doppler pulsé sur Torso-One
- Doppler continu sur Torso-One
- Imagerie Doppler tissulaire sur Torso-One
- AI FAST
- Kosmos Trio
- Processus FE
- Calculs cardiaques (manuel)
- DICOM SR pour les rapports cardiaques
- Tracé automatique de l'ITV
- Doppler pulsé sur Lexsa
- Color Power Doppler sur Lexsa
- Calculs vasculaires (manuel)
- Assistance Kosmos Hub
- Licence d'utilisation de fonctionnalités

Contenu de la boîte

Pour les utilisateurs de Kosmos sur iOS et Android, la boîte du système Kosmos contient les éléments suivants :

- Kosmos Torso-One et/ou Kosmos Lexsa
- Manuel d'utilisation de Kosmos sur iOS et Android
- Protection de connecteur de sonde Kosmos (accessoire en option) avec instructions d'installation
- Guide rapide de la plate-forme Kosmos
- Lettre de bienvenue Kosmos
- Compatibilité chimique
- Clé USB contenant :
 - Manuel d'utilisation de Kosmos sur iOS et Android
 - Manuel d'utilisation Kosmos AI Station 2

Utilisateurs visés

Le système Kosmos est conçu pour être utilisé par des professionnels de la santé qualifiés et formés, qui sont dûment habilités à utiliser le dispositif par la loi du pays, de l'État ou de toute autre municipalité locale dans le ou laquelle ils exercent. La liste des utilisateurs potentiels inclut, entre autres (selon le titre/l'emplacement géographique) des : médecins spécialistes ; médecins de premier recours ; utilisateurs sur le lieu d'intervention (POC - Point-of-Care) ; échographistes ; techniciens médicaux ; infirmiers ; infirmiers praticiens spécialisés ; médecins assistants ; et étudiants en médecine.

Les utilisateurs peuvent ou non travailler sous la surveillance ou l'autorité d'un médecin.

Utilisation prévue/Consignes d'utilisation

 Pour garantir la qualité diagnostique des images obtenues, toutes les images de patient doivent être obtenues par des professionnels de la santé qualifiés et formés.

Le système Kosmos est conçu pour être utilisé par des professionnels de la santé qualifiés et formés à l'évaluation clinique des systèmes cardiaque, pulmonaire et de l'abdomen par l'acquisition, le traitement, l'affichage, la mesure et le stockage d'échographies.

Le système Kosmos est conçu pour être utilisé dans des environnements de soins cliniques et de formation médicale sur des populations de patients adultes et pédiatriques.

Le dispositif est non invasif, réutilisable et conçu pour être utilisé sur un seul patient à la fois.

Le système Kosmos offre par ailleurs des fonctions d'échographie diagnostique à usage général, utilisées dans les applications cliniques et les modes de fonctionnement suivants :

Applications cliniques et les modes de fonctionnement de Kosmos sur Android

Applications cliniques :

- **Torso-One** : Cœur, Thorax/poumon, Abdomen
- **Lexsa** : Poumon, Système vasculaire/vasculaire périphérique et Système musculosquelettique, Nerf et guidage par image pour le placement de l'aiguille/du cathéter (notamment pour le placement de l'aiguille/du cathéter, le drainage des fluides et l'anesthésie tronculaire)

Modes de fonctionnement : Mode B, mode M, Doppler couleur, Color Power Doppler, modes B+M et B+CD combinés, Doppler PW, Doppler CW, TDI et Imagerie harmonique

Applications cliniques et les modes de fonctionnement de Kosmos sur iOS

Applications cliniques :

- **Torso-One** : Cœur, Thorax/poumon et Abdomen
- **Lexsa** : Poumon, Système vasculaire/vasculaire périphérique et Système musculosquelettique, Nerf et guidage par image pour le placement de l'aiguille/du cathéter (notamment pour le placement de l'aiguille/du cathéter, le drainage des fluides et l'anesthésie tronculaire)

Modes de fonctionnement : Mode B, mode M, Doppler couleur, Color Power Doppler, modes B+M et B+CD combinés, Doppler PW, Doppler CW, TDI et Imagerie harmonique

TABLEAU 1-1. Modes de fonctionnement et fonctionnalités disponibles à l'achat pour Kosmos sur Android et iOS

Mode	Torso-One Android	Lexsa Android	Torso-One iOS	Lexsa iOS	Fonctionnalités achetables
Mode B	x	x	x	x	
Mode M	x	x	x	x	
B+CD (Doppler couleur)	x	x	x	x	
Imagerie harmonique	x		x		
Processus FE assisté par l'IA	x		x		x
Kosmos Trio	x		x		x
Doppler PW	x	x	x	x	x
TDI	x		x		x
Doppler CW	x		x		x
AI FAST	x		x		x
Color Power Doppler		x		x	
Préréglage automatique			x		x
Doppler automatique			x		x
Kosmos UP	x	x			x
Us2.ai	x				x

Contre-indications

Le système Kosmos est conçu pour l'échographie transcutanée et l'échocardiographie transthoracique uniquement.

Le système Kosmos n'est pas destiné à une utilisation ophtalmique ni à une utilisation provoquant le passage d'un faisceau acoustique à travers l'œil.

▲	Faire preuve de prudence à proximité d'une plaie afin d'éviter d'endommager ou d'étendre la zone affectée.
▲	Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.

Avertissements et mises en garde généraux

▲	Les utilisateurs du système sont responsables de la qualité et du diagnostic des images.
▲	Le système Kosmos n'est pas compatible avec l'IRM et ne doit pas être utilisé dans une salle d'IRM.
▲	Le système Kosmos ne doit pas être utilisé dans des environnements riches en oxygène.
▲	Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne laisser aucune partie du système Kosmos (mis à part la lentille de la sonde Kosmos) toucher le patient.
▲	Pour éviter tout risque de décharge électrique ou de blessure, n'ouvrir en aucun cas le boîtier de la tablette ou de la sonde Kosmos. Tous les réglages et remplacements internes (tels que le remplacement de la batterie) doivent être effectués par un technicien Kosmos qualifié.
▲	Pour éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie, examiner régulièrement le bloc d'alimentation, les cordons d'alimentation secteur, les câbles et les fiches pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.
▲	Le système Kosmos n'est pas résistant à la défibrillation. Pour éviter tout risque de blessure de l'opérateur ou d'un tiers, il faut retirer les sondes Kosmos du patient lors de l'application d'un choc de défibrillation haute tension.

▲	Avant d'utiliser le système Kosmos dans des procédures de guidage d'aiguille, l'utilisateur doit non seulement avoir été formé à l'utilisation de l'échographie pour le guidage d'aiguille, mais aussi aux procédures interventionnelles applicables. Du fait des limitations bien connues de l'échographie, il se peut qu'il soit impossible de visualiser l'aiguille ou de la différencier des artefacts acoustiques. Toute tentative de procédure interventionnelle sans formation adéquate peut entraîner des blessures ou des complications graves.
▲	Par précaution, faire preuve de prudence à proximité d'une plaie ou sur un pansement.
▲	Ne pas utiliser le système Kosmos pour une imagerie intracavitaire.
▲	Le système Kosmos utilise la technologie de communication sans fil Bluetooth.
▲	Maintenir les cordons d'alimentation à l'écart des zones de passage.
▲	Aucune modification ne peut être apportée à cet équipement sans le consentement écrit du fabricant, EchoNous, Inc.
▲	Ne pas charger le Power Pack au moment de l'examen d'un patient. Ne pas charger la tablette au moment de l'examen d'un patient, à moins qu'elle ne soit connectée au Kosmos Hub avec l'alimentation GlobTek, Inc GTM96600-6512-T3.
▲	Ne connecter aucun équipement non autorisé pendant l'utilisation du système Kosmos.
▲	N'utiliser que des tablettes dont la compatibilité est approuvée par EchoNous.
▲	Certaines tablettes nécessitent le Power Pack pour faire fonctionner Kosmos. Veuillez vérifier auprès de votre représentant EchoNous ou consulter le site Web d'EchoNous pour plus d'informations.

Manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation est conçu pour aider à utiliser le système Kosmos de manière sûre et efficace. Avant de tenter d'utiliser le système Kosmos, lire ce manuel d'utilisation et respecter scrupuleusement tous les avertissements et mises en garde qu'il contient. Prêter également une attention particulière aux informations du chapitre **Sécurité**.

	Pour l'UE uniquement : tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
	Toutes les versions du logiciel ne sont pas dotées de toutes les fonctionnalités décrites dans ce guide. Consulter la version du logiciel indiquée sur le dispositif.

Ce manuel d'utilisation ainsi que tous les supports numériques (et les informations qu'ils contiennent) sont des informations exclusives et confidentielles d'EchoNous, qui ne peuvent être reproduites, copiées intégralement ou partiellement, adaptées, modifiées, divulguées à des tiers ou diffusées qu'avec l'autorisation écrite préalable du service juridique d'EchoNous. Ce document ou les supports numériques sont conçus pour être utilisés par les clients et leur sont concédés sous licence dans le cadre de leur achat EchoNous. Toute utilisation de ce document ou des supports numériques par des personnes non autorisées est strictement interdite. Ce manuel d'utilisation est également disponible sur le site Web d'EchoNous, ou peut être fourni en version imprimée sur demande.

	Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.
---	---

Symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation

	Avertissement	Un avertissement décrit les précautions à prendre pour éviter tout risque de blessure grave, voire mortelle.
	Mise en garde	Une mise en garde décrit les précautions à prendre pour éviter d'endommager le dispositif.
	Remarque	Une remarque fournit des informations complémentaires.

Conventions utilisées dans le manuel d'utilisation

Les conventions de style suivantes sont utilisées dans ce manuel :

- Les étapes numérotées et lettrées doivent être exécutées dans un ordre spécifique.
- Les éléments à puce sont des listes sans ordre d'exécution particulier.
- Les icônes et boutons de l'écran tactile du système Kosmos sont indiqués en gras, par exemple **SCANNER**.
- Le terme :
 - **Appuyer** indique qu'il faut toucher brièvement l'écran avec le doigt
 - **Appuyer deux fois** fait référence au fait de tapoter deux fois sur l'écran en succession rapide avec le doigt
 - **Faire glisser** indique qu'il faut toucher l'écran avec un doigt, puis faire glisser le doigt sur l'écran
 - **Balayer** indique qu'il faut déplacer le doigt rapidement sur l'écran
 - **Pincer** indique qu'il faut déplacer deux doigts dans un mouvement de pincement ou d'ouverture sur l'écran
 - **Cocher** indique qu'il faut appuyer sur une case à cocher pour activer la fonction associée
 - **Décocher** indique qu'il faut appuyer sur une case à cocher pour désactiver la fonction associée
 - **Sélectionner** indique qu'il faut appuyer sur un élément de menu
- Les liens vers d'autres sections du manuel apparaissent en gras et en couleur, comme dans la référence croisée, voir **Modes et fonctionnalités d'imagerie**.

Service clientèle EchoNous

Pour contacter le service clientèle :

Téléphone : 844-854-0800

Télécopie : 425-242-5553

E-mail : info@echonous.com

Web : echonous.com

Ressources : echonous.com/product/resources

Présentation du système KOSMOS

En quoi consiste le système Kosmos ?

Le système Kosmos se compose de Kosmos Torso-One ou de Kosmos Lexsa connecté par câble sur une tablette compatible pour piloter l'application EchoNous Kosmos Ultrasound. Lorsque l'écran est raccordé à une sonde Kosmos, l'ensemble forme une combinaison configurée comme un système électromédical. La liste des tablettes compatibles peut être consultée sur le site Web d'EchoNous : echonous.com/product/device-compatibility.

Les sondes suivantes sont disponibles pour le système Kosmos :

- Kosmos Torso-One :
 - Sonde à déphasage à ultrasons uniquement, avec un facteur de forme plus petit et plus épuré, mieux adapté aux espaces intercostaux.
 - Dispositif d'échographie portatif qui prend en charge les échographies non invasives cardiaques thoraciques/pulmonaires et abdominales.
- Kosmos Lexsa :
 - Sonde linéaire à ultrasons.
 - Dispositif d'échographie portable non invasif qui prend en charge les modalités Poumons, Système vasculaire/vasculaire périphérique et Système musculosquelettique. Il offre un guidage interventionnel, notamment pour le placement de l'aiguille/du cathéter, le drainage des fluides et l'anesthésie tronculaire.

Le système Kosmos utilise la réflexion d'impulsions ultrasonores pour générer des échographies en temps réel. Ce processus consiste à transmettre des impulsions acoustiques haute fréquence dans le corps à l'aide de la sonde, à détecter les signaux renvoyés et à traiter les échos de retour de façon analogique et numérique pour former des images en temps réel de l'anatomie (modes B et M) et du flux sanguin (Doppler couleur). Consulter [Tableau 4-2, «Modes de fonctionnement et fonctionnalités pour Kosmos sur Android et iOS»](#) pour plus d'informations sur les modes applicables à chaque sonde Kosmos.

Veillez noter que certaines tablettes Android nécessitent l'ajout du Power Pack pour prendre en charge le mode CW. De plus, utilisé avec les tablettes Android compatibles, le Kosmos Power Pack peut être utilisé en tant qu'accessoire en option pour allonger la durée d'examen dans tous les modes d'imagerie. Certaines tablettes nécessitent le Power Pack pour faire fonctionner Kosmos. Veillez consulter le site Web d'EchoNous pour plus d'informations.

Le système Kosmos offre une connectivité sans fil en option, permettant le stockage à distance.

Le système Kosmos offre également le processus FE assistée par l'IA, Trio et AI FAST.

Le système Kosmos utilise l'échographie pour permettre l'évaluation clinique des principales structures cardiaques, notamment les cavités du cœur, les valvules cardiaques et les principaux vaisseaux du cœur chez les patients adultes et pédiatriques. Dans le cadre de cette évaluation clinique, le système Kosmos permet de visualiser le flux sanguin grâce à la technologie du Doppler couleur.

Le processus FE assisté par l'IA du système Kosmos peut servir de guide lors du calcul de la fraction d'éjection (FE) ventriculaire gauche (VG). Le système Kosmos enregistre alors les clips nécessaires à l'aide d'un processus guidé. Les clips enregistrés sont ensuite utilisés par l'IA pour fournir un premier calcul de la FE et du volume systolique (VS), dont les résultats peuvent être analysés et ajustés si nécessaire.

L'IA du système Kosmos fournit notamment un calcul initial de la FE, qui repose sur l'identification des images télédiastoliques (TD) et télésystoliques (TS), parallèlement aux contours du VG correspondants. Ces images TD/TS et contours du VG peuvent ensuite être ajustés (selon le besoin) ou acceptés tels quels.

Au cours de leur analyse, ces images peuvent être ajustées sur la base des constatations effectuées, pendant que le système Kosmos calcule (à partir des ajustements apportés) la FE et le volume d'éjection systolique (VES).

Le Trio d'algorithmes Étiquetage automatique, Évaluation automatique et Guidage automatique peut faciliter l'acquisition des vues A4C, A2C et PLAX. Kosmos Trio aide à acquérir des vues en annotant en temps réel les structures cardiaques clés, en évaluant l'image selon l'échelle ACEP à 5 niveaux et en indiquant comment déplacer la sonde pour optimiser les images A4C, A2C ou PLAX.

Kosmos AI FAST peut vous guider dans un examen FAST en identifiant les vues et en étiquetant les structures anatomiques principales en temps réel.

Le processus FE assisté par l'IA Kosmos et les outils Kosmos Trio et Kosmos AI FAST n'ont pas encore été approuvés par la FDA. Au lieu de cela, EchoNous suit les exigences de la **Politique d'application pour les systèmes d'imagerie pendant l'urgence sanitaire publique liée à la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19), guide de la Food and Drug Administration pour l'industrie et le personnel, avril 2020.**

	Le VES est calculé en soustrayant le volume TS du VG du volume TD du VG.
	Les fonctionnalités varient selon la version du logiciel. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités disponibles sur l'appareil, contacter le représentant EchoNous.
	Pour l'UE, Kosmos Trio doit être utilisé à des fins pédagogiques uniquement.
	Pour l'UE, Kosmos AI FAST doit être utilisé à des fins pédagogiques uniquement.

Applications cliniques du système Kosmos

Le système Kosmos, qui permet l'imagerie non invasive du corps humain, est conçu pour les applications par sonde suivantes :

Torso-One :

- Cardiaque
- Thoracique/Pulmonaire
- Abdominale

Lexsa :

- Poumons
- Vasculaire/Vasculaire périphérique
- AL
- Nerfs

Formation

Le système Kosmos est conçu pour être utilisé par des cliniciens possédant les qualifications professionnelles et la formation clinique adéquates.

Tous les utilisateurs doivent lire le programme de formation ALARA générique fourni avec le système Kosmos (voir le document *ISBN 1-932962-30-1, Medical Ultrasound Safety* [Sécurité de l'échographie médicale] sur la clé USB) ou les *Principes d'utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques* de Santé Canada, disponibles sur le site Web de Santé Canada. Ce programme décrit le principe directeur de l'échographie diagnostique, selon lequel l'utilisateur qualifié maintient l'exposition aux ultrasons au « niveau le plus faible possible » (As Low As Reasonably Achievable, ALARA) pendant l'exécution d'un examen diagnostique.

En outre, les utilisateurs souhaitant utiliser la fonction d'échographie doivent avoir été correctement formés aux ultrasons. Pour des informations appropriées sur la formation, contacter EchoNous ou l'organisation professionnelle locale.

Classifications du système Kosmos

- Le Kosmos Torso-One et le Kosmos Lexsa sont des pièces appliquées de type BF. Les pièces appliquées incluent :
 - La lentille (surface avant) de la sonde Kosmos
- Le Kosmos Torso-One et le Kosmos Lexsa sont certifiés IPx7
- Le Kosmos Power Pack, utilisé avec un bloc d'alimentation et une tablette approuvés, est classé comme un système électromédical
- Le Kosmos Power Pack est certifié IP2X

Environnement du patient

Le système Kosmos est conçu pour être utilisé dans un établissement médical. Le Power Pack ne doit pas être chargé dans l'environnement du patient. La tablette ne doit pas être chargée dans l'environnement du patient à moins qu'elle ne soit connectée au Kosmos Hub avec l'alimentation GlobTek, Inc GTM96600-6512-T3.

 Ne pas charger le Power Pack au moment de l'examen d'un patient. Ne pas charger la tablette pendant l'examen d'un patient à moins qu'elle ne soit connectée au Kosmos Hub avec l'alimentation GlobTek, Inc GTM96600-6512-T3.

- Fin de la section -

PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE

Présentation du système

Utiliser cette section pour se familiariser avec le système à ultrasons et ses composants.

Exigences de l'appareil

Pour obtenir une liste d'appareils testés par EchoNous et dont la compatibilité avec l'application Kosmos a été approuvée, consulter le site Web Kosmos : **echonous.com/product/device-compatibility**.

L'application EchoNous Kosmos Ultrasound ne peut être téléchargée et installée que sur les tablettes compatibles, répertoriées dans la liste du site Web EchoNous. Les exigences les plus importantes auxquelles répondent ces tablettes sont indiquées ci-dessous :

Android :

- Un espace de stockage de 50 Mo minimum (et plus pour l'enregistrement des données du patient)
- Écran couleur, 203 mm minimum
- Interface tactile
- Enceintes montées en interne
- Conforme à la norme CEI 60950-1 ou CEI 62386-1
- Un seul port USB
- Configuration de la date et de l'heure
- Complète conformité avec la norme USB On-The-Go standard1
- Résolution de 2 560 x 1 600 (minimum)
- Android 10.0 ou système d'exploitation plus récent

- Fonction de mise en réseau cellulaire ou sans fil
- Fonction audio
- Caméras à vision avant et arrière

iOS :

- Un espace de stockage de 50 Mo minimum (et plus pour l'enregistrement des données du patient)
- Écran couleur, 203 mm minimum
- Interface tactile
- Enceintes montées en interne
- Conforme à la norme CEI 60950-1 ou CEI 62386-1
- Un seul port USB
- Configuration de la date et de l'heure
- Complète conformité avec la norme USB On-The-Go standard1
- Résolution de 2 560 x 1 600 (minimum)
- iOS 15 ou système d'exploitation plus récent
- Fonction de mise en réseau cellulaire ou sans fil
- Fonction audio
- Caméras à vision avant et arrière

Il convient de prendre connaissance de toutes les mises en garde de sécurité de la section sécurité de ce manuel. La tablette doit présenter les caractéristiques adéquates pour pouvoir être utilisée dans les conditions spécifiques de l'environnement.

Matériel Kosmos

 Contacter EchoNous ou le représentant local pour une liste des accessoires disponibles auprès d'EchoNous ou recommandés par EchoNous.

Les images suivantes montrent les fonctionnalités clés sur Kosmos Torso-One, Kosmos Lexsa et le Power Pack.


Kosmos Torso-One



Kosmos Lexsa



Kosmos Power Pack

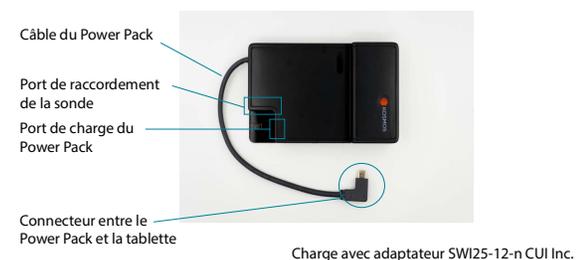

Mise en route

Téléchargement de l'application EchoNous Kosmos Ultrasound

Prise en main de Kosmos sur Android

1. Connecter la tablette Android au Wi-Fi.
2. Le cas échéant, supprimer de la tablette la version précédemment installée de l'application Kosmos.

 S'assurer d'avoir archivé les données avant de supprimer la version précédemment installée de l'application Kosmos de la tablette.

3. Télécharger la toute dernière version de l'application EchoNous Kosmos Ultrasound depuis le Google Play Store.

Prise en main de Kosmos sur iOS

1. Connecter la tablette iOS au Wi-Fi.
2. Le cas échéant, supprimer de la tablette la version précédemment installée de l'application Kosmos.

 S'assurer d'avoir archivé les données avant de supprimer la version précédemment installée de l'application Kosmos de la tablette.

3. Télécharger l'application EchoNous Kosmos Ultrasound depuis l'Apple App Store.
4. Ouvrir l'application Kosmos. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur Enable drivers (Activer les pilotes). Vous serez redirigé vers les paramètres de votre tablette. Basculer chaque pilote en position activée.

Branchement des sondes Kosmos

	Avant chaque utilisation, inspecter le Kosmos Torso-One et/ou le Kosmos Lexsa à la recherche d'éventuelles fissures, craquelures ou arêtes vives. Si la ou les sondes Kosmos sont endommagées, arrêter de les utiliser et contacter le représentant EchoNous.
	N'utiliser que les appareils et les accessoires recommandés par EchoNous.

Pour brancher le Kosmos Torso-One ou le Kosmos Lexsa aux tablettes Android ou iOS approuvées :

1. Brancher le câble de la sonde Kosmos sur le port USB-C situé sur le côté de la tablette.
 - Pour enregistrer votre transducteur et les fonctions sous licence pour la première fois, la sonde doit être connectée à l'appareil et votre appareil doit être connecté à Internet. Cette étape peut prendre quelques minutes.
2. Une fois prêt à commencer l'examen, appuyer sur le pré-réglage de votre choix pour lancer le balayage.

	Pour les utilisateurs d'Android, certaines tablettes nécessitent l'ajout du Power Pack pour prendre en charge le Doppler CW. Pour obtenir la liste des tablettes nécessitant le Power Pack, accéder au site Web d'EchoNous à l'adresse echonous.com/product/device-compatibility .
	Pour les utilisateurs d'Android, certaines tablettes nécessitent le Power Pack pour faire fonctionner Kosmos. Visiter le site Web d'EchoNous à l'adresse echonous.com/product/device-compatibility .


Kosmos Power Pack pour Android

Kosmos Power Pack est une source d'énergie qui permet l'utilisation de certaines fonctionnalités sur les tablettes Android approuvées et qui offre une durée de balayage prolongée avec les sondes Kosmos. Consulter echonous.com/product/device-compatibility pour obtenir la liste mise à jour des tablettes compatibles et les informations relatives aux tablettes qui requièrent le Power Pack.

Configuration du Kosmos Power Pack


	Le Power Pack est conçu pour être utilisé uniquement avec les tablettes Android compatibles. Contacter le représentant EchoNous pour plus de détails.
	Veiller à placer le Power Pack de façon à ce que le port de raccordement de la sonde, le port de chargement et la prise murale soient accessibles.
	Pour des instructions plus détaillées sur le Power Pack, consulter le Guide rapide du Power Pack (P008008).
	S'assurer que le Power Pack est correctement branché sur la tablette avant l'utilisation.
	L'état de charge du Power Pack n'est pas affiché à l'écran. S'assurer que la batterie du Power Pack est suffisamment chargée avant l'utilisation.

1. Charger le Kosmos Power Pack avant l'utilisation. Voir les instructions de chargement du Power Pack ci-dessous.
2. Retirer le film de protection des bandes adhésives Dual Lock.
3. Positionner le Power Pack sur le coin inférieur droit de la tablette, en veillant à ce que les ports de l'appareil et les ports du Power Pack soient du même côté (voir l'image ci-dessous). Appuyer fermement sur le Power Pack pendant 45 secondes pour s'assurer que les bandes adhésives adhèrent bien à l'appareil.
4. Brancher le câble USB-C du Power Pack au port USB-C de la tablette.



Démontage du Power Pack

1. Pour retirer le Power Pack de sa plaque de montage, appuyer sur la languette de dégagement et faire glisser le Power Pack vers le bas.
2. Pour remonter le Power Pack sur la plaque, mettre le Power Pack en place en le faisant glisser vers le haut.



Charge du Kosmos Power Pack


1. Débrancher la sonde si elle est branchée.
2. Brancher le chargeur au Power Pack. Une fois branché, les témoins du Power Pack indiquent le niveau de charge de la batterie.

Niveau de charge de la batterie	Charge : Intervalle entre les clignotements : 3 s	Examen : Intervalle entre les clignotements : 2 s	Repos : Intervalle entre les clignotements : 1 s
0-25 %			
25-50 %			
50-75 %			
75-100 %			
100 %			

3. Débrancher le chargeur du Power Pack une fois chargé.


4. Débrancher le bloc d'alimentation de la prise murale.

⚠ Ne pas charger le Kosmos Power Pack dans la zone du patient.




Interaction générale

Écran d'accueil : Kosmos Torso-One

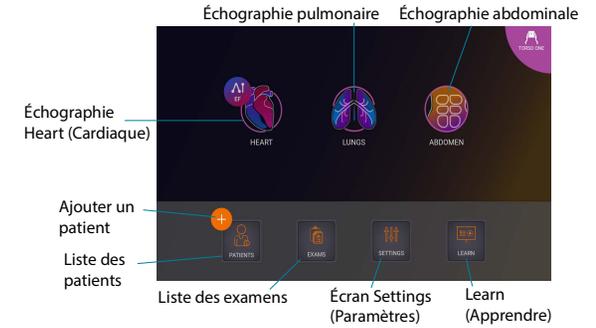

Écran d'accueil : Kosmos Lexsa

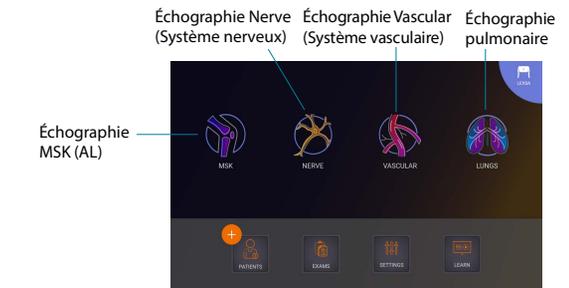

Apprendre

Pour accéder aux vidéos explicatives disponibles sur YouTube, s'assurer que le dispositif est connecté au Wi-Fi et appuyer sur **Learn** (Apprendre).

Paramètres

Une fois les paramètres du système configurés, ils restent tels quels à chaque nouvelle connexion à l'application Kosmos.

Préférences d'imagerie

L'écran Imaging Preferences (Préférences d'imagerie) permet de personnaliser les informations affichées sur l'écran d'imagerie.

Pour régler les préférences d'imagerie :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **SETTINGS** (Paramètres).
2. Appuyer sur **Imaging Preferences** (Préférences d'imagerie).
3. Pour afficher certaines informations dans la barre supérieure de l'écran d'imagerie, appuyer sur une des options suivantes sous **Customize information** (Personnaliser les informations) :
 - **Name of facility** (Nom de l'établissement) : affiche le nom de l'établissement dans la barre supérieure de l'écran d'imagerie.
 - **Patient name** (Nom du patient) : affiche le nom du patient dans la barre supérieure de l'écran d'imagerie.
 - **Patient ID** (ID patient) : affiche l'ID du patient dans la barre supérieure de l'écran d'imagerie.
4. Pour configurer la façon dont le système Kosmos enregistre des clips, appuyer sur une des options suivantes sous **Record clip** (Enregistrer un clip) :
 - **Retrospective** (Rétrospectif) : capture des images de la mémoire tampon ciné lorsque l'icône Clip  est sélectionnée. Le système Kosmos capture des images de la mémoire tampon ciné pendant le nombre de secondes indiqué.
 - **Prospective** (Prospectif) : capture des images lorsque l'icône Enregistrer un clip  est sélectionnée. Le système Kosmos capture des images pendant le nombre de secondes indiqué.

5. Pour configurer la durée d'enregistrement des clips, sélectionner une durée dans la zone **Clip duration** (Durée des clips).

	Pour mettre fin à l'enregistrement d'un clip avant la fin de la durée définie ici au cours d'un examen, appuyer de nouveau sur l'icône Enregistrer un clip  .
---	--

6. Pour régler la séparation horizontale de l'écran entre le mode M et le mode B, sélectionner une des options suivantes sous **M-Mode layout** (Disposition du mode M) :
 - **1:2** : sélectionner cette option pour régler la séparation de l'écran de façon à ce que la zone du mode M soit deux fois plus grande que celle du mode B.
 - **1:1** : sélectionner cette option pour régler la séparation de l'écran de façon à ce que les zones du mode M et du mode B soient égales.
7. Dans la zone **Thermal index display** (Affichage de l'indice thermique), sélectionner une des options suivantes :
 - **TIS** (ITm) : indice thermique dans les tissus mous.
 - **TIB** (ITo) : indice thermique osseux à proximité du point focal.
8. Sélectionner le préréglage **cardiac imaging orientation** (Orientation d'imagerie cardiaque) :
 - Sélectionner l'orientation Left (Gauche) ou Right (Droite).
9. Pour activer les fonctionnalités automatiques (actuellement disponibles pour Kosmos sur iOS avec Torso-One), appuyer sur le bouton bascule pour passer en position activée.
 - Doppler automatique : lors de l'acquisition en modes TDI et PW cardiaques, utiliser le Doppler automatique pour le positionnement automatique assisté par IA des portes d'échantillonnage PW et TDI.
 - Préréglage automatique : lors de l'acquisition dans les préréglages cœur, poumon et abdomen, la fonction de préréglage automatique assistée par l'IA reconnaît l'anatomie et passe automatiquement au préréglage approprié.
10. Pour les modes PW et CW, sélectionner l'une des options suivantes :
 - Point focal/porte et zone couleur synchronisés.
 - Point focal/porte et zone couleur découplés.

À propos de

La section About (À propos de) contient des informations essentielles sur votre appareil, telles que la version du logiciel Kosmos, le numéro de modèle, l'état d'enregistrement de l'appareil et les fonctionnalités sous licence. Vous pourrez également accéder aux informations du transducteur, effectuer une vérification des éléments du transducteur et consulter les coordonnées de l'assistance.

1. Sur l'écran d'accueil de l'application Kosmos, accéder à **Settings** --> **About** (Paramètres --> À propos de).
2. Si le système Kosmos n'a pas encore été enregistré, appuyer sur **Register** (Enregistrer). Cela permet de connecter votre appareil Kosmos au cloud EchoNous. Vérifier que votre appareil est connecté à Internet.
3. Pour lancer la vérification des éléments du transducteur, appuyer sur **Check** (Tester).

DICOM

La section DICOM vous permet de gérer votre liste de travail des modalités (MWL) et votre archive PACS.

- Aucun profil n'est configuré sur les systèmes neufs.
- Il n'est pas possible d'activer deux profils PACS en même temps. Lorsqu'un nouveau profil est ajouté, le profil actuel est désactivé.

Ajout d'un profil

Pour ajouter un profil PACS :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **SETTINGS** (Paramètres).
2. Appuyer sur **DICOM** --> **PACS archive** (Archive PACS).
3. Appuyer sur **ADD PROFILE** (Ajouter un profil).

- Si un nouveau profil PACS-SCP est ajouté alors qu'il en existe déjà un, le système désactive le profil existant. Toutefois, toutes les tâches présentes dans la file d'attente existante et toutes les archives planifiées doivent d'abord être terminées.

4. Saisir les informations suivantes dans la zone **DICOM connection** (Connexion DICOM) :
 - **Station AE title** (Titre AE du poste) : titre d'entité de l'application Kosmos.
 - **Server AE title** (Titre AE du serveur) : titre d'entité d'application du serveur d'archivage.
 - **Server IP address** (Adresse IP du serveur) : identifiant unique du serveur d'archivage.
 - **Server port number** (Numéro de port du serveur) : numéro de port du serveur d'archivage.
5. Pour vérifier que la connexion fonctionne sur un profil actif, appuyer sur une des options suivantes :
 - **PING** pour tester la connexion réseau entre le système Kosmos et l'archive PACS.
 - **Verify** (Vérifier) pour vérifier la disponibilité de l'archive PACS active. Les résultats s'affichent à l'écran.
6. Dans la zone **Profile nickname** (Pseudo du profil), saisir un nom unique à afficher dans la liste des profils PACS.
7. Dans la zone **Archival options** (Options d'archivage), trois options sont disponibles :
 - **Prompt options every time** (Afficher les options à chaque fois) : activée par défaut. Chaque fois que le bouton **Archive** (Archiver) est sélectionné sur l'écran Exam review (Analyse d'examen), un menu contextuel contenant différentes options s'affiche. Si cette option est désactivée, le système Kosmos n'affiche pas le menu contextuel.
 - **Attach report** (Joindre un rapport) : désactivée par défaut. Si cette option est activée, le système Kosmos joint un rapport à l'archive.
 - **Attach DICOM SR report** (Joindre le rapport DICOM SR) : option désactivée par défaut. Lorsque cette option est sélectionnée, Kosmos joint le rapport DICOM SR à l'archive.

8. Dans la zone **Auto archive** (Archivage auto), sélectionner une des options suivantes :
- **On/Off** (Activé/Désactivé) : l'archivage automatique est désactivé par défaut. Cela signifie que toutes les commandes (à l'exception de l'option Activé/Désactivé) sont désactivées et ne peuvent pas être modifiées. Si cette option est activée, toutes les commandes sont activées et peuvent être modifiées.
 - **Archival frequency** (Fréquence d'archivage)
 - **Completion of exam** (À la fin de l'examen) : le sélecteur de date/heure d'archivage est désactivé.
 - **Daily** (Quotidien) : seule la partie heure du sélecteur de date/heure d'archivage est activée.
 - **Weekly** (Hebdomadaire) : la totalité du sélecteur de date/heure d'archivage est activée.
 - **Archival time** (Date/heure d'archivage) : sélectionner une heure quotidienne et une date pour l'archivage des examens.

Si l'archivage automatique est activé, s'assurer que l'application Kosmos reste exécutée en arrière-plan. La fermeture de l'application Kosmos met les archives en pause. Afficher la Job Queue (File d'attente des tâches) pour reprendre ou retenter si les tâches n'ont pas été archivées correctement.

9. Dans la zone **Retry interval (in seconds)** (Intervalle entre les tentatives en secondes), sélectionner **60, 300** ou **600**.
10. Dans la zone Maximum retries (Nombre maximal de tentatives), sélectionner 1, 2 ou 3.
11. Pour que le système retente automatiquement les tâches qui ont échoué, définir l'option sur **On** (Activé). Sinon, la définir sur **Off** (Désactivé).

Désactivation d'un profil

Pour activer ou désactiver un profil, dans la liste **PACS archive** (Archive PACS), appuyer sur l'option pour basculer entre **Active** (Actif) et **Inactive** (Inactif).

Suppression d'un profil

Pour supprimer un profil PACS :

La suppression d'un profil PACS supprime également toutes les configurations du profil. L'archivage d'examen ne peut avoir lieu sans profil PACS actif.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **Settings** (Paramètres).
2. Appuyer sur **DICOM --> PACS archive** (Archive PACS).
3. Dans la liste des profils, faire glisser la flèche à gauche du profil à supprimer.
4. Appuyer sur l'icône **Supprimer** .

Gestion de MWL

Aucun profil n'est configuré sur les systèmes neufs.
Il n'est pas possible d'activer deux profils MWL en même temps. Lorsqu'un nouveau profil est ajouté, le profil actuel est désactivé.

Ajout d'un profil

Pour ajouter un profil MWL :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **SETTINGS** (Paramètres).
2. Appuyer sur **DICOM --> MWL**.
3. Appuyer sur **ADD PROFILE** (Ajouter un profil).

Si un nouveau profil MWL est ajouté alors qu'il en existe déjà un, le système désactive le profil existant.

4. Saisir les informations suivantes dans la zone **DICOM connection** (Connexion DICOM) :
 - **Station AE title** (Titre AE du poste) : titre d'entité d'application du système Kosmos.
 - **Server AE title** (Titre AE du serveur) : titre d'entité d'application du serveur d'archivage.

- **Server IP address** (Adresse IP du serveur) : identifiant unique du serveur d'archivage.
 - **Server port number** (Numéro de port du serveur) : numéro de port du serveur d'archivage.
5. Pour vérifier que la connexion fonctionne sur un profil actif, appuyer sur une des options suivantes :
 - **PING** pour tester la connexion réseau entre le système Kosmos et le serveur MWL.
 - **Verify** (Vérifier) pour vérifier la disponibilité du serveur MWL actif.
 - Les résultats s'affichent à l'écran.
 6. Dans la zond **Profile nickname** (Pseudo du profil), saisir un nom unique à afficher dans la liste des profils MWL.

Désactivation d'un profil

Pour activer ou désactiver un profil, dans la liste **MWL**, appuyer sur l'option pour basculer entre **Active** (Actif) et **Inactive** (Inactif).

Suppression d'un profil

Pour supprimer un profil MWL :

 La suppression d'un profil MWL supprime également toutes les configurations du profil.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **Settings** (Paramètres).
2. Appuyer sur **DICOM** --> **MWL**.
3. Dans la liste des profils, faire glisser la flèche à gauche du profil à supprimer.
4. Appuyer sur l'icône **Supprimer** .

Exportation USB

Pour configurer les préférences d'exportation USB :

1. Sur l'écran d'accueil de l'application Kosmos, accéder à **Settings** --> **USB export** (Paramètres --> Exportation USB).
2. Cocher la case pour activer l'exportation d'examen vers une clé USB.
3. Sélectionner le type de fichier.

Paramètres de rapport

Pour personnaliser les mesures et les valeurs des paramètres de rapport :

1. Sur l'écran d'accueil de l'application Kosmos, accéder à **Settings** --> **Report Settings** (Paramètres --> Paramètres de rapport).
2. Pour chaque mesure cardiaque, sélectionner l'une des options suivantes :
 - **Last** (Dernière) pour la dernière mesure prise
 - **Avg** (Moyenne) pour la mesure moyenne
 - **Max** pour la mesure maximale
3. Sélectionnez les mesures de distance et de vitesse. Réseaux sans fil

Fonctions

Le système Kosmos peut être connecté à un réseau informatique pour effectuer les opérations suivantes :

- Stocker les données d'examen (images statiques et clips) acquises par le système Kosmos dans l'archive PACS (Picture Archiving and Communication System) via une communication DICOM.
- Régler l'heure du système Kosmos de manière exacte en interrogeant le service de temps réseau.

Caractéristiques techniques de connexion

Configuration matérielle requise

802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ou ultérieur.

Configuration logicielle requise

Le système Kosmos est connecté au PACS via la norme DICOM. Pour plus de détails, consulter la Déclaration de conformité DICOM disponible sur le site Web d'EchoNous.

Restriction d'utilisation

Dans la plage de fréquences de 5 150 à 5 350 MHz, ce dispositif est limité à une utilisation en intérieur. Cette restriction s'applique dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

-- Fin de la section --

Réalisation d'un examen

Présentation


	Avant d'utiliser le Kosmos pour une procédure critique, comme le guidage d'aiguille, s'assurer qu'il est complètement chargé. Ceci permet de garantir que la procédure ne sera pas interrompue par une batterie déchargée, ce qui pourrait blesser le patient.
	La température maximale de la tête des sondes Kosmos peut dépasser 41 °C, mais reste en deçà de 43 °C lors du contact avec le patient pour un usage normal. Des précautions particulières doivent être envisagées lors de l'utilisation de la sonde sur des enfants ou sur d'autres patients sensibles aux températures relativement élevées.
	Pour réduire les risques d'infection, utiliser des protections stériles lors de procédures de guidage d'aiguille.
	Pour éviter de mélanger les données des patients, finaliser l'examen avant d'examiner un autre patient.
	Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles sur tous les marchés et varient selon les versions logicielles mises à disposition dans la région. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités disponibles sur l'appareil, contacter le représentant EchoNous.
	Pour l'UE, Kosmos Trio doit être utilisé à des fins pédagogiques uniquement.
	Pour l'UE, Kosmos AI FAST doit être utilisé à des fins pédagogiques uniquement.

Principaux processus d'examen


Le système Kosmos est utilisé dans trois processus d'examen principaux. Cliquez sur un des liens ci-dessous pour accéder au processus correspondant :

- Le **Processus standard** commence avec la création d'un patient ou la recherche d'un patient existant.
- Le **Processus rapide** commence avec l'examen d'un patient.
- Le **processus FE assisté par l'IA** utilise l'IA pour effectuer les calculs initiaux de la FE. Le processus FE assisté par l'IA n'est pas encore approuvé par la FDA. Au lieu de cela, EchoNous suit les exigences de la **Politique d'application pour les systèmes d'imagerie pendant l'urgence sanitaire publique liée à la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19)**, guide de la Food and Drug Administration pour l'industrie et le personnel, avril 2020.

Processus standard

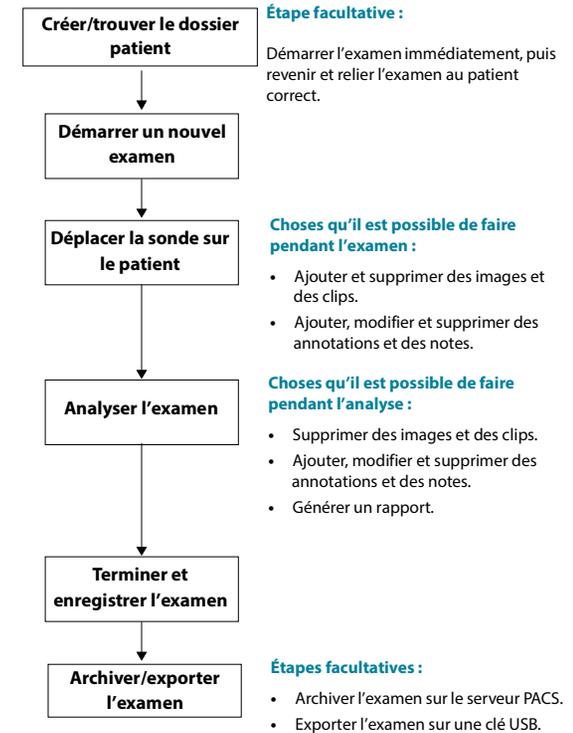


Processus rapide

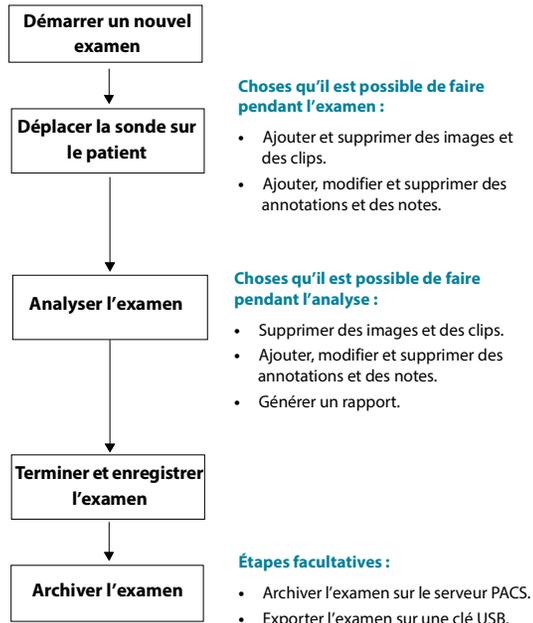

Processus FE assisté par l'IA

Le processus FE assisté par l'IA n'est pas encore approuvé par la FDA. Au lieu de cela, EchoNous suit les exigences décrites de la Politique d'application pour les systèmes d'imagerie pendant l'urgence sanitaire publique liée à la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19), guide de la Food and Drug Administration pour l'industrie et le personnel, avril 2020.

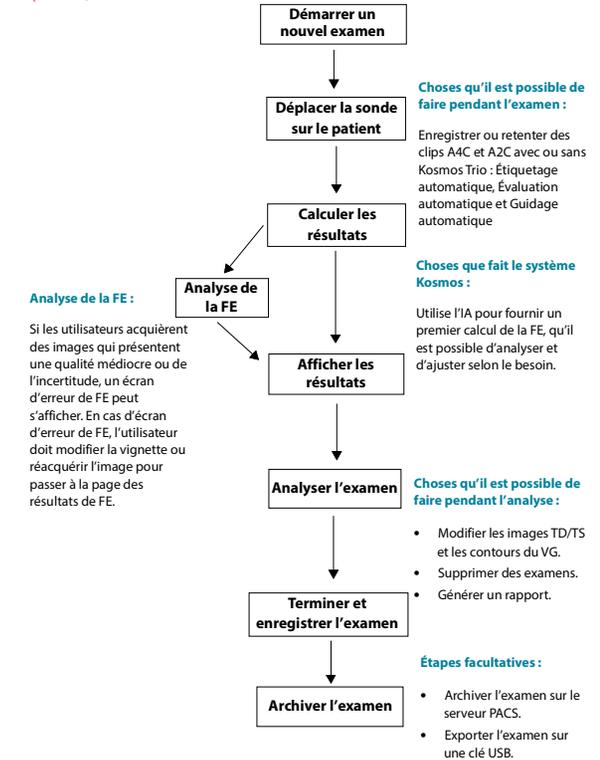

Gestion des examens

Démarrage d'un nouvel examen

Il existe plusieurs façons de démarrer un examen :

- Pour démarrer un examen immédiatement, appuyer sur un préréglage sur l'écran d'accueil et commencer l'examen.
Lors de l'enregistrement de l'examen, le système Kosmos génère automatiquement un ID temporaire et enregistre les images/clips avec cet ID temporaire.
- Depuis l'écran d'accueil, accéder à **PATIENTS** --> **NEW PATIENT** --> **SCAN** (Patients --> Nouveau patient --> Scanner).
 - Utiliser l'icône  comme raccourci pour ajouter un nouveau patient.
- Pour les patients existants, accéder à **PATIENTS** depuis l'écran d'accueil et sélectionner un patient dans la liste des patients --> **SCAN** (Scanner).
- Depuis l'écran d'accueil, accéder à **EXAMS** --> **NEW PATIENT** (Examens --> Nouveau patient) ou rechercher un patient --> **SCAN** (Scanner).

Recherche d'un examen

Pour rechercher un examen :

1. Sur l'écran Exam (Examen), appuyer sur l'icône Chercher .
2. Saisir les critères de recherche, tels que la date ou le nom, la date de naissance ou le numéro de dossier médical du patient.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, appuyer sur l'examen à afficher. Chaque examen de la liste indique le nombre d'échographies réalisées, comme illustré ci-dessous.



Suppression d'examens

Pour supprimer un ou plusieurs examens :

1. Dans la liste des examens, appuyer sur un ou plusieurs des cercles à gauche des examens. Chaque cercle se transforme en coche, indiquant que l'examen correspondant est sélectionné.
2. Appuyer sur l'icône Corbeille .
3. Appuyer sur **OK** dans le message qui s'affiche.

Pour supprimer tous les examens vides (qui ne contiennent pas d'images/de clips) :

1. Dans la liste des examens, appuyer sur l'icône Autres options .
2. Appuyer sur **Delete all empty exams** (Supprimer tous les examens vides).
3. Appuyer sur **OK** dans le message qui s'affiche.

Finalisation des examens

Pour éviter de mélanger les images et les clips sauvegardés de plusieurs patients, veiller à finaliser un examen.

Pour finaliser un examen :

1. Sur l'écran Imaging (Imagerie), appuyer sur l'icône Analyse d'examen .
2. Appuyer sur **Complete** (Terminer).
3. Appuyer sur **OK** dans le message qui s'affiche.

Gestion des données patient

Ajout d'un nouveau patient

Pour ajouter un nouveau patient à partir de l'écran d'accueil :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur l'icône Ajouter  du bouton **PATIENTS**.
2. Saisir les informations du patient.
3. Il est aussi possible de saisir des informations sur l'examen.
4. Appuyer sur **SCAN** (Scanner) une fois terminé.

Accès aux données du patient avec MWL

Si l'on est connecté à un système d'informations de santé et que MWL est configuré sur le système Kosmos, il est possible d'accéder aux informations du patient.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton **PATIENTS**.
2. Appuyer sur le bouton MWL. Appuyer sur l'icône  pour voir la liste en entier.
3. Appuyer sur l'icône  pour rechercher un patient en particulier.
4. Appuyer sur **SCAN** (Scanner) pour lancer l'acquisition.

Recherche d'un patient

Pour rechercher un patient :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **PATIENTS**.
2. Appuyer sur l'icône Chercher .
3. Saisir les critères de recherche du patient, tels que son nom, sa date de naissance ou son numéro de dossier médical.
4. Sélectionner le patient dans la liste des résultats de la recherche, puis appuyer sur **DONE** (Terminé).

Changement de patient

Pour changer de patient ou en ajouter un nouveau alors qu'un examen est déjà démarré :

1. Sur l'écran New Exam (Nouvel examen), appuyer sur **CHANGE** (Changer).
2. Effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Pour changer de patient, appuyer sur **ADD NEW** (Ajouter nouveau), puis remplir le formulaire patient.
 - Pour chercher un patient existant, appuyer sur **SEARCH HISTORY** (Rechercher dans l'historique), utiliser l'outil de recherche pour trouver le patient, puis appuyer sur le nom du patient dans la liste.

Modification d'un dossier patient

Pour modifier un dossier patient :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **PATIENTS**.
2. Dans la liste des patients, appuyer deux fois sur le dossier patient à modifier.
3. Saisir les informations relatives au patient, puis appuyer sur **SAVE** (Enregistrer) une fois terminé.

Fusion de deux dossiers patient

Si plusieurs patients ont été enregistrés sous le même nom et qu'il s'agit en fait du même patient, tous les examens de ce patient peuvent être fusionnés dans un seul dossier patient afin de faciliter le suivi de ce patient.

 Il n'est pas possible de fusionner des patients temporaires.

Pour fusionner deux patients, s'assurer que les champs suivants sont renseignés :

- First name (Prénom)
- Last name (Nom)
- DOB (DDN)
- Gender (Sexe)

Pour fusionner deux dossiers patient :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **PATIENTS**.
2. Sélectionner un des patients.
3. Sur l'écran Patient review (Synthèse du patient), appuyer sur l'icône Autres options .
4. Appuyer sur **Merge to patient** (Fusionner avec patient).
5. Dans la liste, appuyer sur l'autre patient à fusionner.
6. Appuyer sur **NEXT** (Suivant).
7. Appuyer sur les champs à conserver pour le patient.
8. Appuyer sur **MERGE** (Fusionner), puis sur **OK**.

Suppression de dossiers patient

Pour supprimer tous les dossiers patient ne contenant pas d'examens :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **PATIENTS**.
2. Appuyer sur l'icône Autres options .
3. Appuyer sur **Delete all patients without exams** (Supprimer les patients sans examens).

Pour supprimer les dossiers patient sélectionnés :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **PATIENTS**.
2. Appuyer sur un ou plusieurs noms de patients dans la liste des patients.
3. Appuyer sur l'icône Corbeille .

Préréglages d'organes

Le Tableau 4-1 présente les préréglages d'organes disponibles pour chaque sonde Kosmos.

TABLEAU 4-1. Organes préconfigurés par sonde Kosmos

Organe	Torso-One	Lexsa
Cœur	x	
Poumons	x	x
Abdomen	x	
Vasculaire		x
Nerfs		x
AL		x

Modes et fonctionnalités d'imagerie

Pour une présentation des modes d'imagerie applicables à chaque sonde Kosmos, se reporter au Tableau 4-2, « Modes de fonctionnement et fonctionnalités pour Kosmos sur Android et iOS ».

TABLEAU 4-2. Modes de fonctionnement et fonctionnalités pour Kosmos sur Android et iOS

Mode	Torso-One Android	Lexsa Android	Torso-One iOS	Lexsa iOS
Mode B	x	x	x	x
Mode M	x	x	x	x
B+CD (Doppler couleur)	x	x	x	x
Imagerie harmonique	x		x	
Processus FE assisté par l'IA	x		x	
Kosmos Trio	x		x	
Doppler PW	x	x	x	x
TDI	x		x	
Doppler CW	x		x	
AI FAST	x		x	
Color Power Doppler		x		x
Calculs cardiaques	x		x	
Calculs vasculaires		x		x
Préréglage automatique			x	
Doppler automatique (pour le préréglage cardiaque en modes PW et TDI)			x	

2D/Mode B

2D/Mode B est le mode d'imagerie par défaut du système. Il affiche les échos en deux dimensions en affectant un niveau de luminosité en fonction de l'amplitude du signal d'écho.

Les commandes du 2D/Mode B sont cachées lorsque les modes Doppler sont activés. Vous pouvez naviguer entre les commandes du 2D/Mode B et du mode Doppler.

- * Pour afficher les commandes du 2D/Mode B, appuyer sur **2D**.

Mode M

Le mode M est également appelé mode Mouvement. Il génère un tracé dans le temps de l'image. Un seul faisceau d'ultrasons est transmis et les signaux réfléchis sont affichés sous forme de points d'intensité variable qui créent des lignes à l'écran.

Lorsque le mode M est activé, l'écran se divise pour afficher à la fois le mode B et le mode M. La profondeur et le gain (similaire au mode B) peuvent également être réglés parallèlement aux commandes spécifiques du mode M, telles que la ligne M et la vitesse de balayage.

 Lors d'un examen avec la sonde Lexsa, le mode M est uniquement disponible dans le préréglage Poumons.

- * Pour démarrer le mode M, appuyer sur l'icône  du mode M.

Ligne M

- * Pour déplacer la ligne M, passer en mode M avec le doigt, appuyer et faire glisser la ligne M vers l'emplacement souhaité.

Vitesse de balayage

La vitesse de balayage peut être modifiée pour isoler des mouvements individuels.

- * Pour modifier la vitesse de balayage en mode M, appuyer sur **Speed** (Vitesse) et sélectionner : 25, 50, 75 ou 100 mm/sec (mm/s).

Doppler couleur

Le Doppler couleur permet de visualiser la présence, la vitesse et la direction du flux sanguin dans une vaste plage de débits.

Lors de l'utilisation du système Kosmos, le Doppler couleur peut être activé et désactivé sans qu'il n'interfère avec l'acquisition des couleurs du système.

- * Pour activer ou désactiver le Doppler couleur, appuyer sur l'icône Couleur 

Zone couleur

La zone couleur peut être déplacée et redimensionnée pendant l'imagerie. L'organe, la profondeur et d'autres paramètres peuvent néanmoins en limiter la taille axiale et latérale maximale.

- Pour déplacer la zone couleur, sélectionner un de ses côtés et la faire glisser vers une autre position.
- Pour redimensionner la zone couleur, déplacer un des coins pour en ajuster la taille.

Échelle

L'échelle modifie la fréquence de répétition de l'impulsion qui définit l'échelle de vitesse avec la plage affichée en haut et en bas de la table des couleurs.

- * Pour modifier l'échelle, appuyer sur **Scale** (Échelle).

Sensibilité

Trois sélections de plage de sensibilité sont disponibles pour optimiser les gammes basse, moyenne et haute.

- * Pour modifier la sensibilité, appuyer sur **Sensitivity** (Sensibilité), puis sélectionner une option.

Filtre de paroi

Le filtre de paroi est défini sur le filtre le plus élevé bloquant le bruit basse fréquence.

- * Pour modifier le filtre de paroi, appuyer sur **Wall filter** (Filtre de paroi), puis sélectionner l'option appropriée.

Diriger

La fonction Diriger change l'angle de direction de la ROI en couleur. Il existe 5 angles différents.

- * Pour sélectionner l'angle souhaité, appuyer sur **Steer** (Diriger).

 La fonction Steer (Diriger) est disponible uniquement dans le mode Doppler couleur Lexsa.

Artère

Artery (Artère) active la sélection Artère/Veine. L'option Artery (Artère) doit être sélectionnée pour le flux artériel et Vein (Veine) doit être sélectionnée pour le flux veineux.

- * Pour la sélection Artère/Veine, appuyer sur **Artery** (Artère).

 La fonction Artery (Artère) est disponible uniquement dans le mode Doppler couleur Lexsa.

Table des couleurs

Pour modifier la table des couleurs du cœur :

1. Appuyer sur l'icône  située près de la table des couleurs, à droite de l'écran.
2. Sélectionner la table des couleurs souhaitée.
3. Pour inverser la table des couleurs, cocher la case et appuyer sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Color Power Doppler

Le Color Power Doppler (CPD) est utilisé pour mesurer l'amplitude du flux sanguin. Le CPD est plus sensible aux vitesses sanguines inférieures et aux petits vaisseaux.

- * Pour activer ou désactiver le Color Power Doppler, appuyer sur l'icône CPD .

Le Color Power Doppler est disponible en pré-réglage Vasculaire (Vasculaire), Nerve (Nerf) et MSK (Musculosquelettique) lors du balayage avec Kosmos Lexsa.

Doppler pulsé

Le mode Doppler pulsé (PW) utilise de brèves salves d'ultrasons et un processus appelé « décalage temporel » (range gating) pour faciliter l'analyse des signaux à partir d'une petite zone à une profondeur spécifiée de la sonde.

Le mode PW est disponible dans les pré-réglages Abdomen et Heart (Cœur) lors du balayage avec Kosmos Torso-One.

Le mode PW est disponible en pré-réglage Vasculaire (Vasculaire), Nerve (Nerf) et MSK (Musculosquelettique) lors du balayage avec Kosmos Lexsa.

- * Pour démarrer le Doppler pulsé (PW), appuyer sur l'icône du mode PW.

Écran duplex

- * Appuyer sur le bouton Update (Mettre à jour) pour afficher l'écran duplex. L'image figée en mode B apparaît par-dessus le tracé du Doppler en direct.

Point focal et ligne Doppler

- * Ajuster le Focal point (Point focal) et la Doppler line (Ligne Doppler) en déplaçant le cercle en pointillés. Dans le pré-réglage pour l'abdomen, appuyer sur le point focal pour afficher la vue et régler la ligne de correction de l'angle. Si le mode couleur est activé, le déplacement du cercle entraîne également le déplacement de la zone couleur. Le cercle et la zone couleur peuvent être dissociés dans **Settings** --> **Imaging Preferences** (Paramètres --> Préférences d'imagerie).

Ligne de référence

- * Appuyer sur la Baseline (Ligne de référence) et la déplacer vers le haut et vers le bas dans le tracé Doppler.

Affichage en direct

- * Appuyer sur Live display (Affichage en direct) pour basculer entre les modes PW en direct et B en direct. Dans le mode B en direct, le tracé Doppler est figé.

Filtre de paroi

Le Wall filter (Filtre de paroi) aide à filtrer les échos des signaux basse fréquence.

- * Appuyer sur l'icône pour sélectionner la puissance du filtre : Low (Basse), Medium (Moyenne) ou High (Haute).

Inverser

- * Pour inverser le spectre Doppler, appuyer sur le bouton **Invert** (Inverser).

Échelle

L'échelle modifie l'échelle de vitesse.

- * Pour modifier l'échelle, appuyer sur **Scale** (Échelle).

Gain Doppler

Le gain contrôle la luminosité/puissance du spectre Doppler.

- * Pour régler le gain Doppler, appuyer sur **Gain**.

Gain audio

Le gain audio contrôle la puissance du volume du son.

- * Pour régler le gain audio, appuyer sur **Audio gain** (Gain audio).

Vitesse de balayage

Quatre vitesses de balayage sont disponibles.

- * Pour modifier la vitesse de balayage, appuyer sur **Speed** (Vitesse) et sélectionner : 25, 50, 75 ou 100 mm/sec (mm/s).

Imagerie Doppler tissulaire

Le mode Tissue Doppler Imaging (TDI) (Imagerie Doppler tissulaire) utilise le Doppler pour mesurer la vitesse du mouvement du myocarde tout au long du cycle cardiaque.

- * Pour démarrer le mode TDI, appuyer sur l'**icône du TDI mode** (Mode TDI). Le mode TDI est disponible dans les écrans du mode B et du mode couleur (B+C).

Le TDI mode (mode TDI) est uniquement disponible dans les préréglages Abdomen et Heart (Cœur) lors du balayage avec Kosmos Torso-One.

Doppler continu

Le mode Doppler continu (CW) utilise l'émission et la réception continues d'ondes ultrasonores pour mesurer la vitesse du flux sanguin.

<p>Lorsque le mode CW est utilisé de façon prolongée, le figeage automatique est activé pour gérer la température de la sonde. Un temporisateur de 60 secondes apparaît avant chaque figeage automatique.</p>
<p>Le mode CW est uniquement disponible dans les préréglages Abdomen et Cœur lors du balayage avec Kosmos Torso-One.</p>
<p>Certaines tablettes nécessitent le Power Pack pour faire fonctionner Kosmos. Veuillez consulter le site Web d'EchoNous pour plus d'informations.</p>

- * Pour démarrer le Doppler pulsé (CW), appuyer sur l'**icône du CW mode** (Mode CW).

Écran duplex

- * Appuyer sur le bouton **Update** (Mettre à jour) pour afficher l'écran duplex. L'image figée en mode B apparaît par-dessus le tracé du Doppler en direct.

Point focal et ligne Doppler

- * Ajuster le **focal point** (point focal) et la **Doppler line** (ligne Doppler) en déplaçant le cercle en pointillés. Dans le préréglage pour l'abdomen, il est possible d'appuyer sur le point focal pour afficher et régler la ligne de correction de l'angle. Si le mode Couleur est activé, le déplacement du cercle entraîne également le déplacement de la zone couleur. Le cercle et la zone couleur peuvent être dissociés dans **Settings** --> **Imaging Preferences** (Paramètres --> Préférences d'imagerie).

Ligne de référence

- * Appuyer sur la **Baseline** (Ligne de référence) et la déplacer vers le haut et vers le bas dans le tracé Doppler.

Affichage en direct

- * Appuyer sur **Live display** (Affichage en direct) pour basculer entre les modes CW en direct et B en direct. Dans le mode B en direct, le tracé Doppler est figé.

Filtre de paroi

Le Wall filter (Filtre de paroi) aide à filtrer les échos des signaux basse fréquence.

- * Appuyer sur l'icône pour sélectionner la puissance du filtre : Low (Basse), Medium (Moyenne) ou High (Haute).

Inverser

- * Pour inverser le spectre Doppler, appuyer sur le bouton **Invert** (Inverser).

Échelle

L'échelle modifie l'échelle de vitesse.

- * Pour modifier l'échelle, appuyer sur **Scale** (Échelle).

Gain Doppler

Le gain contrôle la luminosité/puissance du spectre Doppler.

- * Pour régler le gain Doppler, appuyer sur **Gain**.

Gain audio

Le gain audio contrôle la puissance du volume du son.

- * Pour régler le gain audio, appuyer sur **Audio gain** (Gain audio).

Vitesse de balayage

Quatre vitesses de balayage sont disponibles.

- * Pour modifier la vitesse de balayage, appuyer sur **Speed** (Vitesse) et sélectionner : 25, 50, 75 ou 100 mm/sec (mm/s).

Enregistrer des clips et des images

- * Appuyer sur Freeze (Figer) pour analyser ou directement enregistrer des images et des clips. Le son est également enregistré dans les clips.

Préréglage automatique (actuellement disponible uniquement pour Kosmos sur iOS)

Lors d'un examen dans un préréglage sélectionné, la fonction Auto Preset (Préréglage automatique) reconnaît l'anatomie et passe automatiquement au préréglage approprié. Cette fonction n'est disponible que pour Torso-One.

- * Pour activer Auto Preset (Préréglage automatique), accéder à **Settings** --> **Imaging Preferences** (Paramètres --> Préférences d'imagerie) et utiliser le bouton bascule pour activer la fonction.

- Les utilisateurs disposent de 3 secondes pour refuser le passage du préréglage sélectionné au préréglage choisi automatiquement.

Si l'utilisateur refuse la transition vers le préréglage choisi automatiquement, la fonction Auto Preset (Préréglage automatique) est désactivée pour le reste de l'examen. Les utilisateurs ont la possibilité de réactiver Auto Preset (Préréglage automatique) en sélectionnant le menu déroulant Preset (Préréglage).

- Consulter le **Tableau 4-3** pour obtenir la liste des scénarios de la fonction Auto Preset (Préréglage automatique).

TABLEAU 4-3. Scénarios de la fonction Auto Preset (Préréglage automatique)

Préréglage sélectionné par l'utilisateur	Anatomie examinée	Préréglage automatique Kosmos
Abdomen	Poumons	Lung (Poumons)
Abdomen	PLAX, PSAX, (AV, VM, PM, APEX), A4C, A2C, A3C, A5C, SSN, RVOT, RVIT	Heart (Cœur)
Lung (Poumons)	RUQ, LUQ, SUP, aorte abdominale (vue sagittale), balayage aortique	Abdomen
Lung (Poumons)	PLAX, PSAX, (AV, VM, PM, APEX), A4C, A2C, A3C, A5C, SSN, RVOT, RVIT, VCI, sous-costale 4C	Heart (Cœur)
Heart (Cœur)	RUQ, LUQ, SUP, aorte abdominale (vue sagittale), balayage aortique	Abdomen
Heart (Cœur)	Poumons	Lung (Poumons)

Doppler automatique (actuellement disponible uniquement pour Kosmos sur iOS)

La fonction Auto Doppler (Doppler automatique) positionne automatiquement la porte Doppler dans les vues sélectionnées. Cette fonction n'est disponible qu'en modes PW et TDI pour Torso-One dans le préréglage cardiaque.

- * Pour activer la fonction Auto Doppler (Doppler automatique), accéder à **Settings** --> **Imaging Preferences** (Paramètres --> Préférences d'imagerie) et utiliser le bouton bascule pour activer la fonction.

- Les utilisateurs auront toujours la possibilité de positionner la porte manuellement lorsque la fonction Auto Doppler (Doppler automatique) est activée.
- Consulter le **Tableau 4-4** pour obtenir la liste des positionnements de porte Doppler automatique.

TABLEAU 4-4. Positionnement de porte Auto Doppler (Doppler automatique) par mode

Mode	Vue	Positionnement de porte
PW	PLAX, RVOT, PSAX AV	PV
PW	A4C	MV, TV
PW	A5C	LVOT
TDI	A4C	Anneau septal VM, anneau latéral VM, anneau latéral TV

Commandes du mode d'imagerie

Retournement d'une image

Seule une image du cœur peut être retournée de droite à gauche.

- * Pour retourner l'image, appuyer deux fois sur le marqueur d'orientation.

Réglage de la profondeur et du gain

Pour régler la profondeur :

- * Pour augmenter ou diminuer la profondeur affichée, appuyer sur **Depth** (Profondeur), puis déplacer la molette de profondeur vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le gain :

- * Pour régler le gain en mode Doppler couleur et en mode B, appuyer sur **Gain** et déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le gain proche et éloigné :

- * Appuyer sur **TGC** et déplacer les curseurs vers la gauche et vers la droite. Les valeurs de gain sont automatiquement mises à jour lorsque les curseurs sont réglés.

Zoom avant et zoom arrière

- En cours d'examen, utiliser deux doigts pour pincer et élargir la zone de l'image.
- Pour rétablir la taille par défaut de l'image, appuyer sur la loupe.
- Le facteur de zoom est indiqué près de la loupe, ainsi que sur l'échelle de profondeur orange le long de la zone de l'image.
- Il est possible de figer l'image lorsqu'elle est agrandie (et d'agrandir et de réduire une image figée).

Figeage d'une image

- * Pour figer une image, appuyer sur l'icône Figer . Les **outils d'annotation** s'affichent automatiquement à gauche de l'écran.

Utilisation du processus FE assisté par l'IA du système Kosmos et Kosmos Trio

	Pour l'UE, Kosmos Trio doit être utilisé à des fins pédagogiques uniquement.
	Pour l'UE, Kosmos AI FAST doit être utilisé à des fins pédagogiques uniquement.

Le processus FE assisté par l'IA sert de guide lors de l'acquisition des données, puis du calcul initial de la FE à l'aide de l'IA, qui repose sur la méthode de Simpson modifiée, ou « méthode des disques », préconisée par l'American Society of Echocardiography (ASE) (Lang 2005, 2015). Les contours du VG initiaux sont générés à l'aide d'algorithmes d'IA définis à partir de contours du VG annotés par un expert (Ronneberger 2015). Il est ensuite possible d'analyser les résultats IA initiaux (qui incluent les images TD/TS et les contours du VG correspondants) et de les ajuster selon le besoin.

Kosmos Trio : Étiquetage automatique, Évaluation automatique et Guidage automatique

Le Kosmos Trio Étiquetage automatique, Évaluation automatique et Guidage automatique peut faciliter l'acquisition en temps réel des vues A4C, A2C et PLAX via :

- l'annotation des structures cardiaques clés ;
- l'évaluation des images selon l'échelle ACEP à 5 niveaux ;
- des instructions indiquant comment déplacer la sonde pour optimiser les images A4C, A2C et PLAX.
- Pour activer une ou plusieurs des fonctions Étiquetage automatique, Évaluation automatique ou Guidage automatique, appuyer sur le bouton Trio et sélectionner les outils à utiliser comme indiqué dans la **Figure 1**.

	<p>Le système Kosmos est un dispositif médical approuvé par la FDA ; toutefois, le nouveau processus FE assisté par l'IA et le nouvel outil Trio n'ont pas encore été approuvés par la FDA. Au lieu de cela, EchoNous® suit la <i>politique d'application pour les systèmes d'imagerie pendant l'urgence sanitaire publique liée à la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19), guide de la Food and Drug Administration pour l'industrie et le personnel, avril 2020</i> pour cette nouvelle fonction. Il existe des avertissements et des mises en garde importants en plus des différents utilisateurs visés et des consignes d'utilisation.</p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, se reporter à la Politique d'application pour les systèmes d'imagerie pendant l'urgence sanitaire publique liée à la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19), guide de la Food and Drug Administration pour l'industrie et le personnel, avril 2020.</p>
	<p>Ne pas se fier à l'outil d'étiquetage automatique du cœur à des fins de diagnostic. Les libellés automatiques aident à s'entraîner et à s'orienter rapidement vers l'anatomie du cœur. Faire preuve de jugement pour s'assurer que les annotations sont correctes.</p>

FIGURE 1.



La Figure 1 montre un exemple de fonctionnement de Kosmos sur iOS Trio avec les trois algorithmes activés.

Tout d'abord, les structures cardiaques clés sont fournies par l'outil Étiquetage automatique.

Lors de l'examen du cœur, les étiquettes qui apparaissent ne sont présentes que lorsque vous êtes en train de procéder à l'examen. Après l'enregistrement de l'image ou du clip, les étiquettes disparaissent.

Cette fonction permet l'annotation/l'étiquetage automatisés en temps réel des principales structures cardiaques dans les vues cardiaques parasternales/apicales et dans la vue sous-costale apicale à quatre cavités. Les structures cardiaques principales incluent les cavités cardiaques, les valvules, les principaux vaisseaux, les muscles papillaires, les septums et les voies ventriculaires d'afflux/d'éjection.

Consulter le tableau 4-5 pour la liste des structures anatomiques disponibles pour chaque écran d'imagerie.

TABLEAU 4-5. Structures anatomiques pour l'écran d'imagerie cardiaque

Écran d'imagerie (cœur)	Structure anatomique*
A2C	LA, LV, MV
A3C (APLAX)	AO, AV, LA, LV, LVOT, MV
A4C	IAS, IVS, LA, LV, MV, RA, RV, TV
A5C	AO, AV, IAS, IVS, LA, LV, LVOT, MV, RA, RV, TV
PLAX	AO, AV, IVS, LA, LV, LVOT, MV, RV
RVOT	IVS, LV, MPA, PV, RVOT
RVIT	IVC, IVS, LV, RA, RV, TV
PSAX-AV	AV, LA, MPA, PV, RA, RVOT, TV
PSAX-MV	IVS, LV, MV, RV
PSAX-PM	AL-PAP, IVS, LV, PM-PAP, RV
PSAX-AP	IVS, LV, RV
Sous-costale-4C	IAS, IVS, LA, foie, LV, MV, RA, RV, TV
IVC sous-costal	IVC, foie
Suprasternale	Arche AO, DA

*AL-PAP = muscle papillaire antéro-latéral

AO = aorte

AV = valve aortique

IAS = septum interatrial

IVC = veine cave inférieure

IVS = septum interventriculaire

LA = oreillette gauche

LV = ventricule gauche

LVOT = voie d'éjection du ventricule gauche

MPA = artère pulmonaire principale

MV = valve mitrale

PM-PAP = muscle papillaire postéro-médial

PV = valvule pulmonaire

RA = oreillette droite

RV = ventricule droit

RVOT = voie d'éjection du ventricule droit

TV = valvule tricuspide

Ensuite, les 4 lignes vertes sur les deux côtés du secteur sont le résultat de l'outil Évaluation automatique et indiquent une qualité d'image de 4 sur 5 d'après l'échelle ACEP à 5 niveaux. Selon l'échelle ACEP, une qualité d'image de 1 et 2 est considérée comme non diagnostique, tandis qu'une qualité d'image de 3, 4 et 5 est considérée comme diagnostique.


Enfin, la **Figure 1** illustre le Guidage automatique avec un graphique montrant la sonde par rapport au torse du patient et indiquant le mouvement de sonde requis pour optimiser la vue A4C et le texte correspondant.

Les images indiquant les mouvements de la sonde et les phrases correspondantes fournies par l'algorithme Guidage automatique pendant l'acquisition A4C, A2C et PLAX sont présentées dans la **Figure 2** et la **Figure 3**.

Toutes les images présentées dans la **Figure 2** et la **Figure 3** apparaissent sous la forme d'animations pour mieux illustrer le mouvement de la sonde.

FIGURE 2. Images indiquant les mouvements de la sonde et les phrases correspondantes pendant les acquisitions A4C et A2C

Guidage automatique A4C

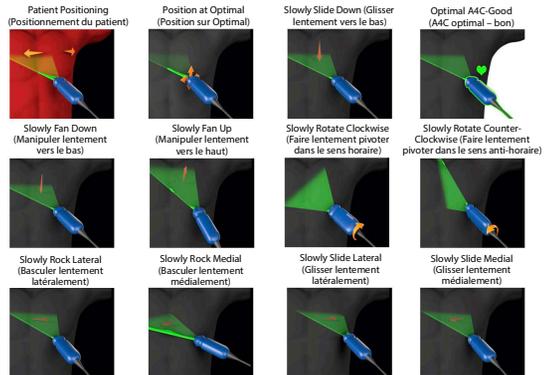

Guidage automatique A2C


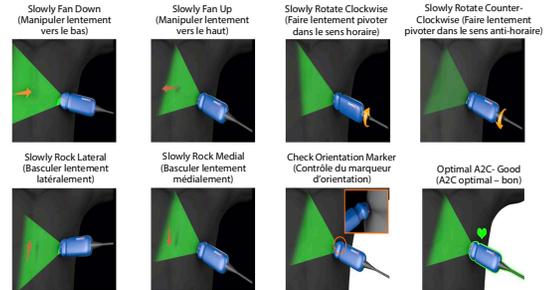


FIGURE 3. Images indiquant les mouvements de la sonde et les phrases correspondantes spécifiques aux acquisitions dans la vue PLAX

Guidage automatique PLAX

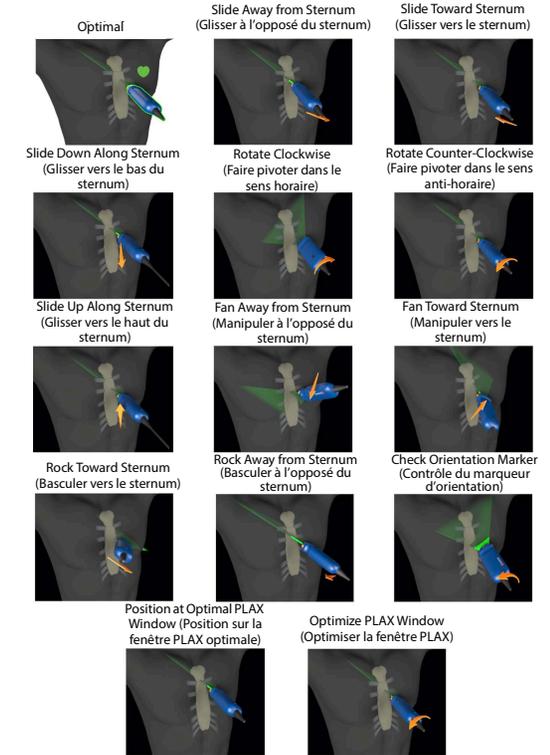

Capture automatique

La fonction Auto Capture (Capture automatique) de Kosmos capture automatiquement des clips de 3 secondes dans les vues A4C, A2C et PLAX lorsque la qualité d'image est égale ou supérieure à 4. L'appareil émet un bip sonore une fois la vidéo prise. Pour éviter d'enregistrer plusieurs clips d'une même vue, le système Kosmos désactive la fonction Auto Capture (Capture automatique). Lorsque les conditions de la fonction Auto Capture (Capture automatique) ne sont pas réunies, essayer la fonction Smart Capture (Capture intelligente) de Kosmos.

Pour activer la fonction Auto Capture (Capture automatique) :

- * Appuyer sur le bouton Trio et activer à l'aide du bouton bascule.

	Il convient de maintenir une qualité d'image de niveau 4 ou 5 pendant 2 secondes pendant que le système Kosmos effectue l'enregistrement.
	La fonction Auto Capture (Capture automatique) doit être activée avant de démarrer l'examen.

Capture intelligente

Si la fonction Auto Capture (Capture automatique) n'est pas enclenchée en raison de la qualité de l'image, la fonction Smart Capture (Capture intelligente) de Kosmos enregistre un clip de qualité inférieure. Lorsqu'une image de qualité inférieure (2 secondes sur 3 d'une qualité d'image égale à 3 ou au-dessus) est prête à être enregistrée, le bouton Smart Capture (Capture intelligente) est vert.

Pour activer la fonction Smart Capture (Capture intelligente) :

- * Appuyer manuellement sur le bouton Smart Capture (Capture intelligente) pour enregistrer un clip.


	La fonction Smart Capture (Capture intelligente) enregistre un clip uniquement lorsque les conditions sont réunies.
	Exigences pour la fonction Smart Capture (Capture intelligente) : une qualité d'image d'au moins 3 est nécessaire pour prendre 2 ou 3 secondes de clip.

Calcul de la FE avec le processus FE assisté par l'IA

Pour calculer la FE :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur l'icône IA (IA).

Appuyer ici pour démarrer le processus FE assisté par l'IA

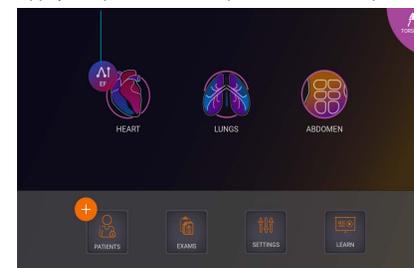

	Lorsque l'on appuie sur l'icône Heart AI (IA du cœur), le système Kosmos crée un nouvel examen qui inclut cette échographie FE.
	Pour l'UE, Kosmos Trio doit être utilisé à des fins pédagogiques uniquement.
	Pour l'UE, Kosmos AI FAST doit être utilisé à des fins pédagogiques uniquement.
	Ne pas s'en remettre au calcul de la FE comme unique critère de diagnostic. Si possible, utiliser le calcul de la FE en conjonction avec d'autres informations cliniques.


- Lorsqu'une vue A4C correcte du patient est affichée, appuyer sur **A4C** pour acquérir un clip. Pour activer un ou plusieurs des outils Étiquetage automatique, Évaluation automatique et Guidage automatique, appuyer sur le bouton Trio et activer les outils souhaités.



- Si le clip enregistré n'est pas satisfaisant, appuyer sur **Try again** (Réessayer) pour acquérir un nouveau clip ou appuyer sur **Accept** (Accepter) pour continuer ; après quatre secondes, le système Kosmos accepte automatiquement le clip.
- Appuyer sur **SKIP** (Ignorer) pour afficher les résultats A4C, ou poursuivre avec l'acquisition A2C.

Pour des calculs plus précis, il est recommandé d'acquérir à la fois des clips A4C et A2C.

- Après l'acquisition des images, l'algorithme évalue la qualité et l'incertitude du clip et il est possible qu'un écran d'erreur de FE s'affiche. Pour poursuivre, vous devrez modifier la vignette ou réacquérir l'image pour supprimer l'erreur de FE.

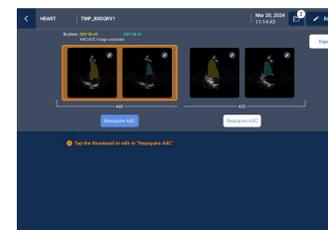

- Lorsqu'une vue A2C correcte du patient est affichée, appuyer sur **A2C** pour acquérir un clip.
- Si le clip enregistré n'est pas satisfaisant, appuyer sur **Try again** (Réessayer) pour acquérir un nouveau clip ou appuyer sur **Accept** (Accepter) pour afficher les résultats A4C/A2C (biplan) ; après quatre secondes, le système Kosmos accepte automatiquement le clip.


Une fois que les clips A4C et A2C sont enregistrés et acceptés, le système sélectionne les images TD et TS, dessine les contours du VG correspondants et calcule la FE biplan à l'aide la méthode de Simpson modifiée, ou « méthode des disques » (20 disques sont utilisés dans le calcul).

Analyse/réglage des images TD/TS et des contours du VG

Lors de l'analyse des calculs IA initiaux sur les images TD/TS et les contours du VG, il est possible d'ajuster seulement les images, les contours du VG ou les deux avant d'enregistrer les résultats. Si aucune modification n'est apportée, les calculs IA sont considérés comme le résultat final.

Pour ajuster les images TD/TS :

1. Sur l'écran Results (Résultats), appuyer sur **Edit** (Modifier) ou sur une des vignettes. Ou appuyer sur **REVIEW** (Analyser) pour analyser les examens précédemment acquis.

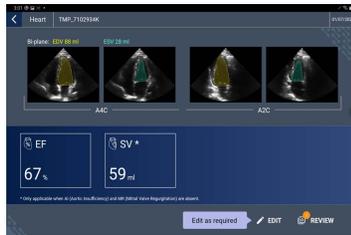

2. Selon le clip à modifier, appuyer sur l'onglet **A4C clip** (Clip A4C) ou **A2C clip** (Clip A2C).
3. Pour définir une autre image TD ou TS, déplacer le curseur orange Seek (Rechercher) sur l'emplacement souhaité et appuyer sur **SET ED** (Régler TD) ou **SET ES** (Régler TS).




4. Pour rétablir les calculs IA d'origine, appuyer sur l'icône Autres options ; , puis sur **Reset** (Rétablir).
5. Le cas échéant, apporter des modifications à l'autre clip (A4C ou A2C) et appuyer sur **SAVE** (Enregistrer).

Pour ajuster les contours du VG :

	Pour ajuster les contours du VG avec des gants, veiller à ce que ces derniers soient bien plaqués contre les doigts/ongles.
	La présence de gel sur les doigts peut rendre l'utilisation de l'écran tactile compliquée. Veiller à essuyer l'écran tactile régulièrement.

1. Sur l'écran Results (Résultats), appuyer sur une des quatre images pour l'afficher. Si aucune image n'est spécifiée, le système Kosmos affiche l'image A4C par défaut.
2. Selon le clip à ajuster, appuyer sur l'onglet **A4C clip** (Clip A4C) ou **A2C clip** (Clip A2C).
3. Pour sélectionner une image TD ou TS, appuyer sur l'onglet **A4C clip** (Clip A4C) ou **A2C clip** (Clip A2C).
4. Appuyer sur le contour du VG. Le contour du VG devient orange et peut être ajusté.

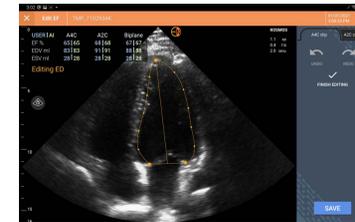

5. Sélectionner et déplacer un ou plusieurs points de contrôle.

Les calculs sont mis à jour à mesure que le contour est ajusté.


6. Une fois les modifications terminées, appuyer sur **Finish editing** (Terminer la modification).
7. Le cas échéant, apporter d'autres modifications.
8. Appuyer sur **SAVE** (Enregistrer).

Recommandations pour acquérir des clips A4C et A2C de qualité optimale pour des calculs précis de la FE

EchoNous émet les recommandations suivantes :

- Le patient doit être allongé sur le côté en décubitus latéral gauche (côté gauche du patient contre la table d'examen).

Les images ci-dessous sont des exemples d'images de référence A4C et A2C cliniquement acceptables, qui sont affichées dans le coin supérieur gauche de l'écran :

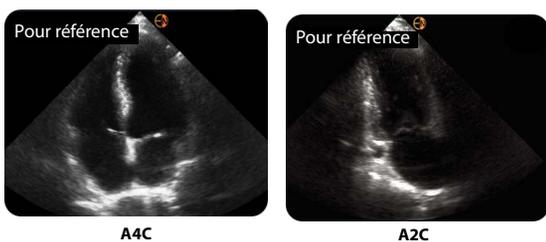

- Pour un clip A4C, s'assurer que les quatre cavités du cœur (ventricule gauche, oreillette gauche, ventricule droit et oreillette droite) sont capturées dans l'échographie (voir l'image de référence A4C ci-dessus).
- Pour un clip A2C, s'assurer que le ventricule gauche et l'oreillette gauche sont tous deux capturés dans l'échographie (voir l'image de référence A2C ci-dessus). Veiller à ce que le contour endocardique du VG soit clairement visible avec le meilleur contraste possible. Utiliser les paramètres de gain pour définir le contour endocardique du VG avec précision.
- Ajuster la profondeur de façon à afficher les oreillettes vers le bas de l'échographie sans les masquer (voir les images de référence A4C et A2C ci-dessus).
- Éviter de tronquer le VG.
- Éviter de rétrécir le VG.
- Pour un clip A4C, s'assurer que la paroi septale intraventriculaire (la paroi qui se situe entre les ventricules gauche et droit) est verticale (voir l'image de référence A4C ci-dessus).

- Pour un clip A4C, veiller à orienter le marqueur orange du Kosmos Torso-One vers la table d'examen pour éviter d'acquérir une image inversée.
- Lorsqu'une vue A4C correcte est affichée, tourner la sonde de 90 degrés vers la gauche pour trouver la vue A2C.
- Demander au patient de ne pas respirer pendant l'enregistrement du clip.
- Analyser les résultats pour s'assurer que les images TD/TS et les contours du VG sont corrects, et les ajuster selon le besoin à l'aide de l'outil d'édition Kosmos.

Conditions d'erreur et notifications système pour le processus FE assisté par l'IA Kosmos

- Si l'échographie FE obtenue (initiale et/ou après ajustements) est en dehors de la plage 0 %-100 %, il est impossible d'enregistrer le résultat de la FE dans le rapport ou d'exporter/archiver l'échographie.

Il faut d'abord modifier les images TD/TS et les contours du VG correspondants pour produire une FE valide. Les résultats peuvent alors être enregistrés et l'échographie exportée/archivée.

- Le système Kosmos invite l'utilisateur à modifier les résultats ou à scanner à nouveau si une des conditions suivantes survient :
 - VTS > 400 ml.
 - VTD > 500 ml.
 - Différence de FE entre A4C et A2C supérieure à 30 %.

Acquisition d'images et de clips

Pour acquérir une image :

- Sur l'écran Imaging (Imagerie), appuyer sur l'icône Enregistrer l'image

Pour acquérir un clip :

- Sur l'écran Imaging (Imagerie), appuyer sur l'icône Enregistrer un clip

Finalisation d'un examen

1. Sur l'écran Imaging (Imagerie), appuyer sur l'icône Analyse d'examen .
2. Appuyer sur **COMPLETE** (Terminer).

Si **COMPLETE** (Terminer) n'est pas sélectionné sur l'écran Exam review (Analyse d'examen), le système Kosmos finalise automatiquement l'examen :

- au démarrage d'un nouvel examen ;
- lorsque l'examen en cours est archivé ;
- au bout de quelques minutes ;
- à la fermeture de l'application ;
- à l'ouverture d'une autre application quand l'application Kosmos passe en arrière-plan.

Mesures cardiaques de Kosmos

 Ne pas s'en remettre aux mesures cardiaques de Kosmos comme uniques critères de diagnostic. Si possible, utiliser les mesures cardiaques de Kosmos en conjonction avec d'autres informations cliniques.

Le pack Kosmos Calculs cardiaques de Kosmos fournit les outils pour examiner la structure et la fonction cardiaque. Les mesures cardiaques de Kosmos sont disponibles dans le mode B, le mode Doppler et le mode M.

Lors de l'Exam review (Analyse d'examen), les outils de calculs cardiaques et les annotations sont utilisés pour effectuer des mesures cardiaques.

Pour accéder aux outils de calcul cardiaque :

- * Sur l'écran Exam Review (Analyse d'examen), appuyer sur **Calc**.

Pour accéder aux outils d'annotation :

- * Sur l'écran Exam Review (Analyse d'examen), appuyer sur **Annotate** (Annoter).

Pour obtenir une liste des mesures, reportez-vous au Tableau 4-6, « Mesures cardiaques par mode ».

Au cours de l'analyse de la cinétique Doppler, vous pouvez réaliser les actions suivantes :

1. Réaliser des mesures Doppler
 - VTI : En appuyant sur VTI, on peut sélectionner l'option de tracé VTI Auto ou Manual (Manuel).
 - En sélectionnant Auto, choisir le signal à tracer souhaité et l'appareil trace le signal automatiquement.
 - En sélectionnant Manual (Manuel), l'appareil demande de tracer le signal manuellement à l'aide du doigt.
 - Modifier le tracé VTI en déplaçant les points de contrôle.
 - Choisir un autre pic en appuyant deux fois dessus.

 Noter que le tracé automatique n'est pas disponible pour la VTI de la valve mitrale dans les tracés PW et CW. Le tracé automatique est uniquement disponible dans Annotations ou pour VTI LVOT (PW) et AV VTI (CW).

- PHT et vitesse delta : déplacer les deux points de mesure des curseurs vers l'emplacement adéquat sur le spectre Doppler.
- Vitesse et PG : déplacer le curseur vers l'emplacement souhaité.
- Il est possible de réaliser 3 mesures de PHT, 3 mesures de vitesse et 3 mesures de VTI par image/clip.
 - Seuls trois cadres en boucles ciné 2D peuvent être placés.
 - Seulement trois mesures VTI possibles à la fois.

 Un message est envoyé indiquant que la mesure est pleine dans le rapport en cas de tentative de placer une 4^e mesure. Il est possible d'effacer une mesure dans le rapport pour faire de la place pour une nouvelle mesure.

2. Ajouter des annotations :
 - Texte
 - Marqueur
3. Déplacer la ligne de référence

4. Inverser le spectre Doppler
5. Afficher les mesures en appuyant sur l'icône Rapport 
 - Lors de la lecture du rapport, la dernière mesure prise est la mesure par défaut. Cependant, en cliquant sur Last (Dernier), l'appareil calculera la valeur moyenne ou fournira la valeur maximale de chaque mesure.

TABLEAU 4-6. Mesures cardiaques par mode

Mesures 2D	
PLAX	RVIDd, IVSd, LVIDD, LVPWd, LVIDS, LA diam, LVOTd
Cœur droit	VD basal, VD moyen, longueur VD
Valve mitrale	Diamètre de l'anneau de la VM
Valve aortique	Anneau, sinus, jonction ST, AO ascendante, veine contractée, diamètre LVOT
IVC	IVC min, IVC max, RAP
Mesures Doppler	
PW	Cœur droit : PV AcT (temps d'accélération) Valve mitrale : MV VTI (PW), vitesse onde E, temps de décélération, vitesse onde A Aorte : ITV LVOT (PW) Diastologie : Vitesse onde E (PW), vitesse onde A, temps de décélération (PW) Valve aortique : ITV LVOT (PW)
CW	Cœur droit : TR (CW), PAEDP (CW), PR (CW) Valve mitrale : MV VTI (CW), temps de demi-pression (CW) Valve aortique : AV VTI (CW), vitesse de pic de vitesse AV, temps de demi-pression (CW) Diastologie : TR (CW)
TDI	Cœur droit : Anneau VT Valve mitrale : e'-point (m/s), a'-point (m/s) Diastologie : e'-point (m/s), a'-point (m/s)
Mesures du mode M	
Mode M	EPSS, TAPSE, MAPSE, IVC min, IVC max, HR, RAP

Kosmos AI FAST

 Ne pas se fier uniquement à l'outil AI FAST à des fins de diagnostic. Kosmos AI FAST aide les utilisateurs en leur fournissant une orientation rapide sur l'anatomie de l'abdomen. Les utilisateurs doivent faire preuve de discernement pour s'assurer que les annotations sont correctes.

Utilisation de Kosmos AI pour un examen FAST

Kosmos AI FAST fournit l'étiquetage anatomique automatisé et l'identification de vue pour l'examen FAST en temps réel. Les étiquettes qui s'affichent pendant la numérisation ne sont présentes que pendant la numérisation ; elles disparaissent une fois l'image ou le clip enregistré.

Consulter le tableau 4-7 pour la liste des structures anatomiques disponibles pour chaque écran d'imagerie de l'examen FAST.

TABLEAU 4-7. Structures anatomiques pour les examens FAST

Vue FAST	Structures anatomiques
RUQ	Foie, rein droit, diaphragme, vésicule biliaire, IVC Espace pouvant contenir du liquide : espace hépatorénal, pleural
LUQ	Rate, rein gauche, diaphragme Espace pouvant contenir du liquide : espace spléno-rénal, espace pleural
SUP	Vessie Espace pouvant contenir du liquide : espace rétro-vésical (homme), espace recto-utérin (femme)
SUB	Cœur, diaphragme, foie Espace pouvant contenir du liquide : péricarde
AS	Foie, aorte transverse, IVC transverse
IVC	Foie, IVC sagittale
Aorte	Foie, Aorte sagittale
A4C A2C PLAX	Cœur Espace pouvant contenir du liquide : péricarde
PSAX	Cœur
SUB2	Foie, cœur, IVC, aorte Espace pouvant contenir du liquide : péricarde

Pour activer Kosmos AI FAST :

- * Dans le pré réglage Abdominal, appuyer sur **AI** (IA).

 Lors de l'examen avec une sonde Torso-One, la fonction Kosmos AI FAST est uniquement disponible dans le pré réglage Abdomen.

Calculs vasculaires Kosmos

 Ne pas s'en remettre aux mesures vasculaires de Kosmos comme uniques critères de diagnostic. Si possible, utiliser les mesures vasculaires de Kosmos en conjonction avec d'autres informations cliniques.

Le pack Calculs vasculaires de Kosmos fournit les outils pour examiner la structure et la fonction cardiaque. Les mesures vasculaires Kosmos sont uniquement disponibles en mode 2D et Doppler PW lors du balayage avec Kosmos Lexsa.

Voir le tableau 4-8 Mesures et calculs vasculaires par mode pour une liste des mesures vasculaires.

 Veuillez noter que DICOM SR n'est pas disponible pour le rapport sur les calculs vasculaires.

TABLEAU 4-8. Mesures et calculs vasculaires par mode

Mesures et calculs en mode 2D et Doppler PW	
Veineux	Pic systolique, fin diastolique, temps de reflux, diamètre des vaisseaux, moyenne temporelle maximale, moyenne temporelle, VTI (greffons)
Artériel	Pic systolique, fin diastolique, VTI, diamètre des vaisseaux, moyenne temporelle maximale, moyenne temporelle
Calculs	Rapport S/D, indice de pulsativité, indice de résistance, volumes d'écoulement

Kosmos UP (Plate-forme universelle) clinique

Kosmos UP est une plate-forme en ligne conforme à la norme HIPAA, conçue pour faciliter l'archivage, l'assurance qualité et les mesures de performance.

Pour de plus amples informations concernant Cosmos UP, contacter un représentant EchoNous.

	Kosmos UP est uniquement disponible aux États-Unis,
	Tous les logiciels appartenant à Us2.ai installés sur l'appareil Cosmos UP sont régis par les conditions générales du Contrat de licence utilisateur final de Us2.ai (« CLUF Us2.ai ») et les accords intégrés. Toute question ou demande concernant les logiciels Us2.ai doit être soulevée conformément au CLUF Us2.ai.

Us2.ai et Cosmos (Android uniquement)

L'intégration du logiciel Us2.v1 de Us2.ai sur Cosmos fournit des processus cliniques automatiques qui reconnaissent et analysent les images 2D et Doppler, ce qui permet d'effectuer des mesures cardiaques automatiques ainsi que des diagnostics, des prédictions et des pronostics de maladie cardiaque.

Mise en route

Les licences d'utilisation du logiciel Us2.v1 de Us2.ai sont disponibles à l'achat pour les organisations.

1. Pour acheter une licence d'utilisation du logiciel Us2.v1 avec Cosmos, contacter un représentant EchoNous.
2. Une fois la licence acquise, les utilisateurs reçoivent des identifiants pour connecter leur tablette Android au cloud Us2.ai.

Pour utiliser Cosmos et le logiciel Us2.v1 de Us2.ai sur une tablette, procéder comme suit :

1. Utiliser les identifiants de connexion à Us2.ai sur la tablette.
2. Brancher la sonde, sélectionner le pré réglage et lancer l'examen.
3. Une fois l'examen terminé, appuyer sur l'icône Us2 sous Exam Review (Analyse d'examen) pour envoyer.
4. Appuyer sur l'icône de rapport pour afficher les mesures cardiaques.

Le logiciel Us2.v1 de Us2.ai est enregistré en tant que dispositif médical indépendant et peut ne pas être disponible en fonction du pays. Pour de plus amples informations concernant Us2.ai, contacter le représentant EchoNous.

	Une version électronique du Guide rapide de Cosmos et Us2.ai est disponible sur le site Web d'EchoNous à l'adresse suivante : echonous.com/product/resources .
	Us2.ai est un produit tiers. EchoNous rejette toutes responsabilités et garanties explicites/implicites pour les services de Us2.ai. Les clients reconnaissent qu'EchoNous n'offre aucune garantie quant à l'adéquation de services tiers à l'usage prévu. Les services Us2.ai sont régis par les conditions générales et garanties/exclusions de responsabilité de Us2.ai. Pour plus d'informations, consulter http://us2.ai/terms-conditions/ .
	Tous les logiciels appartenant à Us2.ai installés sur l'appareil Cosmos UP sont régis par les conditions générales du Contrat de licence utilisateur final de Us2.ai (« CLUF Us2.ai ») et les accords intégrés. Toute question ou demande concernant les logiciels Us2.ai doit être soulevée conformément au CLUF Us2.ai.

19Labs et Cosmos (Android uniquement)

L'intégration du logiciel GALE de 19Labs et de Cosmos permet le téléguidage de Cosmos sur Android. Les fonctionnalités incluent le lancement d'un appel virtuel sécurisé auprès d'une clinique, l'affichage d'échographies, et l'enregistrement des clips et des images directement sur la page de résumé d'un patient.

Mise en route

Les licences d'utilisation du logiciel GALE de 19Labs sont disponibles à l'achat pour les organisations et sont requises pour utiliser Kosmos avec le logiciel GALE de 19Labs.

1. Pour acheter une licence d'utilisation du logiciel GALE avec Kosmos, contacter un représentant EchoNous. Votre représentant EchoNous collaborera avec 19Labs pour configurer la licence de votre organisation.
2. Une fois la licence accordée, 19Labs configurera le compte administrateur 19Labs de votre organisation.

Pour utiliser Kosmos et le logiciel GALE de 19Labs sur une tablette, procéder comme suit :

1. Télécharger le logiciel GALE sur votre tablette Android avec l'aide d'un représentant 19Labs.
2. Ouvrir l'application 19Labs et, à partir de la page Measurements (Mesures), appuyer sur l'application de lancement de Kosmos.
3. Brancher la sonde Kosmos, sélectionner le pré-réglage et lancer l'examen.

19Labs est un dispositif médical enregistré et peut ne pas être approuvé dans votre région. Pour de plus amples informations concernant Kosmos et 19Labs, contacter le représentant EchoNous.

	Une version électronique du Guide rapide de Kosmos et 19Labs est disponible sur le site Web d'EchoNous à l'adresse suivante : echonous.com/product/resources .
	19Labs est un produit tiers. EchoNous rejette toutes responsabilités et garanties explicites/implicites pour les services de 19Labs. Les clients reconnaissent qu'EchoNous n'offre aucune garantie quant à l'adéquation de services tiers à l'usage prévu. Les services 19Labs sont régis par les conditions générales et garanties/exclusions de responsabilité de 19Labs. Pour plus d'informations, contacter info@19labs.com .

-- Fin de la section --

Analyse d'un examen

Lorsqu'un examen a été finalisé, aucune image ne peut y être ajoutée. Cependant, avant d'archiver l'examen, il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer des annotations.

Une fois le processus d'archivage commencé, aucune modification ne peut plus être apportée à l'examen.

Démarrage de l'analyse d'un examen

- Pour démarrer une analyse en cours d'examen, appuyer sur l'icône Analyse d'examen .
- Pour démarrer l'analyse d'un examen finalisé, effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **EXAMS** (Examens), puis sur l'examen à analyser.
 - Dans la liste des patients, trouver le patient, puis appuyer sur l'examen à analyser.

Annotation des images et des clips

Il est possible d'ajouter des annotations en cours d'examen sur l'image figée ou après avoir finalisé l'examen. Toutes les annotations sont enregistrées sous forme de calques sur l'image ou le clip.

 Il n'est pas possible d'annoter des images ou des clips archivés.

Navigation vers l'écran Modifier l'image

Pendant l'examen d'un patient :

1. Appuyer sur l'icône Figer .
2. Ajouter des annotations.
3. Appuyer sur l'icône Enregistrer l'image  ou Enregistrer un clip .

Une fois l'examen du patient terminé :

1. Appuyer sur l'icône Analyse d'examen .
2. Appuyer sur l'image/le clip à annoter.
3. Appuyer sur l'icône Modifier .

Sur l'écran d'accueil :

1. Appuyer sur **Exam** (Examen).
2. Appuyer sur la ligne de l'examen à modifier.
3. Appuyer sur le clip à annoter.
4. Appuyer sur l'icône Modifier .

Sur l'écran Patient :

1. Appuyer sur un patient dans la liste.
2. Appuyer sur l'examen.
3. Appuyer sur l'image/le clip à annoter.
4. Appuyer sur l'icône Modifier .

Outils d'annotation

Des annotations peuvent être ajoutées sur des images et des clips individuels.

Une annotation (texte, mesures, pointeur, zone) ajoutée sur un clip ou une ciné apparaît sur toutes les images.

Il est également possible de masquer le calque des annotations ajoutées en appuyant sur l'icône Masquer le calque  sur les images et les clips enregistrés.

Mesure avec un curseur

Il est possible d'ajouter jusqu'à deux curseurs par image/clip.

Si aucun curseur n'est sélectionné lorsque l'on commence à faire glisser un des deux points de mesure du curseur, ce dernier est sélectionné et redimensionné en fonction de l'endroit vers lequel il est déplacé.

Pour prendre une mesure :

1. Sur l'écran Edit image (Modifier l'image) ou Edit clip (Modifier le clip), appuyer sur **DISTANCE**. Un curseur apparaît au centre de l'image ou du clip.
2. Appuyer dessus pour le sélectionner.

 La distance du curseur s'affiche dans la légende, en haut à gauche de l'écran. Si plusieurs curseurs sont présents, ils sont affichés dans des couleurs différentes.

3. Pour redimensionner le curseur, appuyer sur un de ses points de mesure et le faire glisser.
4. Pour déplacer le curseur, appuyer n'importe où dessus sauf sur ses points de mesure.
5. Pour effacer le curseur, appuyer sur une zone vide en dehors du curseur.

Zoom avant et zoom arrière

Utiliser deux doigts pour pincer et élargir la zone de l'image. Pour rétablir la taille « normale » de l'image, appuyer sur la loupe. Le facteur de zoom est indiqué près de la loupe, ainsi que sur l'échelle de profondeur orange située le long. Il est possible de figer l'image alors qu'elle est agrandie (et d'agrandir/réduire une image figée).

Suppression d'annotations

- * Pour supprimer une annotation, appuyer dessus pour la sélectionner, puis appuyer sur **DELETE** (Supprimer).
- * Pour supprimer toutes les annotations qui ont été créées, appuyer sur **CLEAR ALL** (Supprimer tout).

Gestion des images et des clips

Filtrage des images et des clips

Lors de l'analyse d'un examen, toutes les images et tous les clips, indépendamment du type d'examen (cœur, poumons, abdomen), sont visibles dans la liste des vignettes.

Les images et les clips peuvent être filtrés comme suit :

- Ouvrir la liste des vignettes en la faisant glisser pour afficher les options de filtrage.
- Appuyer sur l'icône Filtre en haut de la liste des vignettes pour afficher les options de filtrage.
- Appuyer sur l'icône Autres options  de la barre de titre, puis sur **Filter images and clips** (Filtrer les images/clips). Lorsque les options de filtrage sont visibles, une coche bleue apparaît près de **Filter images and clips** (Filtrer les images/clips).

Lorsqu'un filtre est sélectionné, seuls les images/clips marqués sont visibles dans la liste des vignettes. Pour marquer des images et des clips, appuyer sur l'icône étoile située sous chaque image/clip dans la liste des vignettes afin qu'elle devienne jaune.

Pour désactiver les filtres sélectionnés, appuyer sur l'icône Autres options , puis à nouveau sur **Filter images and clips** (Filtrer les images/clips).

Sélection d'images et de clips

Pour sélectionner des images et des clips :

1. Appuyer sur l'icône Autres options , puis sur **Select images and clips** (Sélectionner des images/clips).
2. Sélectionner les images et les clips souhaités. Une coche grise apparaît dans le coin supérieur droit de la vignette.
3. Ou appuyer sur la coche dans la vignette : elle devient rouge et un chiffre encerclé apparaît pour indiquer le nombre d'images et de clips sélectionnés. Pour effacer la coche rouge, appuyer de nouveau dessus.

Pour effacer les sélections, appuyer sur l'icône Autres options , puis sur **Select images and clips** (Sélectionner des images/clips).

Découpage et enregistrement d'images et de clips

Pour découper et enregistrer un clip :

1. Appuyer sur l'icône Figer .
2. Déplacer les points de mesure droit et gauche du clip de la ciné.
3. Appuyer sur l'icône Clip .

Pour découper et enregistrer une image :

1. Sur l'écran Exam review (Analyse d'examen), localiser le clip enregistré.
2. Appuyer sur **EDIT** (Modifier).
3. Déplacer les points de mesure droit et gauche de l'image.
4. Appuyer sur **SAVE** (Enregistrer).

Suppression d'images et de clips

Pour supprimer des images et des clips :

1. Appuyer sur l'icône Autres options  , puis sur **Select images/clips** (Sélectionner des images/clips).
2. Sélectionner les images et les clips à supprimer.
3. Appuyer sur **DELETE** (Supprimer) et sur **OK** dans le message qui s'affiche.

Affichage et modification d'un rapport

 Les rapports ne sont pas encore encapsulés dans le fichier DICOM. Seuls les images et les clips sont visibles à cette étape.

Le rapport d'examen permet d'afficher les informations sur le patient et ses examens, les notes textuelles, les notes vocales, les photos prises, les images et les clips.

Ouverture d'un rapport

Pour ouvrir un rapport, appuyer sur **REPORT** (Rapport).

Modification d'un rapport

Une fois le rapport ouvert, chaque section est développée aux fins de l'analyse. Appuyer sur le bouton fléché pour réduire chaque section. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton fléché pour développer de nouveau la section.

Chaque section du rapport est modifiable, à l'exception des informations patient. Elles sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées.

Modification des informations d'un examen

La section sur les informations de l'examen affiche les informations relatives à l'examen saisies avant qu'il ne soit effectué.

Pour modifier les informations de l'examen :

1. Appuyer sur l'icône Modifier  .
2. Mettre la section à jour selon le besoin.

Ajout d'une note textuelle

Il est possible d'ajouter des notes textuelles, qui apparaîtront sous chaque examen.

Pour ajouter une note textuelle :

1. Appuyer sur l'icône Ajouter du texte. Une zone de texte, et la date et l'heure apparaissent sous la dernière note textuelle.
2. Saisir la note sur le clavier.
3. Appuyer sur **DONE** (Terminé).

Modification d'une note textuelle

Pour modifier une note textuelle :

1. Appuyer sur une note textuelle existante. Une zone de texte contenant la note existante et le clavier apparaissent.
2. Modifier la note sur le clavier.
3. Appuyer sur **DONE** (Terminé).

Suppression d'une note textuelle

Pour supprimer une note textuelle :

1. Appuyer longuement sur une note textuelle existante. Un bouton de suppression apparaît.
2. Appuyer sur **DELETE** (Supprimer) et sur **OK** dans le message qui s'affiche.

Exportation d'images et de clips sur une clé USB

Pour exporter des images et des clips, utiliser une clé ou un adaptateur Micro USB.

Des images et des clips peuvent être exportés à partir d'un ou de plusieurs examens.

 Pour protéger les données patient, prendre les précautions appropriées lors de l'exportation de données patient sur une clé USB.

Pour exporter des images et des clips d'un examen sur une clé USB :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **EXAMS** (Examens).
2. Appuyer sur une ligne pour sélectionner un examen.
3. Appuyer sur l'icône signet située sous chaque vignette à exporter. (Étape facultative à suivre uniquement si l'on ne souhaite exporter qu'une partie des images et des clips.)
4. Raccorder la clé USB à l'aide de l'adaptateur USB-C.
5. Appuyer sur **EXPORT** (Exporter). Une boîte de dialogue apparaît.
6. Sélectionner le type de fichier et l'option pour exporter toutes les images et tous les clips, ou les images et clips marqués seulement.
7. Appuyer sur **OK** pour démarrer l'exportation vers la clé USB.

Pour exporter des images et des clips de plusieurs examens sur une clé USB :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **EXAMS** (Examens).
2. Appuyer sur les cercles près de chaque examen à exporter.
3. Raccorder la clé USB à l'aide de l'adaptateur USB-C.
4. Appuyer sur l'icône Exporter  en haut de l'écran. Une boîte de dialogue apparaît.
5. Sélectionner le type de fichier et l'option pour exporter toutes les images et tous les clips, ou les images et clips marqués seulement.
6. Appuyer sur **OK** pour démarrer l'exportation vers la clé USB.

Le tableau suivant décrit les icônes d'exportation.

-  Examen en attente d'exportation.
-  Exportation en cours.
-  Exportation terminée.
-  Échec de l'exportation.

Finalisation de l'analyse d'un examen

Pour finaliser un examen :

1. Appuyer sur **COMPLETE** (Terminer).
2. Appuyer sur **OK** dans le message qui s'affiche.

Archivage d'un examen sur un serveur PACS

Lorsqu'un examen a été finalisé, il peut être archivé sur un serveur PACS. Une fois archivé, un examen ne peut plus être modifié.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur PACS, voir **DICOM**.

Pour chaque échographie FE, plusieurs images/clips sont archivés et exportés.

Le tableau suivant décrit les icônes d'archivage.

-  Examen en attente d'archivage.
-  Archivage en cours.
-  Archivage terminé.
-  Échec de l'archivage.

Il est possible d'archiver un examen à partir des écrans Exam list (Liste des examens) ou Exam review (Analyse d'examen).

Pour archiver un examen à partir de l'écran Exam list (Liste des examens) :

1. Sur l'écran Exam list (Liste des examens), sélectionner le ou les examens finalisés à archiver.
2. Appuyer sur l'icône Archiver . L'examen finalisé est archivé conformément aux options d'archivage par défaut. Pour plus d'informations, voir **DICOM**.

Pour archiver un examen à partir de l'écran Exam review (Analyse d'examen) :

1. Sur l'écran Exam review (Analyse d'examen), appuyer sur **ARCHIVE** (Archiver).
2. Sur l'écran Archive exam to PACS server (Archiver l'examen sur le serveur PACS), sélectionner les images et les clips à archiver et indiquer si un rapport doit être inclus.

3. Appuyer sur **OK**, puis de nouveau sur **OK** dans le message qui s'affiche.

Suppression d'un examen

Pour supprimer un examen à partir de Exam list (Liste des examens) :

1. Appuyer sur l'icône à gauche de l'examen à supprimer. L'icône se transforme en coche .
2. Appuyer sur l'icône Corbeille .
3. Appuyer sur **OK** dans le message qui s'affiche.

Pour supprimer un examen en cours d'analyse :

1. Appuyer sur l'icône Autres options .
2. Appuyer sur **Delete the exam** (Supprimer l'examen).
3. Appuyer sur **OK** dans le message qui s'affiche.

PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE

Protections de sondes Kosmos

En cas de risque de contamination par des fluides, recouvrir la sonde utilisée (Kosmos Torso-One ou Kosmos Lexsa) d'une protection stérile CIVCO appropriée, qui favorise l'asepsie et minimise le nettoyage.

▲	Noter que certains patients sont allergiques au latex. Certaines protections Kosmos disponibles dans le commerce contiennent du latex.
▲	Pour éviter toute contamination croisée, l'utilisation de protections de sonde stériles et de gel de contact stérile est recommandée pour les applications cliniques faisant intervenir un contact avec une peau présentant des lésions.
▲	Certaines protections contiennent du latex de caoutchouc naturel et du talc susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles.
▲	Pour les applications cliniques dans lesquelles une sonde Kosmos risque d'être éclaboussée par du sang ou d'autres fluides corporels, utiliser des protections dont la commercialisation a été approuvée.
▲	Pour empêcher toute contamination croisée, utiliser des protections stériles et du gel de contact stérile dont la commercialisation a été approuvée. Appliquer la protection et le gel de contact juste avant de procéder à l'examen. Après utilisation, retirer et jeter la protection à usage unique, et nettoyer et désinfecter la sonde Kosmos à l'aide d'un désinfectant de haut niveau recommandé par EchoNous.
▲	Après avoir inséré la sonde Kosmos dans la protection, inspecter la protection pour s'assurer de l'absence de trous ou de déchirures.

Gels de contact pour échographie

	Certains gels pour échographie peuvent entraîner une réaction allergique chez certaines personnes.
	Pour éviter toute contamination croisée, utiliser des packs de gel à usage unique.

EchoNous recommande les produits suivants :

- Gel pour échographie Aquasonic 100, Parker
- Gel pour échographie Aquasonic Clear, Parker
- Gel pour échographie SCAN, Parker

Stockage des sondes Kosmos

	Pour éviter toute contamination croisée ou toute exposition du personnel non protégé à une matière biologique, les conteneurs utilisés pour transporter des sondes Kosmos contaminées doivent être dotés d'une étiquette ISO indiquant un danger biologique.
---	--

Stockage quotidien

Le système Kosmos est conçu pour être utilisé et stocké dans des conditions ambiantes normales au sein d'un établissement médical. Par ailleurs, l'emballage fourni avec le dispositif peut être utilisé pour le stockage à long terme.

Stockage pour le transport

Le système Kosmos est conçu pour être transporté facilement à la main. Les utilisateurs peuvent se servir de l'emballage fourni avec le dispositif pour le transport. Consulter le représentant des ventes EchoNous pour plus d'informations sur les sacs et autres accessoires approuvés.

Vérification des éléments de la sonde

À chaque fois qu'une sonde Kosmos est branchée, un test s'exécute automatiquement pour vérifier l'intégrité des éléments de la sonde. Ce test indique à l'utilisateur si tous les éléments de la sonde fonctionnent correctement (test réussi) ou si des pannes ont été détectées.

Ce même test est automatiquement lancé lorsque l'application Kosmos App démarre avec une sonde Kosmos connectée.

-- Fin de la section --

PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE

Sécurité électrique

Références

CEI 60601-2-37 : 2015 Appareils électromédicaux – Partie 2-37 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de diagnostic et de surveillance médicaux à ultrasons

ANSI AAMI ES 60601-1 : 2012 Appareils électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – CEI 60601-1:2012, édition 3.1

CEI 60601-1-2:2014 : AMDI : 2020 Appareils électromédicaux — Parties 1-2 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles — Norme collatérale : Perturbations électromagnétiques — Exigences et essais

CEI 62304:2015 Logiciels de dispositifs médicaux — Processus du cycle de vie du logiciel

ISO 14971:2019 Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux

10993-1:2018 Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 1 : Évaluation et essais au sein d'un processus de gestion du risque

Lang, Roberto M., et al. *Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology*. *Journal of the American Society of Echocardiography* 18.12 (2005): 1440-1463.

Lang, Roberto M., et al. *Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging*. *European Heart Journal-Cardiovascular Imaging* 16.3 (2015): 233-271.

Ronneberger, Olaf, Philipp Fischer, and Thomas Brox. *U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation*. *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention*. Springer, Cham, 2015.

Symboles d'étiquetage

Symbole	Description EchoNous	Titre de l'OEN Numéro de référence Norme
	Indique le fabricant du dispositif, inclut le nom et l'adresse du fabricant	Fabricant Réf. 5.1.1 ISO 15223-1 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 : Exigences générales
	Testé conforme aux normes de la FCC	Aucun
	Les sondes sont testées par rapport à la protection de type BF	PIÈCE APPLIQUÉE DE TYPE BF Réf. D1.20 CEI 60601-1 Appareils électromédicaux – Partie 1 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles

	Appareil de classe II	Appareil de classe II Réf. D.1-9 CEI 60601-1 Appareils électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
	Les mises en garde relatives à la sécurité sont identifiées par ce symbole sur le dispositif.	Mise en garde Réf. D1.10 CEI 60601-1 Appareils électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
	Consulter le mode d'emploi	Instructions d'utilisation Réf. D.1-11 CEI 60601-1 Appareils électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
	Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères ou dans une décharge ; se reporter aux réglementations locales pour la mise au rebut	Collecte sélective Annexe IX Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Directive 2012/19/UE du Parlement européen

IPX7	Le Kosmos Torso-One et le Kosmos Lexsa sont protégés contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau.	Code IP représentant le degré de protection CEI 60529 Niveau de protection fourni par les boîtiers (code IP)
IP2X	Le Kosmos Power Pack est protégé contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre supérieur ou égal à 12,5 mm, et contre l'accès à des parties dangereuses avec un doigt.	Code IP représentant le degré de protection CEI 60529 Niveau de protection fourni par les boîtiers (code IP)
REF	Numéro de référence ou de modèle	Référence catalogue Réf. 5.1.6 ISO 15223-1 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 : Exigences générales
SN	Numéro de série	Numéro de série Réf. 5.1.7 ISO 15223-1 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 : Exigences générales

	Date de fabrication	Date de fabrication Réf. 5.1.3 ISO 15223-1 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 : Exigences générales
	Plage de température acceptable ; XX correspond à l'espace réservé générique des températures spécifiées	Limite de température Réf. 5.3.7 ISO 15223-1 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 : Exigences générales
	Plage d'humidité acceptable ; XX correspond à l'espace réservé générique des pourcentages spécifiés	Limite d'humidité Réf. 5.3.8 ISO 15223-1 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 : Exigences générales

	Pression atmosphérique acceptable ; XX correspond à l'espace réservé générique de la pression spécifiée en kPa	Limite de pression atmosphérique Réf. 5.3.9 ISO 15223-1 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 : Exigences générales
	Indique l'orientation correcte vers le haut de la boîte	Haut Réf. 13 ISO 780 Emballages – Emballages de distribution – Symboles graphiques pour la manutention et le stockage des emballages
	Indique un courant continu	Courant continu Réf. D.1-4 CEI 60601-1 Appareils électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles

	Indique un courant alternatif	Courant alternatif Réf. D.1-1 CEI 60601-1 Appareils électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
LOT	Code de lot	Code de lot Réf. 5.1.5 ISO 15223-1 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1 : Exigences générales
	Certifié UL Médical – Équipement médical général conforme aux normes ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) / CAN/CSA-C22.2 N° 6060-1 (2008) + (2014), concernant les risques de choc électrique, d'incendie et mécaniques uniquement. E509516	Aucun
Rx Only	Mise en garde : selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.	Référence : réglementation 21 CFR 801.109 de la FDA aux États-Unis

	Indication du fabricant que le dispositif est conforme aux exigences applicables du RDM UE 2017/745 pour le marquage CE et le numéro de référence de l'organisme notifié.	Marquage CE conforme à l'article 20, Annexe V RDM UE 2017/745
	Dispositif médical	Symbole de dispositif médical conforme à la directive du RDM UE
	UK Conformity Assessed	Symbole du marquage de conformité aux normes britanniques. MHRA Department of Business, Energy & Industrial Strategy 31 décembre 2020
	Représentant pour la Suisse	Symbole du représentant pour la Suisse MU600_00_016e_MB

Coordonnées

États-Unis



EchoNous Inc.
8310 154th Avenue NE
Building B, Suite 200
Redmond, WA 98052
Support technique (appel gratuit) : (844) 854 0800
Service commercial (appel gratuit) : (844) 854 0800
E-mail : support@EchoNous.com
Site Web : echonous.com

Espace économique européen



Représentant agréé :
Advena Ltd
Tower Business Centre
2nd Flr, Tower Street
Swatar, BKR 4013
Malte



Représentant agréé pour la Suisse

CH REP

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Suisse

Personne responsable au Royaume-Uni

Qserve Group UK, Ltd
49 Greek St, London W1D 4EG,
Royaume-Uni

Promoteur australien

LC & Partners Pty Ltd
Level 32, 101 Miller Street
North Sydney, NSW, 2060
Australie
Tél. : +61 2 9959 2400

Représentant agréé pour le Brésil

Detentor da Notificação:

VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda
Rua Batataes no 391, conjuntos 11, 12 e 13 - Jardim Paulista
São Paulo - SP - 01423-010

CNPJ: 04.718.143/0001-94

SAC: 0800-7703661

Farm. Resp: Cristiane Ap. de Oliveira Aguirre – CRF/SP: 21.079

Notificação ANVISA no: 80102519147

Suporte ao cliente da EchoNous

Entre em contato com o suporte ao cliente:

Telefone: 844-854-0800

Fax: 425-242-5553

E-mail: info@echonous.com

Site: www.echonous.com

Fabricante:

EchoNous, Inc.
8310 154th Ave NE, Edifício B, Suite 200
Redmond, WA 98052
Estados Unidos da América

Pais de Origem: Estados Unidos da América

ANATEL: 00430-22-14521

Sécurité biologique

Programme de formation ALARA

Le principe directeur de l'échographie diagnostique est défini par le postulat du « niveau le plus faible possible » (As Low As Reasonably Achievable, ALARA). La détermination du niveau raisonnable repose sur le jugement et l'appréciation du personnel qualifié (les utilisateurs). Aucun ensemble de règles ne permettra jamais de prescrire de façon suffisamment complète le niveau correct pour chaque cas. En maintenant l'exposition aux ultrasons au niveau le plus faible possible lors de l'acquisition d'images diagnostiques, les utilisateurs peuvent minimiser les effets biologiques des ultrasons.

Le seuil des effets biologiques dans l'échographie diagnostique étant indéterminé, il incombe aux utilisateurs de définir le niveau d'énergie totale à transmettre au patient. Ils doivent concilier temps d'exposition et qualité des images diagnostiques. Pour garantir des images diagnostiques de qualité tout en limitant le temps d'exposition, le système Kosmos fournit des réglages qui peuvent être ajustés durant un examen afin d'optimiser les résultats de l'examen.

Il est important que l'utilisateur puisse se conformer au principe ALARA. Mais suite aux progrès réalisés dans le domaine de l'échographie diagnostique, tant technologiques qu'en termes d'applications, les utilisateurs ont besoin d'informations plus nombreuses et plus claires pour s'y retrouver. L'affichage des indices vise à fournir ces informations importantes.

Un certain nombre de paramètres affectent la façon dont les indices affichés peuvent être utilisés pour mettre en œuvre le principe ALARA, notamment les valeurs des indices, la taille du sujet, l'emplacement de l'os par rapport au point de focalisation, l'atténuation dans le corps et le temps d'exposition aux ultrasons. Le temps d'exposition est un paramètre particulièrement utile, puisqu'il est réglé par l'utilisateur. La possibilité de limiter les valeurs des indices dans le temps est conforme au principe ALARA.

Un programme de formation ALARA générique est fourni avec le système Kosmos (voir le document ISBN 1-932962-30-1 ci-joint, Medical Ultrasound Safety [Sécurité de l'échographie médicale]).

Application du principe ALARA

Le mode d'imagerie du système Kosmos dépend du type d'information requis. L'imagerie en mode B fournit des informations anatomiques, tandis que l'imagerie en mode Couleur apporte des informations sur le flux sanguin.

Une bonne compréhension du mode d'imagerie utilisé permet aux utilisateurs d'appliquer le principe ALARA de façon éclairée. De plus, la fréquence de la sonde Kosmos, les valeurs de configuration, les techniques de balayage et l'expérience des utilisateurs leur permettent de satisfaire à la définition du principe ALARA.

Le choix de la valeur de la puissance acoustique appartient en définitive à l'utilisateur. Cette décision doit reposer sur les facteurs suivants : type du patient, type de l'examen, antécédents du patient, degré de difficulté à obtenir des informations diagnostiques utiles et potentiel réchauffement localisé du patient dû aux températures de surface de la sonde. L'utilisation prudente du système Kosmos consiste à limiter l'exposition du patient à la valeur d'indice la plus faible pendant la durée minimale nécessaire à l'obtention de résultats diagnostiques acceptables.

Bien que l'affichage d'un indice élevé n'indique pas forcément l'occurrence d'un effet biologique, un tel affichage doit être pris au sérieux. Tout mettre en œuvre pour réduire les effets possibles d'une valeur d'indice élevée. Dans ce but, limiter la durée d'exposition.

Plusieurs réglages du système sont à la disposition de l'utilisateur pour ajuster la qualité d'image et limiter l'intensité acoustique. Ces réglages sont associés aux techniques que l'utilisateur peut utiliser pour mettre en œuvre le principe ALARA.

Affichage de la puissance d'émission et exactitude de l'affichage

AFFICHAGE DE LA PUISSANCE D'ÉMISSION

Le système Kosmos affiche les deux indices d'effets biologiques prescrits par la norme CEI 60601-2-37. Appareils électromédicaux — Partie 2-37 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de diagnostic et de surveillance médicaux à ultrasons.

L'indice thermique (IT) fournit une mesure de l'augmentation de la température prévue.

INDICE THERMIQUE

L'IT est une estimation de l'augmentation de la température des tissus mous ou des os. Il existe trois catégories d'IT : IT_m, IT_o et IT_c. Toutefois, étant donné que Kosmos n'est pas destiné aux applications transcrâniennes, l'IT pour l'os crânien de surface (IT_c) ne peut pas être affiché sur le système. Les catégories d'IT suivantes sont disponibles pour l'affichage :

- IT_m : indice thermique des tissus mous. Principale catégorie d'IT. Utilisé pour les applications qui n'affichent pas d'image des os.
- IT_o : indice thermique des os (os situé dans une région focale).

INDICE MÉCANIQUE

L'indice mécanique (IM) fournit une évaluation des lésions tissulaires probables liées à la cavitation. La valeur maximale absolue de l'IM est de 1,9 telle que définie dans le document Guidance for Industry and FDA Staff – Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers (Guide de la FDA pour l'industrie et le personnel – Mise sur le marché d'échographes diagnostiques et de sondes) (2019).

ISPTA

La valeur Ispta indique l'intensité du pic spatial moyennée dans le temps. La valeur maximale absolue de Ispta est de 720 mW/cm², tel que défini dans le Guidance for Industry and FDA Staff – Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers (Guide de la FDA pour l'industrie et le personnel – Mise sur le marché d'échographes diagnostiques et de sondes) (2019).

EXACTITUDE DE L'AFFICHAGE DE LA PUISSANCE D'ÉMISSION

L'exactitude de l'affichage de la puissance d'émission des indices d'effets biologiques (IM et IT) dépend de l'incertitude et de la précision du système de mesure, des hypothèses techniques inhérentes au modèle acoustique utilisé pour calculer les paramètres, et de la variation de la puissance d'émission des systèmes. EchoNous compare également les mesures acoustiques aussi bien internes que de tiers et confirme que les deux mesures sont conformes à la quantification recommandée de 0,2 des valeurs affichées, stipulée dans les normes.

Aucune des valeurs IM et IT affichées sur le système Kosmos ne dépassera les valeurs globales maximales (répertoriées dans les tableaux de puissance acoustique de niveau 3) de plus de 0,2.

L'exactitude des indices IM et IT est comme suit :

- IM : précis à ±25 % ou +0,2, selon la valeur la plus élevée.
- IT : précis à ±30 % ou +0,2, selon la valeur la plus élevée.

Consulter les tableaux de puissances acoustiques, [TABLEAU 7-1](#), à [TABLEAU 7-14](#).

Tableaux de puissances acoustiques Kosmos Torso-One

Voir page suivante

TABLEAU 7-1. Sonde : Kosmos Torso-One, Mode de fonctionnement : Mode B, tableau de puissance acoustique combiné : mode 1 rapportable (mode B) cardiaque, type de corps 2, 16 cm

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo	
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface
Valeur maximale de l'indice	1,11	0,56		0,56	
Valeur composante de l'indice		1 : 0,30 2 : 0,26	1 : 0,30 2 : 0,26	1 : 0,30 2 : 0,26	1 : 0,30 2 : 0,26
Paramètres acoustiques					
$P_{r,\alpha}$ à z_{IM} (MPa)	1 : 1,58				
P (mW)			1 : 41,03 2 : 37,03		1 : 41,03 2 : 37,03
P_{Tx} (mW)			1 : 30,42 2 : 27,46		1 : 30,42 2 : 27,46
z_s (cm)			1 : 4,27 2 : 4,23		
z_b (cm)					1 : 3,93 2 : 3,87
z_{IM} (cm)	1 : 4,20				
$z_{pH,\alpha}$ (cm)	1 : 4,20				
f_{awf} (MHz)	1 : 2,03		1 : 2,03 2 : 2,03		1 : 2,03 2 : 2,03
Autres informations					
p_{rr} (Hz)	1 : 1589,5				
s_{rr} (Hz)	1 : 28,4				
n_{pps}	1 : 1				
$I_{pa,\alpha}$ à $z_{pH,\alpha}$ (W/cm ²)	1 : 91,28				
$I_{spta,\alpha}$ à $z_{pH,\alpha}$ ou $z_{sH,\alpha}$ (mW/cm ²)	25,13				
I_{spta} à z_{pH} ou z_{sH} (mW/cm ²)	42,50				
P_r à z_{pH} (MPa)	1 : 2,13				
Mode de commandes de fonctionnement					
Examen	Cardiaque				
Paramètres d'IMC	2				
Profondeur	16 cm				

REMARQUE 1 : Un seul mode de fonctionnement par indice.
REMARQUE 2 : Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à ITm et à ITo.
REMARQUE 3 : Les informations ne doivent pas être fournies par rapport à ITc pour un ENSEMBLE DE TRANSDUCTEUR non destiné à une utilisation céphalique néonatale ou transcrâniale.
REMARQUE 4 : Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à ITm, à ITo ou à ITc.
REMARQUE 5 : Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à IM.
REMARQUE 6 : Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
REMARQUE 7 : Les profondeurs z_{pH} et z_{sH} s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs z_{pH} et z_{sH} s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

TABLEAU 7-2. Sonde : Kosmos Torso-One, Mode de fonctionnement : mode M, Tableau de puissance acoustique : mode 3 rapportable Mode M (cardiaque, type de corps : moyen, profondeur de 12 cm)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo	
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface
Valeur maximale de l'indice	0,43	5,32E-02		0,11	
Valeur composante de l'indice		5,32E-02	2,15E-02	5,32E-02	0,11
$P_{r,\alpha}$ à Z_{Mf} (MPa)	0,70				
P (mW)			4,55		4,55
P_{1x1} (mW)			4,11		4,11
z_x (cm)			5,37		
z_b (cm)					4,80
Z_{Mf} (cm)	5,37				
$Z_{pII,\alpha}$ (cm)	5,37				
f_{ouv} (MHz)	2,72	2,72			2,68
prf (Hz)	800				
srr (Hz)	S. O.				
n_{pps}	1				
$I_{pa,\alpha}$ à $Z_{pII,\alpha}$ (W/cm^2)	52,08				
$I_{spta,\alpha}$ à $Z_{pII,\alpha}$ ou $z_{sil,\alpha}$ (mW/cm^2)	16,71				
I_{spta} à Z_{pII} ou z_{sil} (mW/cm^2)	31,29				
p_r à Z_{pII} (MPa)	45,72				
Mode des commandes de fonctionnement					

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
 REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à ITm et à ITo.
 REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à ITm et à ITo.
 REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à l'IM.
 REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
 REMARQUE 6 Les profondeurs Z_{pII} et $Z_{pII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs Z_{sil} et $z_{sil,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

TABLEAU 7-3. Sonde : Kosmos Torso-One, Mode de fonctionnement : mode M, Tableau de puissance acoustique : mode 4 rapportable Mode M (cardiaque, type de corps : moyen, profondeur de 14 cm)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo	
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface
Valeur maximale de l'indice	0,39	5,33E-02		9,70E-02	
Valeur composante de l'indice		5,33E-02	2,12E-02	5,33E-02	9,70E-02
$P_{r,\alpha}$ à Z_{Mf} (MPa)	0,63				
P (mW)			4,60		4,60
P_{1x1} (mW)			4,14		4,14
z_x (cm)			5,50		
z_b (cm)					4,97
Z_{Mf} (cm)	5,50				
$Z_{pII,\alpha}$ (cm)	5,50				
f_{ouv} (MHz)	2,70	2,70			2,67
prf (Hz)	800				
srr (Hz)	S. O.				
n_{pps}	1				
$I_{pa,\alpha}$ à $Z_{pII,\alpha}$ (W/cm^2)	41,86				
$I_{spta,\alpha}$ à $Z_{pII,\alpha}$ ou $z_{sil,\alpha}$ (mW/cm^2)	13,64				
I_{spta} à Z_{pII} ou z_{sil} (mW/cm^2)	38,22				
p_r à Z_{pII} (MPa)	1,06				
Mode des commandes de fonctionnement					

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
 REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à ITm et à ITo.
 REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à ITm et à ITo.
 REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à l'IM.
 REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
 REMARQUE 6 Les profondeurs Z_{pII} et $Z_{pII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs Z_{sil} et $z_{sil,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

TABLEAU 7-4. Sonde : Kosmos Torso-One, Mode de fonctionnement : Mode BC (Max IM, profondeur de 12 cm, petite ROI, partie supérieure de l'image)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo		ITc
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface	
Valeur maximale de l'indice	1,56	0,37		0,37		0,64
Valeur composante de l'indice		1 : 6,47E-02 2 : 0,30				
Paramètres acoustiques	$p_{r,\alpha}$ à z_{IM} (MPa)	2 : 2,50				
	P (mW)		1 : 5,89 2 : 27,52	1 : 5,89 2 : 27,52	1 : 5,89 2 : 27,52	1 : 5,89 2 : 27,52
	P_{IXJ} (mW)		1 : 5,02 2 : 24,07	1 : 5,02 2 : 24,07	1 : 5,02 2 : 24,07	1 : 5,02 2 : 24,07
	z_s (cm)			1 : S. O. 2 : S. O.		
	z_b (cm)				1 : S. O. 2 : S. O.	
	z_{IM} (cm)	2 : 1,91				
	$z_{pII,\alpha}$ (cm)	2 : 2,00				
	f_{dov} (MHz)	2 : 2,65	1 : 2,71 2 : 2,65	1 : 2,71 2 : 2,65	1 : 2,71 2 : 2,65	1 : 2,71 2 : 2,65
Autres informations	prf (Hz)	2 : 1248,9				
	srf (Hz)	2 : 31,2				
	n_{pps}	2 : 10				
	$I_{pa,\alpha}$ à $z_{pII,\alpha}$ (W/cm^2)	2 : 282				
	$I_{spta,\alpha}$ à $z_{pII,\alpha}$ ou $z_{sII,\alpha}$ (mW/cm^2)	160,04				
	I_{spta} à z_{pII} ou z_{sII} (mW/cm^2)	233,06				
	p_r à z_{pII} (MPa)	2 : 2,85				
Mode des commandes de fonctionnement	Composant 1 : UTP 4					
	Composant 2 : UTP 275					
REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.						
REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.						
REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.						
REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à l'IM.						
REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.						
REMARQUE 6 Les profondeurs z_{pII} et $z_{sII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs z_{sII} et $z_{sII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.						

TABLEAU 7-5. Sonde : Kosmos Torso-One, Mode de fonctionnement : Mode BC (Max ITm/iTo, ISPTA, profondeur de 12 cm, grande ROI, partie supérieure de l'image)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo		ITc
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface	
Valeur maximale de l'indice	0,98	0,96		0,96		1,74
Valeur composante de l'indice		1 : 5,66E-02 2 : 0,90				
Paramètres acoustiques	$p_{r,\alpha}$ à z_{IM} (MPa)	2 : 1,58				
	P (mW)		1 : 5,15 2 : 86,25	1 : 5,15 2 : 86,25	1 : 5,15 2 : 86,25	1 : 5,15 2 : 86,25
	P_{IXJ} (mW)		1 : 4,39 2 : 72,84	1 : 4,39 2 : 72,84	1 : 4,39 2 : 72,84	1 : 4,39 2 : 72,84
	z_s (cm)			1 : S. O. 2 : S. O.		
	z_b (cm)				1 : S. O. 2 : S. O.	
	z_{IM} (cm)	2 : 4,24				
	$z_{pII,\alpha}$ (cm)	2 : 4,24				
	f_{dov} (MHz)	2 : 2,59	1 : 2,71 2 : 2,59	1 : 2,71 2 : 2,59	1 : 2,71 2 : 2,59	1 : 2,71 2 : 2,59
Autres informations	prf (Hz)	2 : 3824,6				
	srf (Hz)	2 : 25,5				
	n_{pps}	2 : 10				
	$I_{pa,\alpha}$ à $z_{pII,\alpha}$ (W/cm^2)	2 : 153				
	$I_{spta,\alpha}$ à $z_{pII,\alpha}$ ou $z_{sII,\alpha}$ (mW/cm^2)	69,29				
Mode des commandes de fonctionnement	I_{spta} à z_{pII} ou z_{sII} (mW/cm^2)	151,32				
	p_r à z_{pII} (MPa)	2 : 2,23				
	Composant 1 : UTP 4					
Composant 2 : UTP 277						
REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.						
REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.						
REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.						
REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à l'IM.						
REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.						
REMARQUE 6 Les profondeurs z_{pII} et $z_{sII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs z_{sII} et $z_{sII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.						

TABLEAU 7-6. Sonde : Kosmos Torso-One, Tableau de puissance acoustique, Mode de fonctionnement : Doppler PW (IM, ITm, ITo max.)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo	
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface
Valeur maximale de l'indice	0,42	3,04		3,04	
Valeur composante de l'indice		0,49	3,04	3,04	3,04
Paramètres acoustiques					
$P_{r,\alpha}$ à Z_{Mf} (MPa)	0,59				
P (mW)		50,93		50,93	
P_{1x1} (mW)		37,76		37,76	
Z_s (cm)		1,93			
Z_b (cm)					1,87
Z_M (cm)	1,93				
$Z_{pil,\alpha}$ (cm)	1,93				
f_{surf} (MHz)	2,03	2,03		2,03	
Autres informations					
p_{rr} (Hz)	14 468				
s_{rr} (Hz)	S. O.				
n_{pps}	1				
$I_{pa,\alpha}$ à $Z_{pil,\alpha}$ (W/cm ²)	12,14				
$I_{spta,\alpha}$ à $Z_{pil,\alpha}$ ou $Z_{sil,\alpha}$ (mW/cm ²)	429,69				
I_{spta} à Z_{pil} ou Z_{sil} (mW/cm ²)	553,54				
p_f à Z_{pil} (MPa)	0,68				
Mode des commandes de fonctionnement					
PRF	14 468 Hz				
Taille de la porte	4 mm				
Profondeur focale	20 mm				

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
 REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à ITm et à ITo.
 REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à ITm et à ITo.
 REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à ITm.
 REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
 REMARQUE 6 Les profondeurs Z_{pil} et $Z_{sil,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs Z_{sil} et $Z_{sil,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

TABLEAU 7-7. Sonde : Kosmos Torso-One, Tableau de puissance acoustique, Mode de fonctionnement : Doppler CW (IM, ITm, ITo max.)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo	
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface
Valeur maximale de l'indice	0,07	0,49		0,49	
Valeur composante de l'indice		0,47	0,49	0,47	2,43
Paramètres acoustiques					
$P_{r,\alpha}$ à Z_{Mf} (MPa)	0,0976				
P (mW)		62,48		62,48	
P_{1x1} (mW)		50,17		50,17	
Z_s (cm)		1,27			
Z_b (cm)					1,27
Z_M (cm)	0,9				
$Z_{pil,\alpha}$ (cm)	1,27				
f_{surf} (MHz)	1,95	1,95		1,95	
Autres informations					
p_{rr} (Hz)	S. O.				
s_{rr} (Hz)	S. O.				
n_{pps}	1				
$I_{pa,\alpha}$ à $Z_{pil,\alpha}$ (W/cm ²)	S. O.				
$I_{spta,\alpha}$ à $Z_{pil,\alpha}$ ou $Z_{sil,\alpha}$ (mW/cm ²)	279,77				
I_{spta} à Z_{pil} ou Z_{sil} (mW/cm ²)	331,51				
p_f à Z_{pil} (MPa)	0,10				
Mode des commandes de fonctionnement					
Profondeur focale	4 cm				
Mode CW					

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
 REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à ITm et à ITo.
 REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à ITm et à ITo.
 REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à ITm.
 REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
 REMARQUE 6 Les profondeurs Z_{pil} et $Z_{pil,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs Z_{sil} et $Z_{sil,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

Récapitulatif de puissance acoustique maximale du Kosmos Lexsa

TABLEAU 7-8. Sonde : Tableau de puissance acoustique, mode de fonctionnement du Kosmos Lexsa : Mode B (IM, ISPTA, AL max., profondeur de 3 cm)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo		ITc
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface	
Valeur maximale de l'indice	0,77	5,39E-03		5,39E-03		1,25E-02
Valeur composante de l'indice		5,39E-03	5,39E-03	5,39E-03	5,39E-03	
Paramètres acoustiques						
$p_{r,\alpha}$ à z_{IM} (MPa)	2,01					
P (mW)		0,52		0,52		0,52
P_{1x1} (mW)		0,15		0,15		
z_s (cm)			1,57			
z_b (cm)					1,57	
z_{IM} (cm)	1,43					
$z_{pili,\alpha}$ (cm)	1,57					
f_{avf} (MHz)	6,77	7,44		7,44		7,44
Autres informations						
p_{rr} (Hz)	1820,0					
s_{rr} (Hz)	28,0					
n_{pps}	1					
$I_{pa,\alpha}$ à $z_{pili,\alpha}$ (W/cm^2)	1,7E+02					
$I_{spta,\alpha}$ à $z_{pili,\alpha}$ ou $z_{sil,\alpha}$ (mW/cm^2)	1,62					
I_{spta} à z_{pji} ou z_{sji} (mW/cm^2)	3,58					
p_r à z_{pji} (MPa)	2,24					
Mode des commandes de fonctionnement						
UTP 71						

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
 REMARQUE 2 Saisir les données « A la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.
 REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.
 REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à l'IM.
 REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
 REMARQUE 6 Les profondeurs z_{pji} et $z_{pili,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs z_{sji} et $z_{sil,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

TABLEAU 7-9. Sonde : Tableau de puissance acoustique, mode de fonctionnement du Kosmos Lexsa : Mode B (ITm max., ITo max., AL max., profondeur de 10 cm)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo		ITc
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface	
Valeur maximale de l'indice	0,19	9,16E-03		9,16E-03		2,05E-02
Valeur composante de l'indice		9,16E-03	9,16E-03	9,16E-03	9,16E-03	
Paramètres acoustiques						
$p_{r,\alpha}$ à z_{IM} (MPa)	0,53					
P (mW)		0,85		0,85		0,85
P_{1x1} (mW)		0,25		0,25		
z_s (cm)			1,63			
z_b (cm)					1,63	
z_{IM} (cm)	1,63					
$z_{pili,\alpha}$ (cm)	1,63					
f_{avf} (MHz)	7,69	7,69		7,69		7,69
Autres informations						
p_{rr} (Hz)	1300,0					
s_{rr} (Hz)	20,0					
n_{pps}	1					
$I_{pa,\alpha}$ à $z_{pili,\alpha}$ (W/cm^2)	17,0					
$I_{spta,\alpha}$ à $z_{pili,\alpha}$ ou $z_{sil,\alpha}$ (mW/cm^2)	1,36					
I_{spta} à z_{pji} ou z_{sji} (mW/cm^2)	3,23					
p_r à z_{pji} (MPa)	0,82					
Mode des commandes de fonctionnement						
UTP 87						

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
 REMARQUE 2 Saisir les données « A la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.
 REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.
 REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à l'IM.
 REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
 REMARQUE 6 Les profondeurs z_{pji} et $z_{pili,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs z_{sji} et $z_{sil,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

TABLEAU 7-10. Sonde : Tableau de puissance acoustique, mode de fonctionnement du Kosmos Lexsa : BC, Mode CPD (Max IM, Vasculaire, profondeur de 4 cm, grande ROI)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo		ITc
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface	
Valeur maximale de l'indice	1,37	7,72E-02		7,72E-02		0,29
Valeur composante de l'indice		1 : 2,35E-03 2 : 7,48E-02				
Paramètres acoustiques	$p_{r,\alpha}$ à z_{IM} (MPa)	2 : 2,88				
	P (mW)		1 : 0,26 2 : 11,93		1 : 0,26 2 : 11,93	1 : 0,26 2 : 11,93
	P_{1x1} (mW)		1:6,90E-02 2 : 3,56		1:6,90E-02 2 : 3,56	
	z_s (cm)			1 : S. O. 2 : S. O.		
	z_b (cm)				1 : S. O. 2 : S. O.	
	z_{IM} (cm)	2 : 0,96				
	$z_{pII,\alpha}$ (cm)	2 : 1,57				
	f_{cut} (MHz)	2 : 4,42	1 : 7,15 2 : 4,42		1 : 7,15 2 : 4,42	1 : 7,15 2 : 4,42
	prr (Hz)	2 : 8236,4				
	srr (Hz)	2 : 21,4				
Autres informations	n_{pps}	2 : 12				
	$I_{p0,\alpha}$ à $z_{pII,\alpha}$ (W/cm ²)	2 : 23,3				
	$I_{spta,\alpha}$ à $z_{pII,\alpha}$ ou $z_{sII,\alpha}$ (mW/cm ²)	29,58				
	I_{spta} à z_{pII} ou z_{sII} (mW/cm ²)	48,42				
	p_r à z_{pII} (MPa)	2 : 0,95				
Modes commandés de fonctionnement	Composant 1 : UTP 225					
	Composant 2 : UTP 339 (16V)					

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.
REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.
REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à l'IM.
REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
REMARQUE 6 Les profondeurs z_{pII} et $z_{pII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs z_{II} et $z_{sII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

TABLEAU 7-11. Sonde : Tableau de puissance acoustique, mode de fonctionnement du Kosmos Lexsa : BC, Mode CPD (Max ISPTA, vasculaire, profondeur de 4 cm, petite ROI, partie supérieure de l'image)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo		ITc
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface	
Valeur maximale de l'indice	1,37	6,50E-02		6,50E-02		7,98E-02
Valeur composante de l'indice		1 : 3,23E-03 2 : 6,18E-02				
Paramètres acoustiques	$p_{r,\alpha}$ à z_{IM} (MPa)	2 : 2,88				
	P (mW)		1 : 0,36 2 : 2,94		1 : 0,36 2 : 2,94	1 : 0,36 2 : 2,94
	P_{1x1} (mW)		1 : 9,49E-02 2 : 2,94		1 : 9,49E-02 2 : 2,94	
	z_s (cm)			1 : S. O. 2 : S. O.		
	z_b (cm)				1 : S. O. 2 : S. O.	
	z_{IM} (cm)	2 : 0,96				
	$z_{pII,\alpha}$ (cm)	2 : 1,57				
	f_{cut} (MHz)	2 : 4,42	1 : 7,15 2 : 4,42		1 : 7,15 2 : 4,42	1 : 7,15 2 : 4,42
	prr (Hz)	2 : 2026,6				
	srr (Hz)	2 : 28,1				
Autres informations	n_{pps}	2 : 12				
	$I_{p0,\alpha}$ à $z_{pII,\alpha}$ (W/cm ²)	2 : 23,3				
	$I_{spta,\alpha}$ à $z_{pII,\alpha}$ ou $z_{sII,\alpha}$ (mW/cm ²)	48,65				
	I_{spta} à z_{pII} ou z_{sII} (mW/cm ²)	79,44				
	p_r à z_{pII} (MPa)	2 : 0,95				
Modes commandés de fonctionnement	Composant 1 : UTP 225					
	Composant 2 : UTP 339 (16V)					

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.
REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à l'ITm et à l'ITo.
REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à l'IM.
REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
REMARQUE 6 Les profondeurs z_{pII} et $z_{pII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs z_{II} et $z_{sII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

TABEAU 7-12. Sonde : Tableau de puissance acoustique, mode de fonctionnement du Kosmos Lexsa : BC, Mode CPD, (ITm, ITo max.)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo		ITc
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface	
Valeur maximale de l'indice	0,94	0,10		0,10		0,29
Valeur composante de l'indice		1 : 1,91E-03 2 : 0,10				
Paramètres acoustiques	$p_{r,\alpha}$ à z_{IM} (MPa)	2 : 2,34				
	P (mW)		1 : 0,22 2 : 11,60		1 : 0,22 2 : 11,60	1 : 0,22 2 : 11,60
	P_{IXI} (mW)		1 : 5,62E-02 2 : 3,46		1 : 5,62E-02 2 : 3,46	
	z_s (cm)			1 : S. O. 2 : S. O.		
	z_b (cm)				1 : S. O. 2 : S. O.	
	z_{IM} (cm)	2 : 0,93				
	$z_{pili,\alpha}$ (cm)	2 : 1,40				
	f_{awf} (MHz)	2 : 6,22	1 : 7,15 2 : 6,22		1 : 7,15 2 : 6,22	1 : 7,15 2 : 6,22
	p_{rr} (Hz)	2 : 8830,3				
	s_{rr} (Hz)	2 : 17,8				
Autres informations	n_{pps}	2 : 16				
	$I_{pa,\alpha}$ à $z_{pili,\alpha}$ (W/cm^2)	2 : 73,7				
	$I_{spta,\alpha}$ à $z_{pili,\alpha}$ ou $z_{sili,\alpha}$ (mW/cm^2)	29,56				
	I_{spta} à z_{pili} ou z_{sili} (mW/cm^2)	54,39				
	p_r à z_{prij} (MPa)	2 : 1,51				
Mode des commandes de fonctionnement	Composant 1 : UTP 225					
	Composant 2 : UTP 161					

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à ITm et à ITo.
REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à ITm et à ITo.
REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à l'IM.
REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
REMARQUE 6 Les profondeurs z_{prij} et $z_{pili,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs z_{sij} et $z_{sili,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

TABEAU 7-13. Sonde : Tableau de puissance acoustique, mode de fonctionnement du Kosmos Lexsa : Doppler PW (IM max.)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo		ITc
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface	
Valeur maximale de l'indice	0,35	0,19		0,47		0,26
Valeur composante de l'indice		0,19	0,06	0,19	0,47	
Paramètres acoustiques	$p_{r,\alpha}$ à z_{IM} (MPa)	0,88				
	P (mW)		6,45		6,45	6,45
	P_{IXI} (mW)		6,45		6,45	
	z_s (cm)			2,6		
	z_b (cm)					2,6
	z_{IM} (cm)	1,22				
	$z_{pili,\alpha}$ (cm)	1,24				
	f_{awf} (MHz)	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
	p_{rr} (Hz)	15 625				
	s_{rr} (Hz)	S. O.				
Autres informations	n_{pps}	1				
	$I_{pa,\alpha}$ à $z_{pili,\alpha}$ (W/cm^2)	23,9				
	$I_{spta,\alpha}$ à $z_{pili,\alpha}$ ou $z_{sili,\alpha}$ (mW/cm^2)	338,3				
	I_{spta} à z_{pili} ou z_{sij} (mW/cm^2)	575,2				
	p_r à z_{prij} (MPa)	1,14				
Mode des commandes de fonctionnement	PRF	15 625				
	Taille de la porte	5 mm				
	Profondeur focale de la porte	10 mm				

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à ITm et à ITo.
REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à ITm et à ITo.
REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à l'IM.
REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
REMARQUE 6 Les profondeurs z_{prij} et $z_{pili,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs z_{sij} et $z_{sili,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

TABLEAU 7-14. Sonde : Tableau de puissance acoustique, mode de fonctionnement du Kosmos Lexsa : Doppler PW (Max ITm, ITo, ITc)

Libellé de l'indice	IM	ITm		ITo		ITc
		À la surface	Sous la surface	À la surface	Sous la surface	
Valeur maximale de l'indice	0,15	0,66		1,64		0,64
Valeur composante de l'indice		0,66	0,26	0,66	1,64	
Paramètres acoustiques						
$p_{r,\alpha}$ à z_{IM} (MPa)	0,38					
P (mW)		22,23		22,23		22,23
P_{1x1} (mW)		22,23		22,23		
z_s (cm)			2,6			
z_b (cm)					2,6	
z_{IM} (cm)	2,58					
$z_{pII,\alpha}$ (cm)	2,58					
f_{DWR} (MHz)	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
prf (Hz)	7621					
srr (Hz)	S.O.					
n_{pps}	1					
Autres informations						
$I_{pa,\alpha}$ à $z_{pII,\alpha}$ (W/cm^2)	5,42					
$I_{spta,\alpha}$ à $z_{pII,\alpha}$ ou $z_{sII,\alpha}$ (mW/cm^2)	127,8					
I_{spta} à z_{pII} ou z_{sII} (mW/cm^2)	539,19					
p_r à z_{pII} (MPa)	0,73					
Mode de commandes de fonctionnement						
PRF	7621					
Taille de la porte	5 mm					
Profondeur focale de la porte	50 mm					

REMARQUE 1 Un seul mode de fonctionnement par indice.
REMARQUE 2 Saisir les données « À la surface » et « Sous la surface » dans les deux colonnes relatives à ITm et à ITo.
REMARQUE 3 Si les exigences de la norme 201.12.4.2a) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans les colonnes relatives à ITm et à ITo.
REMARQUE 4 Si les exigences de la norme 201.12.4.2b) sont remplies, il n'est pas nécessaire de saisir de données dans la colonne relative à ITm.
REMARQUE 5 Les cellules gris clair doivent contenir une valeur numérique. Le réglage de l'appareil relatif à l'indice doit être saisi dans la section Commandes de fonctionnement.
REMARQUE 6 Les profondeurs z_{pII} et $z_{sII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES SANS BALAYAGE, alors que les profondeurs z_{pII} et $z_{sII,\alpha}$ s'appliquent aux MODES AVEC BALAYAGE.

Exactitude des mesures

L'exactitude des mesures de distance et de zone dans les images en mode B est comme suit :

- Exactitude des mesures axiales : les mesures de la distance axiale dans les modes d'imagerie 2D sont précises à $\pm 2\%$ de la valeur affichée (ou 1 mm, selon la valeur la plus élevée).
- Exactitude des mesures latérales : les mesures de la distance latérale dans les modes d'imagerie 2D sont précises à $\pm 2\%$ de la valeur affichée (ou 1 mm, selon la valeur la plus élevée).
- Exactitude des mesures diagonales : les mesures de la distance diagonale dans les modes d'imagerie 2D sont précises à $\pm 2\%$ de la valeur affichée (ou 1 mm, selon la valeur la plus élevée).
- Exactitude des mesures de zone : les mesures de la zone dans les modes d'imagerie 2D sont précises à $\pm 4\%$ de la valeur nominale.

L'exactitude des mesures de distance et de temps dans les images en mode M est comme suit :

- Exactitude des mesures de distance en mode M : les mesures de distance en mode M sont précises à $\pm 3\%$ de la valeur affichée.
- Exactitude des mesures de temps en mode M : les mesures de temps en mode M sont précises à $\pm 2\%$ de la valeur affichée.

Exactitude des mesures du processus FE assisté par l'IA du système Kosmos :

Le processus FE assisté par l'IA n'est pas encore approuvé par la FDA. Au lieu de cela, EchoNous suit les exigences de la **Politique d'application pour les systèmes d'imagerie pendant l'urgence sanitaire publique liée à la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19), guide de la Food and Drug Administration pour l'industrie et le personnel, avril 2020.**

- L'exactitude des calculs de la FE du système Kosmos dépend de la sélection correcte des images TD/TS et de la précision du tracé du contour endocardique du VG. Il est important d'analyser les images TD/TS et les contours du VG initialement fournis par les algorithmes d'IA du système Kosmos, de confirmer leur exactitude et de les modifier selon le besoin.

- S'assurer que les images TD/TS sélectionnées reflètent fidèlement les phases télédiastolique et télésystolique correspondantes du cœur dans les clips A4C et A2C. Utiliser l'outil d'édition pour sélectionner une image plus appropriée, si nécessaire.
- S'assurer que les contours du VG suivent de près l'endocarde du VG. Utiliser l'outil d'édition pour tracer et ajuster correctement les contours du VG.
- Si possible, acquérir à la fois des clips A4C et A2C pour obtenir une FE A4C/A2C biplan, qui est plus précise qu'une FE A4C sur un seul plan.
- Le tableau suivant présente les résultats de la comparaison des calculs de la FE du système Kosmos, non modifiés par l'utilisateur, à la moyenne de mesures expertes manuelles réalisées par deux laboratoires Echo Core Labs indépendants sur les mêmes clips A4C/A2C. Des sujets d'âges, orientations sexuelles, races, morphologies et états de santé divers ont été soumis au processus FE assisté par l'IA du système Kosmos dans le cadre d'une échographie clinique. Les FE des sujets examinés s'étendaient de 20 % à 80 %. Les résultats ci-dessous incluent à la fois des acquisitions A4C/A2C biplan et A4C sur un seul plan, la majorité étant biplan (une acquisition A4C sur un seul plan a été considérée comme suffisante lorsqu'il s'est avéré impossible d'obtenir une vue A2C adéquate dans un délai raisonnable).

TABLEAU 7-15. Valeurs comparatives de la FE

Valeurs de la FE	FE en pourcentage (iOS)	FE en pourcentage (Android)
ET ¹	6,70 (valeur p<0,0001)	6,69 (valeur p<0,0001)
Biais	-3,41	-3,41
LOA de 95 % ²	-14,67/7,91	-14,67/7,85

¹ L'écart-type (ET) est une mesure de la dispersion entre les calculs de la FE du système Kosmos (non modifiés par l'utilisateur) et la moyenne de mesures expertes manuelles.

² Les limites d'agrément (LOA) de 95 % doivent inclure environ 95 % des différences entre les calculs de la FE du système Kosmos (non modifiés par l'utilisateur) et la moyenne de mesures expertes manuelles.

Effets des commandes

Le système Kosmos ne permet pas à l'utilisateur de commander directement la puissance d'émission acoustique. Le système Kosmos a été conçu pour régler automatiquement la puissance acoustique afin de s'assurer que les limites acoustiques ne sont dépassées dans aucun mode d'imagerie. Comme il n'existe pas de commande directe de la puissance acoustique, l'utilisateur doit se fier au contrôle du temps d'exposition et à la technique de balayage pour mettre en œuvre le principe ALARA.

Références connexes

- U.S. Dept. of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Guidance for Industry and FDA Staff – Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers (2019)
- CEI 60601-2-37:2015 Appareils électromédicaux — Partie 2-37 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de diagnostic et de surveillance médicaux à ultrasons
- CEI 62359:2017 Ultrasons – Caractérisation du champ – Méthodes d'essai pour la détermination d'indices thermique et mécanique des champs d'ultrasons utilisés pour le diagnostic médical
- NEMA UD 2-2004 (R2009) Norme de mesure de la puissance acoustique pour le matériel d'échographie diagnostique — Révision 3

Augmentation de la température de surface de la sonde

Le TABLEAU 7-16, indique l'augmentation de température maximale prévue pour le système Kosmos. Ces valeurs sont obtenues à partir du test d'un échantillon statistique réalisé avec des systèmes équivalents et ont été mesurées conformément à la norme CEI 60601-2-37. Les valeurs indiquées dans le tableau sont déterminées avec un intervalle de confiance de 90 %, signifiant que 90 % des systèmes connaîtront une augmentation de température inférieure ou égale à la valeur indiquée dans le tableau.

TABLEAU 7-16. Augmentation de la température de surface

Test	Augmentation de la température (°C)
Air immobile	16,02
Simulation d'utilisation	9,85

Ergonomie

▲	<p>L'exécution répétée d'échographies peut entraîner une gêne occasionnelle dans les pouces, les doigts, les mains, les bras, les épaules, les yeux, le cou, le dos ou d'autres parties du corps. Néanmoins, en cas de gêne, de courbatures, de douleur pulsatile, d'endolorissement, de fourmillements, d'engourdissement, de raideur, de sensation de brûlure, de fatigue/faiblesse musculaire ou de perte d'amplitude de mouvement ressentis de manière constante ou récurrente, ne pas ignorer ces signes d'avertissement. Consulter rapidement un spécialiste. Ces symptômes peuvent être associés à des troubles musculosquelettiques liés au travail (TMSLT). Les TMSLT peuvent être douloureux et entraîner des blessures potentiellement invalidantes aux nerfs, aux muscles, aux tendons ou à d'autres parties du corps. Exemples de TMSLT : bursite, tendinite, ténosynovite, syndrome du canal carpien et syndrome de De Quervain.</p> <p>Bien que les chercheurs n'aient pas de réponses définitives à de nombreuses questions concernant les troubles musculo-squelettiques liés au travail, tous s'accordent à dire que certains facteurs sont associés à leur apparition, notamment des problèmes physiques et médicaux préexistants, l'état de santé général, la position du corps et les équipements dans le cadre du travail, la cadence et la durée du travail.</p>
---	---

Le système Kosmos permet à des professionnels de la santé qualifiés d'obtenir un aperçu rapide. Il n'est pas conçu pour être utilisé de façon continue en radiologie ou dans d'autres services. Si le dispositif doit être utilisé pendant une période prolongée, prendre les précautions suivantes :

- Adopter une posture confortable, sur une chaise offrant un support lombaire approprié ou en s'asseyant ou se tenant bien droit.
- Réduire au minimum les mouvements de torsion, relâcher les épaules et soutenir le bras avec un coussin.
- Tenir le Kosmos Torso-One ou le Kosmos Lexsa sans trop le serrer, maintenir le poignet droit et réduire la pression appliquée sur le patient.
- Faire des pauses régulières.

Mesures de sécurité de base

La sonde, le logiciel ainsi que la tablette Samsung SM-T860, la tablette Lenovo TB-Q706F et l'iPad Pro 12.9" d'Apple (A2436) ont été déclarés conformes à la norme CEI 60601-1. Consulter la liste des tablettes compatibles EchoNous, disponible sur le site Web echonous.com/product/device-compatibility pour connaître toutes les configurations prises en charge. Pour une sécurité totale, respecter les avertissements et les mises en garde :

▲	Les appareils conformes aux normes CEI 60950-1 et CEI 62368-1 n'ont pas été évalués pour leur conformité à la norme CEI 60601-1 concernant la limite de température de contact avec le patient.
▲	Ne pas faire fonctionner ce système en présence de gaz inflammables ou de gaz d'anesthésie. Il existe un risque d'explosion. Le système n'est pas conforme aux environnements AP/APG comme définis dans la norme CEI 60601-1.
▲	Ne pas mettre la tablette en contact avec le patient. Tout contact de la tablette avec le patient peut provoquer un choc électrique ou un risque de brûlure.
▲	Ne pas charger la tablette lorsqu'une sonde EchoNous est branchée sur la tablette, sauf si la tablette et la ou les sonde(s) sont connectées au Kosmos Hub avec l'alimentation GlobTek, Inc GTM96600-6512-T3.
▲	N'utiliser que les appareils et les accessoires recommandés par EchoNous.

Il en va de la responsabilité de l'organisation de vérifier toute fuite de courant de la tablette utilisée avec les sondes EchoNous dans l'environnement du patient afin de garantir qu'elle répond aux exigences de la norme 60601-1.

Compatibilité électromagnétique

▲	Le système est conforme aux exigences de compatibilité électromagnétique des normes AS/NZ CISPR 11:2015 et CEI 60601-1-2:2014 : AMD1:2020. Cependant, les appareils de communication électroniques et mobiles peuvent transmettre de l'énergie électromagnétique dans l'air et l'absence d'interférences dans une installation ou un environnement spécifique n'est pas garantie. Les interférences peuvent entraîner des artéfacts, une distorsion ou une dégradation des images. Si le système cause ou réagit à des interférences, essayer de réorienter le système ou le dispositif concerné, ou éloigner les dispositifs. Pour plus d'informations, contacter le service clientèle ou le distributeur EchoNous.
▲	EchoNous ne recommande pas l'utilisation d'appareils électromédicaux haute fréquence à proximité de ses systèmes. L'appareil EchoNous n'a pas été validé pour une utilisation avec des appareils ou procédures d'électrochirurgie à haute fréquence. L'utilisation d'appareils électrochirurgicaux haute fréquence à proximité de ses systèmes peut conduire à un comportement anormal du système ou à son arrêt. Pour éviter tout risque de brûlure, ne pas utiliser les sondes Kosmos avec un appareil chirurgical haute fréquence. La connexion de l'électrode neutre chirurgicale haute fréquence risque de provoquer des brûlures si elle est défectueuse.
▲	Le système contient des composants et des circuits sensibles. Le non-respect des procédures antistatiques appropriées peut endommager le système. Signaler toute défaillance au service clientèle ou au distributeur EchoNous pour réparation.

Le **système** est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique défini ci-dessous. L'utilisateur du **système** doit veiller à ce qu'il soit utilisé dans un tel environnement.

Émissions électromagnétiques

TABLEAU 7-17. Recommandations et déclaration du fabricant : émissions électromagnétiques

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique : recommandations
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le système utilise l'énergie RF pour son fonctionnement interne uniquement. Ses émissions RF sont donc très faibles et il est peu probable qu'elles provoquent des interférences avec les appareils électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe A	
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Classe A	Le système peut être utilisé dans tous les établissements autres que ceux à usage domestique et ceux directement raccordés au réseau de distribution public basse tension qui alimente les bâtiments destinés à un usage domestique.
Variations de tension/ papillotement CEI 61000-3-3	Conforme	

Le **système** affiche une conformité de Classe A, qui signifie qu'il peut être utilisé dans tous les établissements autres que ceux à usage domestique et ceux directement raccordés au réseau de distribution public basse tension qui alimente les bâtiments destinés à un usage domestique. Si le **système** cause ou réagit à des interférences, suivre les directives de la section d'avertissements ci-dessus.

Immunité électromagnétique

TABLEAU 7-18. Recommandations et déclaration du fabricant : immunité électromagnétique

Test d'immunité	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique : recommandations
Décharges électrostatiques (DES) CEI 61000-4-2	±8 kV au contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV dans l'air	Le sol doit être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. S'il est recouvert d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoires électriques rapides/salves CEI 61000-4-4	±2 kV à une fréquence de répétition de 100 kHz sur les lignes d'alimentation électrique	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Surtension CEI 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV de ligne à ligne ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV de ligne à la terre	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Chutes de tension, microcoupures et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation CEI 61000-4-11	0 % U_t ; 0,5 cycle à 0 degré, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés, 180 degrés, 225 degrés, 270 degrés et 315 degrés. 0 % U_t ; 1 cycle et 70 % U_t 25/30 cycles monophasé à 0 degré	La qualité de l'alimentation secteur doit correspondre à celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.

TABLEAU 7-18. Recommandations et déclaration du fabricant : immunité électromagnétique

Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	8 A/m à 30 kHz en modulation CW 65 A/m à 134,2 kHz en modulation d'impulsion de 2,1 kHz 75 A/m à 13,56 MHz en modulation d'impulsions de 50 kHz	Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent se situer au même niveau que ceux d'un emplacement type au sein d'un environnement commercial ou hospitalier type.
^{2,3} RF par conduction CEI 61000-4-6	3 Vrms ⁶ de 0,15 MHz à 80 MHz 6 Veff dans les bandes ISM et radioamateurs entre 0,15 MHz et 80 MHz 80 % AM à 1 kHz	Les appareils de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à une distance du système ou de ses composants, y compris les câbles, inférieure à la distance de séparation recommandée calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée $d = 1,2 \sqrt{P}$

TABLEAU 7-18. Recommandations et déclaration du fabricant : immunité électromagnétique

RF par rayonnement CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz–2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz	$d = 1,2 \sqrt{P}$ de 80 MHz à 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ de 800 MHz à 2,5 GHz Où P est la puissance nominale maximale de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur, et d la distance de séparation recommandée exprimée en mètres (m). L'intensité de champ des émetteurs RF fixes, telle qu'elle est déterminée par une étude électromagnétique du site ⁴ , doit être inférieure au niveau de conformité dans chaque plage de fréquences ⁵ . Des interférences peuvent se produire à proximité d'appareils portant le symbole suivant : 
-------------------------------------	--	--

1 UT représente la tension secteur avant l'application du niveau de test.
 2 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
 3 Ces directives ne s'appliquent pas nécessairement à tous les cas de figure. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
 4 L'intensité de champ provenant d'émetteurs fixes, tels que les stations de base pour téléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateur, la radiodiffusion AM et FM et la télédiffusion, ne peut être mesurée théoriquement avec précision. Pour évaluer le rayonnement électromagnétique imputable aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée sur le site d'utilisation du système dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, il faudra s'assurer du bon fonctionnement du système dans un tel environnement. En cas de fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement du système.
 5 Pour la plage de fréquences comprise entre 150 kHz et 80 MHz, l'intensité de champ doit être inférieure à 3 V/m.

	Lors de l'utilisation du support mobile en option, le système peut être sensible aux décharges électrostatiques et nécessiter une intervention manuelle. Si les décharges électrostatiques provoquent une erreur du système , débrancher la sonde et la rebrancher pour rétablir le fonctionnement.
	L'utilisation de câbles ou accessoires autres que ceux spécifiés peut entraîner une augmentation des émissions ou une baisse de l'immunité du système.

Distances de séparation

TABLEAU 7-19. Distances de séparation

Puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur W	Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur		
	De 150 kHz à 80 MHz	De 80 MHz à 800 MHz	De 800 MHz à 2,5 GHz
	$d = 1,2 \sqrt{P}$	$d = 1,2 \sqrt{P}$	$d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur.
 REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation de la plage de fréquences la plus élevée s'applique.
 REMARQUE 2 : ces directives ne s'appliquent pas nécessairement à tous les cas de figure. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Normes

HIPAA

Le système Kosmos comprend des paramètres de sécurité permettant de satisfaire les exigences de sécurité applicables énoncées dans la norme HIPAA. Les utilisateurs sont tenus pour responsables de la sécurité et de la protection de toutes les informations de santé protégées électroniquement qui sont collectées, stockées, analysées et transmises sur le système.

Loi américaine sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie (HIPAA), Pub.L. N° 104-191 (1996). 45 CFR 160, Exigences administratives générales.

45 CFR 164, Sécurité et confidentialité.

DICOM

Le système Kosmos est conforme à la norme DICOM telle que spécifiée dans la Déclaration de conformité DICOM du système Kosmos, disponible sur le site echonous.com. Cette déclaration fournit des informations sur le but, les caractéristiques, la configuration et les caractéristiques techniques des connexions réseau prises en charge par le système.

-- Fin de la section --

Entretien du système KOSMOS

Nettoyage et désinfection

Mises en garde générales

▲	Les instructions de nettoyage fournies sont basées sur les exigences imposées par la Food and Drug Administration des États-Unis. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une contamination croisée et une infection du patient.
▲	Les instructions de nettoyage et de désinfection doivent être suivies lors de l'utilisation d'une protection de sonde.
▲	Certains produits chimiques de retraitement peuvent entraîner une réaction allergique chez certaines personnes.
▲	S'assurer que la date d'expiration des solutions de nettoyage et de désinfection ainsi que des lingettes n'est pas dépassée.
▲	Ne pas laisser de solution de nettoyage ou de désinfectant pénétrer dans les connecteurs de la tablette ou de la sonde Kosmos.
▲	Porter des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés, recommandés par le fabricant du produit chimique, tels que des lunettes et des gants de protection.
▲	Ne pas ignorer d'étape ni raccourcir le processus de nettoyage et de désinfection de quelque manière que ce soit.
▲	Ne pas pulvériser les solutions de nettoyage et les désinfectants directement sur les surfaces de la tablette ni sur les connecteurs de la tablette et de la sonde Kosmos. La solution risque de s'introduire dans le système Kosmos et de l'endommager, annulant ainsi la garantie.

▲	Ne pas essayer de nettoyer ou de désinfecter la tablette, les sonde Kosmos ou le câble de la sonde Kosmos en utilisant une méthode ou un produit chimique qui ne figure pas dans ce manuel. Cela risque d'endommager le système Kosmos et d'annuler la garantie.
▲	Ne pas tirer sur le câble de la sonde Kosmos lors de la prise en main ou la désinfection du dispositif. Le fait de tirer sur le câble peut endommager la sonde.

Tablette

▲	La tablette n'est pas stérile à la livraison. Ne pas essayer de la stériliser.
▲	Pour éviter tout risque de décharge électrique, mettre la tablette hors tension et le débrancher de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage

Éviter de pulvériser les solutions de nettoyage et de désinfection directement sur la tablette. Les pulvériser plutôt sur un chiffon non abrasif et essuyer délicatement la sonde. Veiller à ce qu'il ne reste pas d'excédent de solution sur la surface après le nettoyage. Suivre la méthode de nettoyage et de désinfection ci-dessous pour la tablette.

1. Après chaque utilisation, débrancher le câble USB de la sonde Kosmos.
2. Retirer tous les accessoires, tels que le stéthoscope ou le bloc d'alimentation.
3. À l'aide d'une lingette désinfectante préhumidifiée approuvée, essuyer délicatement l'écran et toutes les zones de la tablette. Choisir une lingette approuvée par EchoNous dans la liste **Lingettes préhumidifiées**.
4. Si nécessaire, nettoyer la tablette avec des lingettes supplémentaires pour éliminer tous les contaminants visibles.

■	Après la désinfection, vérifier que l'écran ne présente pas de fissures. S'il est endommagé, cesser d'utiliser le système et contacter le service clientèle EchoNous.
---	---

Kosmos Power Pack

▲	Le Power Pack n'est pas stérile à la livraison. Ne pas essayer de le stériliser.
▲	Pour éviter tout risque de décharge électrique, mettre le Power Pack hors tension et le débrancher de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.

Éviter de pulvériser les solutions de nettoyage et de désinfection directement sur le Power Pack. Les pulvériser plutôt sur un chiffon non abrasif et essuyer délicatement le Power Pack. Veiller à ce qu'il ne reste pas d'excédent de solution sur la surface après le nettoyage. Suivre la méthode de nettoyage et de désinfection ci-dessous pour le Power Pack.

1. Après chaque utilisation, débrancher le câble USB de la tablette.
2. Débrancher les sondes.
3. À l'aide d'une lingette désinfectante préhumidifiée approuvée, essuyer délicatement toutes les surfaces du Power Pack. Choisir une lingette approuvée par EchoNous dans la liste fournie dans le Tableau 8-1 Lingettes préhumidifiées.
4. Si nécessaire, nettoyer le Power Pack avec des lingettes supplémentaires pour éliminer tous les contaminants visibles.

■	Après la désinfection, vérifier que le Power Pack ne présente pas de fissures. S'il est endommagé, cesser d'utiliser le Power Pack et contacter le service clientèle EchoNous.
---	--

TABLEAU 8-1. Lingettes préhumidifiées

Produit	Société	Principes actifs	Condition de contact
Sani-Cloth Super	PDI Inc.	Alcool isopropylique à 55,5 %, composés d'ammonium quaternaire, alkyl en C12-18 [(éthylphényl) méthyl] diméthyles, chlorures à 0,25 %, chlorure de n-alkyldiméthylbenzylammonium à 0,25 %	Temps de contact humide de 5 minutes pour la désinfection

Sondes Kosmos

Nettoyage

Respecter les instructions de nettoyage suivantes pour le Kosmos Torso-One et le Kosmos Lexsa. Les sondes Kosmos doivent être nettoyées après chaque utilisation. Le nettoyage des sondes Kosmos est une étape essentielle pour pouvoir procéder à une désinfection efficace.

Avant de nettoyer le Kosmos Torso-One ou le Kosmos Lexsa, lire les avertissements et mises en garde suivants.

	Toujours débrancher le câble USB des sondes Kosmos avant le nettoyage et la désinfection.
	Après le nettoyage, désinfecter les sondes Kosmos en suivant les instructions appropriées.
	Toujours porter des lunettes et des gants de protection lors du nettoyage et de la désinfection d'un appareil.
	Utiliser uniquement des lingettes recommandées par EchoNous. L'utilisation d'autres lingettes risque d'endommager la sonde Kosmos et d'annuler la garantie.

	Lors du nettoyage et de la désinfection des sondes Kosmos, ne pas laisser de liquide pénétrer dans les raccords électriques ou les parties métalliques du connecteur USB.
	L'utilisation d'un couvercle ou d'une protection n'exclut pas le nettoyage et la désinfection corrects d'une sonde Kosmos. Lors du choix d'une méthode de nettoyage et de désinfection, traiter les sondes Kosmos comme si aucun couvercle n'était utilisé au cours de la procédure.

Pour nettoyer les sondes :

- Après chaque utilisation, débrancher le câble USB de la sonde Kosmos.
- Retirer tous les accessoires qui sont raccordés à la sonde Kosmos ou qui la recouvrent, tels qu'une protection.
- Juste avant de l'utiliser, essuyer la sonde Kosmos avec une lingette préhumidifiée approuvée.
- Avant de désinfecter la sonde Kosmos, retirer tout le gel échographique de sa surface à l'aide d'une lingette désinfectante préhumidifiée approuvée. Choisir une lingette approuvée par EchoNous dans la liste **Lingettes préhumidifiées**.
- Retirer les particules, le gel ou les fluides restants sur la sonde Kosmos à l'aide d'une autre lingette préhumidifiée de la liste **Lingettes préhumidifiées**.
- Si nécessaire, nettoyer la sonde Kosmos avec des lingettes supplémentaires pour éliminer tous les contaminants visibles.
- Avant de désinfecter la sonde Kosmos, s'assurer qu'elle est visiblement sèche.

Désinfection (de niveau intermédiaire)

Procéder comme suit pour désinfecter la sonde Kosmos en cas d'absence de contact avec une peau non intacte ou des membranes muqueuses intactes (utilisation non critique). Avant d'effectuer les étapes ci-dessous, lire les avertissements et mises en garde suivants.

	Pour la désinfection de bas niveau et de niveau intermédiaire, EchoNous a validé la procédure de désinfection de niveau intermédiaire.
	Toujours débrancher le câble USB des sondes Kosmos avant le nettoyage et la désinfection.

▲	Toujours porter des lunettes et des gants de protection lors de la désinfection d'un appareil.
▲	Avant la désinfection, nettoyer les sondes Kosmos en suivant les instructions appropriées pour retirer les gels, fluides et particules qui pourraient nuire au processus de désinfection.
▲	Utiliser uniquement des désinfectants recommandés par EchoNous. L'utilisation d'autres lingettes désinfectantes risque d'endommager la sonde Kosmos et d'annuler la garantie.

Pour désinfecter les sondes Kosmos (niveau intermédiaire) :

- Après le nettoyage, choisir un désinfectant de niveau intermédiaire dans la liste **Lingettes préhumidifiées** et respecter le temps de contact humide minimum recommandé.
- Avec une lingette neuve, essuyer le câble et la sonde Kosmos, en commençant par le câble exposé et en allant vers la tête de la sonde Kosmos pour éviter toute contamination croisée.
- Respecter le temps de contact humide requis. La sonde Kosmos doit rester humide. Utiliser au moins trois lingettes pour garantir une désinfection efficace.
- Avant de réutiliser la sonde Kosmos, s'assurer qu'elle est visiblement sèche.

▲	Inspecter la sonde Kosmos à la recherche d'éventuelles fissures, craquelures ou arêtes vives. Si la sonde Kosmos est endommagée, arrêter de l'utiliser et contacter le représentant EchoNous.
---	---

Désinfection (de haut niveau)

Effectuer les étapes suivantes pour procéder à la désinfection de haut niveau des sondes Kosmos lorsqu'elles ont été en contact avec des membranes muqueuses intactes ou une peau non intacte (utilisation semi-critique). La désinfection de haut niveau des sondes Kosmos a généralement lieu par immersion dans des désinfectants ou un agent stérilisant chimique de haut niveau.

Avant d'effectuer les étapes ci-dessous, lire les avertissements et mises en garde suivants.

▲	Toujours débrancher les sondes Kosmos de l'alimentation secteur au cours du nettoyage et de la désinfection.
▲	Avant la désinfection, nettoyer la sonde Kosmos en suivant les instructions appropriées sous Nettoyage pour retirer les gels, fluides et particules qui pourraient nuire au processus de désinfection.
▲	Toujours porter des lunettes et des gants de protection lors de la désinfection d'un appareil.
▲	Lors du nettoyage et de la désinfection des sondes Kosmos, ne pas laisser de liquide pénétrer dans les raccords électriques ou les parties métalliques de la clé USB.
▲	Ne pas essayer de désinfecter les sondes Kosmos en suivant une méthode qui ne figure pas dans ces instructions. Cela risque d'endommager la sonde Kosmos et d'annuler la garantie.
▲	Utiliser uniquement des désinfectants recommandés par EchoNous. L'utilisation d'une solution de désinfection non recommandée ou d'une concentration non appropriée risque d'endommager la sonde Kosmos et d'annuler la garantie.
▲	Si la sonde Kosmos est entrée en contact avec des membranes muqueuses intactes ou une peau non intacte (utilisation semi-critique), utiliser la procédure de nettoyage et de désinfection de haut niveau.

Pour désinfecter les sondes Kosmos (haut niveau) :

- Après le nettoyage, choisir un désinfectant de haut niveau compatible avec les sondes Kosmos. Pour une liste des désinfectants compatibles, voir **Solutions désinfectantes pour l'immersion des sondes Kosmos**.
- Tester la concentration de la solution à l'aide d'une bandelette de test Cidex OPA. S'assurer que la solution ne date pas de plus de 14 jours (dans un bidon déjà ouvert) ou 75 jours (dans un bidon tout juste ouvert).
- En cas d'utilisation d'une solution mélangée à l'avance, veiller à bien respecter la date de péremption.

- Immerger la sonde Kosmos dans le désinfectant comme illustré ci-dessous. Les sondes Kosmos ne peuvent être immergées que jusqu'au niveau indiqué. Ne tremper ou n'immerger aucune autre partie de la sonde Kosmos, par ex. le câble, le protecteur de cordon ou les connecteurs, dans des liquides.



- Voir **Solutions désinfectantes pour l'immersion des sondes Kosmos** pour la durée d'immersion et la température de contact.
- Ne pas immerger la sonde Kosmos au-delà du temps minimum nécessaire pour le niveau de désinfection semi-critique.
- Rincer la sonde Kosmos pendant au moins une minute dans de l'eau propre jusqu'au niveau d'immersion pour éliminer les résidus chimiques. Ne tremper ou n'immerger aucune autre partie de la sonde Kosmos, par ex. le câble, le protecteur de cordon ou le connecteur.
- Répéter la procédure en rinçant trois fois pour garantir un rinçage adéquat.
- Sécher la sonde Kosmos à l'air ou à l'aide d'un chiffon stérile doux jusqu'à ce qu'elle soit visiblement sèche.
- Essuyer le protecteur de cordon et les 45 premiers centimètres du câble de la sonde Kosmos avec une lingette approuvée de la liste **Lingettes préhumidifiées**.

- Examiner la sonde Kosmos à la recherche d'éventuelles fissures, craquelures ou arêtes vives. Si la sonde Kosmos est endommagée, arrêter de l'utiliser et contacter le représentant EchoNous.

TABLEAU 8-2. Solutions désinfectantes pour l'immersion des sondes Kosmos

Produit	Société	Principes actifs	Condition de contact
Cidex OPA Solution	Advanced Sterilization Products	Produits à 0,55 % d'ortho-phtalaldéhyde	12 minutes à 20 °C

- Vérifier la date de péremption sur le flacon pour s'assurer que le désinfectant n'est pas périmé. Mélanger ou vérifier que les produits de désinfection ont la concentration recommandée par le fabricant (à l'aide, par exemple, d'une bandelette de test chimique).
- Vérifier que la température du désinfectant se situe dans les limites recommandées par le fabricant.

Lignes directrices pour les RA (Reprocesseurs automatiques)

▲	Toujours débrancher le câble de la sonde Kosmos avant le nettoyage et la désinfection.
▲	S'assurer que l'isolation du câble est intacte avant et après le nettoyage.
■	Le suppresseur CEM présent sur les sondes doit se trouver à l'intérieur de la chambre trophon2 située sous la pince du câble durant la désinfection.

Toutes les sondes Kosmos sont compatibles avec le système Trophon2 Nanosonic™. Consulter le manuel d'utilisation Trophon®2 pour obtenir les instructions détaillées concernant la désinfection des sondes à ultrasons.

Pour toute question concernant la compatibilité avec d'autres systèmes RA, contacter l'assistance EchoNous.

Recyclage et mise au rebut

▲	Ne pas incinérer ni jeter le Kosmos Power Pack dans les ordures ménagères à la fin de sa vie. La batterie au lithium peut poser un risque environnemental et d'incendie.
▲	La batterie lithium-ion du Kosmos Power Pack peut exploser en cas d'exposition à des températures très élevées. Ne pas détruire cet appareil en l'incinérant ou en le brûlant. Le renvoyer à EchoNous ou au représentant local qui procédera à sa mise au rebut.

Le système doit être mis au rebut de façon écologique, dans le respect des réglementations fédérales et locales en vigueur. EchoNous recommande de déposer les sondes Kosmos et le Kosmos Power Pack dans un centre de recyclage spécialisé dans le recyclage et la mise au rebut d'appareils électroniques.

Si une sonde Kosmos ou le Kosmos Power Pack ont été exposés à des matières biologiquement dangereuses, EchoNous recommande d'utiliser des récipients pour produits contaminés, et ce conformément aux réglementations fédérales et locales en vigueur. Déposer les sondes Kosmos et le Kosmos Power Pack dans un centre de traitement des déchets spécialisé dans la mise au rebut des déchets présentant un risque biologique.

Dépannage

Inspection, maintenance et étalonnage préventifs

- Le système Kosmos ne nécessite pas de maintenance ou d'étalonnage préventifs.
- Le système Kosmos ne contient aucune pièce dont l'entretien peut être assuré par l'utilisateur.
- La batterie du Kosmos Power Pack n'est pas remplaçable.

■	Si le système Kosmos ne fonctionne pas comme prévu, contacter le service clientèle EchoNous.
▲	Ne pas ouvrir le boîtier du Kosmos Power Pack.

-- Fin de la section --

Caractéristiques techniques

Caractéristiques du système

Dispositif	Hau- teur (mm)	Lar- geur (mm)	Profon- deur (mm)	Poids (grammes)	Câble (m)	Fréquence de fonction- nement (MHz)	Profondeur de balayage (cm)
Kosmos Torso-One	150*	56	35	267 (avec câble équipé de ferrite)	1,5	1,5 - 4,5	4 - 30
Kosmos Lexsa	155	56	35	280 (avec câble)	1,5	3 - 10,5	1 - 10
Kosmos Power Pack	24,25	85,7	146	321	0,1	-----	-----

* Câble exclus (longueur de l'étui en plastique dur)

Conditions environnementales d'utilisation et de stockage des sondes Kosmos, du Kosmos Power Pack et des tablettes compatibles

Les sondes Kosmos et le Kosmos Power Pack sont conçus pour être utilisés et stockés dans des conditions ambiantes normales au sein d'un établissement médical.

Sondes Kosmos et tablettes : Plages de conditions d'utilisation, chargement, transport et stockage

	Fonctionnement	Transport/stockage
Température (°C)	0 à +40 °C	-20 à +60 °C
Humidité relative (sans condensation)	15 à 95 %	15 à 95 %
Pression	62 à 106 kPa	62 à 106 kPa

Kosmos Power Pack : Plages de conditions d'utilisation, chargement, transport et stockage

	Fonctionnement	Transport/stockage
Température (°C)	0 à +40 °C	-20 à +60 °C
Humidité relative (sans condensation)	15 à 95 %	15 à 95 %
Pression	70 à 106 kPa	70 à 106 kPa

Mode de fonctionnement

	Après un stockage à des températures extrêmes, vérifier la température de surface de la sonde Kosmos avant de l'appliquer sur un patient. Une surface froide ou chaude peut brûler le patient.
	N'utiliser, ne charger et ne stocker le Kosmos que dans la limite des paramètres ambiants approuvés.
	Lorsque le système Kosmos est utilisé à des températures ambiantes élevées (par ex. 40 °C), sa fonction de sécurité peut désactiver la fonction d'échographie pour maintenir une température de surface sans danger.

Le système Kosmos applique des limites de balayage pour maintenir des températures de contact sûres pour l'utilisateur.

Caractéristiques électriques du Kosmos Power Pack

Sortie

Tablette : 5 V c.c. $\pm 5\%$, max. 1,5 A

Sondes Kosmos : 5 V c.c. $\pm 5\%$, max. 2,5 A

Batteries internes

Batterie lithium-ion : 3,7 V, 6,4 Ah

Durée de charge de la batterie : la durée de charge de la batterie de 0 % à 90 % de sa capacité est d'environ 3 heures.

Autonomie : un Power Pack complètement chargé offre environ 180 minutes de fonctionnement continu. La performance peut varier selon les modes d'examen utilisés.

Bloc d'alimentation (SWI25-12-N CUI Inc.)

Entrée : 100–240 V~, 47–63 Hz, 0,7 A

Sortie : 12 V c.c., 2,1 A, 25,2 W

-- Fin de la section --

PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE

Utilisation d'un réseau sans fil

Fonctions

Une connexion au réseau informatique est nécessaire pour utiliser la fonctionnalité suivante.

- Stocker les données d'examen (images statiques et clips) acquises par le système Kosmos dans l'archive PACS (Picture Archiving and Communication System) via une communication DICOM. Pour plus de détails, consulter la Déclaration de conformité DICOM disponible sur le site Web d'EchoNous.
- Régler l'heure du système Kosmos de manière exacte en interrogeant le service de temps réseau.

Sécurité

Protection des données du patient

Il incombe à l'utilisateur de configurer son appareil Android ou iOS de façon à respecter les politiques de sécurité et les exigences réglementaires locales. EchoNous recommande de protéger les données du patient en chiffrant le dispositif et en définissant un mot de passe pour y accéder. L'application Kosmos chiffre la base de données patient pour renforcer le niveau de sécurité.

Utilisation d'un réseau sans fil

Consulter la documentation qui accompagne la tablette approuvée par EchoNous pour obtenir les informations concernant la configuration en réseau sans fil de l'appareil. Consulter le service de sécurité informatique pour s'assurer que le dispositif est configuré conformément à toutes les exigences applicables en matière de sécurité.

Réseau de connexion du dispositif

Pour garantir la sécurité, utiliser un réseau informatique isolé de l'environnement extérieur par un pare-feu.

Mesures de récupération en cas de défaillance du réseau informatique

Il arrive parfois que la connexion à un réseau informatique ne soit pas fiable, ce qui peut générer des problèmes d'utilisation des fonctions décrites dans la section **Fonctions**. Par conséquent, les situations à risque suivantes peuvent survenir :

Défaillance réseau	Impact sur l'appareil	Risque	Contre-mesures
Le réseau informatique est instable	Impossibilité de transmettre les données d'examen au PACS	Retard de diagnostic	Le système Kosmos possède une mémoire interne dans laquelle les données d'examen sont stockées. Lorsque le réseau informatique est redevenu stable, l'utilisateur peut relancer le transfert des données.
	Retard de transmission à un PACS		
	Données incorrectes envoyées à un PACS	Diagnostic erroné	L'intégrité des données est assurée par les protocoles TCP/IP et DICOM utilisés par le système Kosmos.
	Impossibilité d'obtenir l'heure depuis un serveur de temps	Données d'examen incorrectes	Le système Kosmos permet de saisir la date et l'heure de manière manuelle.
	Date et heure incorrectes		Le système Kosmos indique toujours la date et l'heure sur l'écran principal.

Le pare-feu est inopérant	Attaque par le réseau	Manipulation de données d'examen	Le système Kosmos ferme les ports réseau inutiles.
	Infection par un virus informatique	Perte de données d'examen	Le système Kosmos empêche les utilisateurs de charger des logiciels et de les exécuter.

- La connexion de l'appareil à un réseau informatique comportant d'autres systèmes peut entraîner des risques jusqu'alors non identifiés pour les patients, les opérateurs ou des tiers. Avant de connecter l'appareil à un réseau informatique non contrôlé, s'assurer que tous les risques potentiels liés à de telles connexions ont été identifiés et évalués et que des contre-mesures ont été prises. La norme CEI 80001-1:2010 fournit des indications permettant de gérer ces risques.
- En cas de modification d'un paramètre du réseau informatique auquel le système Kosmos est connecté, vérifier que ce changement n'affecte pas le système et prendre les mesures qui s'imposent. Exemples de modifications du réseau informatique :
 - Changement de la configuration du réseau (adresse IP, routeur, etc.)
 - Connexion d'éléments supplémentaires
 - Déconnexion d'éléments
 - Mise à jour des équipements
 - Mise à niveau des équipements
- Les modifications du réseau informatique susceptibles de présenter de nouveaux risques doivent faire l'objet d'une évaluation supplémentaire.

-- Fin de la section --

PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE

Terme	Description
A2C	Apicale 2 cavités.
A4C	Apicale 4 cavités.
ACEP	American College of Emergency Physicians (Collège américain des médecins d'urgence).
Analyse	État du système KOSMOS permettant d'analyser et de modifier les données patient si elles n'ont pas été archivées.
Annotation	Les annotations sont des notes textuelles, pointeurs et/ou mesures ajoutés par un clinicien sur une image ou un clip. Une annotation apparaît sous forme de calque sur l'image ou le clip.
Archive	Lorsqu'un rapport a été généré, les informations du patient sont mises à jour dans le système EMR/PACS de l'hôpital. Le dispositif doit disposer d'une connexion sécurisée pour le transfert des données. Une fois archivé, un examen ne peut plus être modifié. À ce stade, l'examen peut être supprimé en toute sécurité du système KOSMOS afin de libérer de l'espace pour de nouveaux examens.
Calcul	Les calculs sont des estimations réalisées à partir d'ensembles de mesures spécifiques.
CdV	Le champ de vue désigne l'espace en deux dimensions de l'acquisition d'images en mode B.
Ciné	Une ciné est une suite d'images stockées numériquement sous la forme d'une séquence d'images individuelles. Elle est enregistrée à des cadences d'images élevées et peut contenir plus d'images que celles affichées en cours d'examen.
Clip	Un clip est composé de courtes séquences de plusieurs images comme un film.

Terme	Description
Coordonnées physiques	Position dans le champ de vue, exprimée en termes de dimensions physiques en millimètres ou en radians par rapport à un point de référence donné.
Curseur	La plupart des mesures sont effectuées à l'aide de curseurs qui sont glissés en position. Le curseur actif est représenté par une poignée ronde en surbrillance.
DICOM	Digital Imaging and Communications in Medicine (imagerie numérique et communications en médecine). La norme DICOM est la norme la plus répandue et la plus fondamentale de l'imagerie médicale numérique. Il s'agit d'un protocole qui englobe à la fois le transfert, le stockage et l'affichage des données, développé et conçu pour couvrir tous les aspects fonctionnels de la médecine moderne. Les fonctionnalités du PACS reposent sur la norme DICOM.
Échographie	L'échographie est un des préréglages du système, dans lequel les paramètres du système sont optimisés pour examiner un certain organe, tel que le cœur ou les poumons. Les échographies peuvent inclure plusieurs images, clips et rapports, qu'il est possible d'enregistrer. Le préréglage d'échographie exécute des calculs, des mesures et des rapports.
État figé	État dans lequel le système KOSMOS passe lorsque le bouton Figé est enfoncé en mode d'imagerie en direct. L'état figé permet d'ajouter des annotations sur une image de la ciné et d'enregistrer l'image figée. Les mesures n'apparaissent que sur une seule image de la ciné, mais les annotations sont visibles sur la totalité de la ciné. Lorsqu'un clip est enregistré à partir de la ciné, les annotations sont sauvegardées sous forme de calques dans le clip, mais pas les mesures. En effet, les mesures ne sont généralement pertinentes que pour une image de la ciné, pas pour toute la série d'images.

Terme	Description
Étude	Une étude comprend une ou plusieurs séries d'images médicales et d'états de présentation liés de façon logique pour le diagnostic d'un patient. Chaque étude est associée à un patient. Une étude peut inclure des instances composites créées par une seule modalité, par plusieurs modalités ou par plusieurs dispositifs de la même modalité. Dans le système KOSMOS, le terme « examen » a la même signification que le terme « étude » dans le monde DICOM. Un examen contient tous les objets, images, clips et rapports qui sont enregistrés au cours d'un examen clinique d'un patient à l'aide du système KOSMOS, et généralement associés à une visite du patient.
Examen	Un examen contient tous les objets, images, clips et rapports qui sont enregistrés au cours d'un examen clinique d'un patient à l'aide du système KOSMOS, et généralement associés à une visite du patient.
Examen terminé	Lorsqu'un examen a été finalisé, aucune image ne peut plus y être ajoutée. Il est néanmoins possible d'ajouter/modifier/supprimer des annotations enregistrées sous forme de calques sur les images/clips jusqu'à ce que l'examen soit archivé. Une fois archivé, rien ne peut plus être modifié. Si le clinicien ne finalise pas un examen, le système KOSMOS le finalise automatiquement à la mise hors tension du système KOSMOS.
FC	Fréquence cardiaque.
FE	Fraction d'éjection, calculée comme suit : (pourcentage) : $FE = (VTD - VTS) / VTD \times 100$
Image	Une image est une trame unique d'une vue échographique capturée par le système KOSMOS.
IMC	Indice de masse corporelle.
Ligne M	Ligne qui apparaît dans le mode B, dont le mode M affiche le tracé.

Terme	Description
Mesure	Une mesure correspond à la mesure d'une distance ou d'une zone sur les images sans interférences avec l'anatomie sous-jacente. L'outil (par ex. un curseur ou une ellipse) et les valeurs mesurées apparaissent sur un calque de mesure.
Mode B	La sonde Kosmos Torso-One acquiert un plan à travers le corps et en affiche une image 2D à l'écran. Également appelé « imagerie en mode B ».
MWL	Liste de travail des modalités.
PACS	Picture Archiving and Communication System (système d'archivage et de communication d'images). Les systèmes PACS désignent les systèmes médicaux (matériels et logiciels) développés à des fins d'imagerie médicale numérique. Les principaux composants d'un PACS sont les dispositifs d'acquisition d'images numériques, les archives d'images numériques et les postes de travail. Dans le présent document, les paramètres PACS font référence aux paramètres de connexion aux archives d'images numériques.
Photo	La caméra du système KOSMOS permet de prendre des photos d'une plaie ou d'une blessure dans le cadre d'un examen.
PIMS	Patient Information Management System (système de gestion des informations patient).
Pointeur	Un pointeur est une icône en forme de flèche qu'un clinicien peut placer à un endroit d'une image ou d'un clip pour porter l'attention sur un élément. Il est affiché sous forme de calque sur l'image ou le clip.
Rapport	Un rapport comprend les détails d'un examen, ainsi que les notes ajoutées par le clinicien.
ROI	Région d'intérêt. La ROI désigne la région délimitée dans le champ de vue, qui affiche les informations de flux en couleurs.

Terme	Description
Snackbar	La snackbar est un bref message qui s'affiche au bas de nombreux écrans du système KOSMOS. Les messages ne nécessitent aucune intervention et disparaissent automatiquement après quelques instants.
TD	Télédiastolique.
Test ping	Un test ping permet de vérifier une connexion TCP/IP. Si le test ping a réussi, la connexion entre le système KOSMOS et l'archive PACS fonctionne.
TS	Téléstolique.
Vérifier	Option utilisée pour exécuter une commande C-Echo DICOM, qui envoie un signal à l'archive PACS en utilisant un protocole DICOM pour confirmer que l'archive PACS fonctionne et qu'elle est disponible sur le réseau.
VES	Volume d'éjection systolique, calculé selon la formule : $VES = VTD - VTS$
VG	Ventricule gauche.
VTD	Volume télédiastolique.
VTS	Volume téléstolique.

PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE

Politique d'application pour les systèmes d'imagerie pendant l'urgence sanitaire publique liée à la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19), guide de la Food and Drug Administration pour l'industrie et le personnel, avril 2020

Indications

Utilisateurs visés

Le Kosmos Trio, le processus FE assisté par IA et les outils AI FAST doivent uniquement être utilisés par des professionnels de santé qualifiés ou sous la supervision ou le guidage personnel d'un professionnel de santé formé ou titulaire d'une licence. Le Kosmos Trio, le processus FE assisté par l'IA et les outils AI FAST et leurs utilisateurs (soumis à la *politique d'application pour les systèmes d'imagerie pendant l'urgence sanitaire publique liée à la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) et au guide de la Food and Drug Administration pour l'industrie et le personnel, avril 2020*) n'ont pas été approuvés par la FDA.

Utilisation prévue/Consignes d'utilisation

Le Kosmos Trio est un système d'étiquetage d'image, d'évaluation et de guidage automatique qui permet la collecte d'images par les praticiens de santé. Le processus FE assisté par l'IA utilise l'IA pour permettre aux praticiens de santé d'effectuer les calculs initiaux de la FE. AI FAST utilise un algorithme IA pour détecter et afficher l'étiquetage en temps réel des structures anatomiques. Kosmos Trio, le processus FE assisté par IA et AI FAST doivent uniquement être

utilisés par un professionnel de santé qualifié, ou sous la supervision ou le guidage personnel d'un professionnel de santé formé ou titulaire d'une licence. Kosmos Trio, le processus FE assisté par l'IA et AI FAST ont permis de traiter les besoins d'analyse d'image en urgence durant la crise de la COVID-19. Kosmos Trio, le processus FE assisté par l'IA et AI FAST n'ont pas été approuvés par la FDA.

Performances du produit

Le système KOSMOS a été conçu et évalué pour répondre aux normes de consensus applicables suivantes, reconnues par la FDA. Tous les tests de vérification et de validation du système KOSMOS confirment que les caractéristiques du produit sont respectées.

- ANSI AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 ANSI AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 et A1:2012, C1:2009/(R)2012 et A2:2010/2012 (texte consolidé) Appareils électromédicaux — Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles (CEI 60601-1:2005, MOD)
- ANSI AAMI CEI 60601-2-27:2011 (R)2016 Appareils électromédicaux — Partie 2-27 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de surveillance électrocardiographique (ensemble limité d'exigences de test)
- ANSI AAMI CEI 60601-1-2:2014 : AMD1:2020 Appareils électromédicaux — Partie 1-2 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles — Norme collatérale : perturbations électromagnétiques — Exigences et essais
- CEI 60601-1-6 édition 3.1 2013-10 Appareils électromédicaux — Partie 1-6 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles — Norme collatérale : utilisabilité
- ANSI AAMI CEI 62366-1:2015 Dispositifs médicaux — Partie 1 : application de l'ingénierie d'utilisabilité aux dispositifs médicaux
- CEI 60601-2-37 édition 2.1 2015 Appareils électromédicaux — Partie 2-37 : exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de diagnostic et de surveillance médicaux à ultrasons
- NEMA UD 2-2004 (R2009) Norme de mesure de la puissance acoustique pour le matériel d'échographie diagnostique — Révision 3
- CEI 62359 édition 2.1 2017-09 VERSION CONSOLIDÉE Ultrasons — Caractérisation du champ — Méthodes d'essai pour la détermination d'indices thermique et mécanique des champs d'ultrasons utilisés pour le diagnostic médical

- ANSI AAMI CEI 62304:2006/A1:2016 Logiciels de dispositifs médicaux — Processus du cycle de vie du logiciel [amendement 1 (2016) inclus]
- ANSI AAMI ISO 10993-1:2009/(R)2013 Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 1 : Évaluation et essais au sein d'un processus de gestion du risque
- ANSI AAMI ISO 14971:2007/(R)2010 (corrigée le 4 octobre 2007) Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux

Risques potentiels et atténuations

Risque/Atténuation 1

Risque : perte ou dégradation des fonctions

Cause initiale dans la séquence d'événements : erreur logicielle

Séquence d'événements : l'utilisateur examine l'anatomie cardiaque ou abdominale avec la fonction d'annotation automatique activée --> une ou plusieurs structures anatomiques cardiaques ou abdominales sont mal annotées.

Situation dangereuse : mauvaise interprétation de l'anatomie cardiaque ou abdominale ou de l'orientation de l'image

Préjudice : frustration de l'utilisateur

Atténuation :

 Ne pas se fier à l'outil d'étiquetage automatique à des fins de diagnostic. Les libellés automatiques aident à s'entraîner et à s'orienter rapidement vers l'anatomie du cœur. Faire preuve de jugement pour s'assurer que les annotations sont correctes.

Exigence de conception : la fonction d'annotation automatisée doit identifier correctement les structures cardiaques et abdominales avec une précision d'au moins 80 % lorsqu'un résultat s'affiche.

Risque/Atténuation 2

Risque : perte ou dégradation des fonctions

Cause initiale dans la séquence d'événements : erreur logicielle

Séquence d'événements : l'utilisateur examine l'anatomie cardiaque ou abdominale avec la fonction d'annotation automatique activée --> les annotations automatiques recouvrent une structure anatomique importante pour l'évaluation de diagnostic.

Situation dangereuse : des informations importantes de diagnostic sont recouvertes sur l'image

Préjudice : frustration de l'utilisateur

Atténuation :

 Ne pas se fier à l'outil d'étiquetage automatique à des fins de diagnostic. Les libellés automatiques aident à s'entraîner et à s'orienter rapidement vers l'anatomie du cœur. Faire preuve de jugement pour s'assurer que les annotations sont correctes.

Exigence de conception : la fonction d'annotation automatisée doit identifier correctement les structures cardiaques et abdominales avec une précision d'au moins 80 % lorsqu'un résultat s'affiche.

Étude d'utilisabilité : Une étude d'utilisabilité sommative doit être réalisée, conformément à la norme CEI 62366. Le système est exempt d'erreurs d'utilisation susceptibles de blesser le patient/l'utilisateur.

Risque/Atténuation 3

Risque : puissance ou fonctionnalité incorrecte ou inappropriée

Cause initiale dans la séquence d'événements : erreur logicielle

Séquence d'événements : l'utilisateur est en processus FE --> l'algorithme d'évaluation de l'image indique que la qualité de l'image est basse (1 ou 2), alors que la qualité de l'image est haute (4 ou 5).

Situation dangereuse : frustration de l'utilisateur

Préjudice : frustration de l'utilisateur

Atténuation :

Étude clinique : la précision de la fonction d'évaluation, basée sur l'échelle d'évaluation d'assurance qualité en 5 points de l'American College of Emergency Physicians, est vérifiée et validée dans le rapport d'évaluation clinique de l'algorithme d'évaluation et de guidage.

Risque/Atténuation 4

Risque : puissance ou fonctionnalité incorrecte ou inappropriée

Cause initiale dans la séquence d'événements : erreur d'utilisation

Séquence d'événements : l'utilisateur est en processus FE --> l'algorithme d'évaluation de l'image indique que la qualité de l'image est haute (4 ou 5) alors que la qualité de l'image est basse (1 ou 2) --> l'utilisateur acquiert un plan d'image sous-optimal pour les images A4C et/ou A2C --> l'utilisateur se fie à l'algorithme plutôt qu'au jugement d'un expert --> l'erreur dans la sélection du plan d'image entraîne une erreur cliniquement significative de (FE/VES/DC).

Situation dangereuse : évaluation imprécise de la fonction systolique

Préjudice : diagnostic erroné

Atténuation :

Exigence de conception :

- Après l'enregistrement d'un clip A4C ou A2C, le système doit permettre à l'utilisateur d'accepter ou de refuser ce clip pour le calcul de la FE. Si l'utilisateur refuse un clip, il peut le réenregistrer.
- Le système doit afficher les images A4C/A2C de référence pour comparaison dans l'écran d'imagerie FE.

- Le système doit vérifier que les quantités calculées sont dans les limites raisonnables :
 - Le système doit avertir l'utilisateur si la FE est en dehors de la plage 0 % – 100 %.
 - Le système ne doit pas permettre à l'utilisateur de sauvegarder les modifications entraînant une valeur FE hors de la plage 0 % – 100 % dans l'écran Edit EF (Modifier FE).
 - Le système doit informer l'utilisateur quand : 1) La différence de FE entre A4C et A2C est supérieure à 30 % ; 2) le VTS est --> 400 ml ; 3) le VTD est --> 500 ml.

Étude clinique :

- Une étude clinique doit être réalisée pour démontrer la sécurité et l'efficacité de la fonction Processus FE en répondant à plusieurs critères clés.
- Une étude d'utilisabilité sommative doit être réalisée, conformément à la norme CEI 62366. Le système est exempt d'erreurs d'utilisation susceptibles de blesser le patient/l'utilisateur.
- La précision de la fonction d'évaluation, basée sur l'échelle d'évaluation d'assurance qualité en 5 points de l'American College of Emergency Physicians, est vérifiée et validée dans le rapport d'évaluation clinique de l'algorithme d'évaluation et de guidage.

Risque/Atténuation 5

Risque : puissance ou fonctionnalité incorrecte ou inappropriée

Cause initiale dans la séquence d'événements : erreur d'utilisation

Séquence d'événements : l'utilisateur ne comprend pas bien la signification du retour d'évaluation de l'image --> il poursuit et calcule la FE avec une mauvaise image (même si le système a indiqué qu'elle était mauvaise) --> l'utilisateur se fie à l'algorithme plutôt qu'au jugement d'un expert --> l'erreur dans la sélection du plan d'image entraîne une erreur cliniquement significative de (FE/VES/DC).

Situation dangereuse : évaluation imprécise de la fonction systolique

Préjudice : diagnostic erroné

Atténuation :

Exigence de conception :

- Après l'enregistrement d'un clip A4C ou A2C, le système doit permettre à l'utilisateur d'accepter ou de refuser ce clip pour le calcul de la FE. Si l'utilisateur refuse un clip, il peut le réenregistrer.
- Le système doit afficher les images A4C/A2C de référence pour comparaison dans l'écran d'imagerie FE.

Risque/Atténuation 6

Risque : puissance ou fonctionnalité incorrecte ou inappropriée

Cause initiale dans la séquence d'événements : erreur logicielle

Séquence d'événements : l'utilisateur est en processus FE --> les instructions de guidage d'image sont incorrectes --> l'utilisateur ne peut pas acquérir une vue A4C/A2C adéquate à partir du retour du système.

Situation dangereuse : frustration de l'utilisateur

Préjudice : frustration de l'utilisateur

Atténuation :

Étude clinique :

- Une étude d'utilisabilité sommative doit être réalisée, conformément à la norme CEI 62366. Le système est exempt d'erreurs d'utilisation susceptibles de blesser le patient/l'utilisateur.
- La précision de la fonction d'évaluation, basée sur l'échelle d'évaluation d'assurance qualité en 5 points de l'American College of Emergency Physicians, est vérifiée et validée dans le rapport d'évaluation clinique de l'algorithme d'évaluation et de guidage.

Risque/Atténuation 7

Risque : puissance ou fonctionnalité incorrecte ou inappropriée

Cause initiale dans la séquence d'événements : erreur d'utilisation

Séquence d'événements : l'utilisateur ne comprend pas bien la signification du retour de guidage de l'image --> il ne peut pas acquérir une vue adéquate à partir du retour du système.

Situation dangereuse : frustration de l'utilisateur

Préjudice : frustration de l'utilisateur

Atténuation :

Étude clinique :

- Une étude d'utilisabilité sommative doit être réalisée, conformément à la norme CEI 62366. Le système est exempt d'erreurs d'utilisation susceptibles de blesser le patient/l'utilisateur.
- La précision de la fonction d'évaluation, basée sur l'échelle d'évaluation d'assurance qualité en 5 points de l'American College of Emergency Physicians, est vérifiée et validée dans le rapport d'évaluation clinique de l'algorithme d'évaluation et de guidage.

Avertissements et mises en garde généraux

▲	Le système Kosmos n'est pas indiqué pour le diagnostic de la COVID-19. Le test de diagnostic in vitro est actuellement la seule méthode sûre pour diagnostiquer la COVID-19.
▲	Toutes les recommandations Trio, du processus FE et AI FAST fournies par le système Kosmos sont auxiliaires (aide) et l'utilisateur ne doit pas se fier uniquement ou principalement à ces informations pour diagnostiquer ou traiter la COVID-19.
▲	Toutes les images doivent être interprétées par un professionnel de santé qualifié et correctement formé.
▲	Les résultats du logiciel d'analyse d'images ne doivent pas être utilisés pour le dépistage, la détection/classification spécifique d'une maladie, le diagnostic d'une maladie ou les décisions de prise en charge des patients.

▲	L'analyse d'images ne doit être utilisée que comme une aide, et l'interprétation finale doit être fournie par un professionnel de santé qualifié et correctement formé.
▲	Les utilisateurs doivent être conscients des exigences locales concernant l'utilisation des systèmes d'imagerie.

Résumé des caractéristiques de l'ensemble de données utilisé pour développer l'outil d'étiquetage automatique

Deux études ont été réalisées afin d'évaluer les performances de l'algorithme d'étiquetage automatique de Kosmos pour valider les exigences de l'utilisateur et du système.

Une étude rétrospective dans laquelle 324 images échographiques de 108 clips à travers 14 vues cardiaques ainsi que des vues non cardiaques ont été traitées et analysées par AutoLabel dans un format de banc d'essai. Chacune des images était conservée et soigneusement annotée par des experts en vue de l'analyse des performances. Dans cette étude, les experts étaient d'accord avec AutoLabel pour 91 % des 324 images, ce qui était supérieur au seuil d'accord cible de 80 % au niveau de l'image. Cela correspondait à un accord au niveau du scan de 89 % pour 108 clips. Des statistiques secondaires au niveau de la structure ont donné une précision de 0,98, un rappel de 0,80 et une F1 ou mesure F de 0,88.

La seconde était une étude prospective, dans laquelle 6 utilisateurs (3 experts et 3 non-experts) examinaient 11 sujets et enregistraient 261 clips à travers 14 vues échographiques. Dans cette étude, un consensus de 6 experts étaient d'accord avec AutoLabel pour 92 % des clips, ce qui était supérieur au seuil d'accord cible de 80 % au niveau du clip. En outre, 1 218 structures anatomiques au total ont été détectées à travers 261 clips, dont 97 % ont été validés par AutoLabel et les experts. Une analyse supplémentaire a été réalisée pour chaque utilisateur, et chacun d'entre eux a produit un pourcentage d'accord AutoLabel-expert de 87 % ou plus au niveau du clip. Une analyse similaire a été réalisée pour chaque sujet, produisant également un accord de 85 % ou plus pour chaque sujet. Enfin, une analyse a été effectuée pour chaque vue avec 6 vues produisant 100 % d'accord, 4 vues produisant entre 90 % et 100 % d'accord, 2 vues produisant entre 80 % et 90 % d'accord et 3 vues produisant moins de 80 % d'accord.

L'étiquetage automatique a atteint le seuil de performances cible pour valider les exigences de l'utilisateur et du système dans les études rétrospective et prospective destinées à l'évaluation par EchoNous des performances de d'Autolabel.

En général, l'ensemble de données est considéré comme divers, car il est collecté par différents utilisateurs avec différents degrés de compétence (novice avec expérience médicale à cardiologue expert) et sur une population globale de sujets diverse.

Résumé des caractéristiques de l'ensemble de données utilisé pour développer l'outil d'évaluation et de guidage

Deux études ont été réalisées afin d'évaluer les performances de l'algorithme d'évaluation et de guidage de Kosmos pour valider les exigences de l'utilisateur et du système.

L'étude prospective, dans laquelle 6 utilisateurs (3 experts et 3 novices) ont examiné 4 à 5 sujets et enregistré 82 clips PLAX, A4C et A2C. Par le biais de cette étude, un consensus de 5 experts évaluateurs se sont accordés à dire que plus de 90 % (ce qui était supérieur au seuil d'accord cible de 80 %) des clips pris par de nouveaux utilisateurs font office de diagnostics pour évaluer la fonction globale du ventricule gauche, la taille du ventricule gauche, la taille du ventricule droit, l'épanchement péricardique non-trivial et la taille de l'atrium gauche.

Pour une analyse du niveau d'examen, un consensus de 5 experts évaluateurs se sont accordés à dire que les examens effectués par de nouveaux utilisateurs font office de diagnostics pour évaluer la fonction globale des ventricules, la taille du ventricule gauche, la taille du ventricule droit, l'épanchement péricardique non-trivial et la taille de l'atrium gauche. Il a été observé que la performance des nouveaux utilisateurs est de très haut niveau et qu'elle est parfois même supérieure à celle des utilisateurs experts. Pour finir, une analyse a été réalisée pour chaque vue (PLAX A4C et A2C), produisant un accord de 80 % ou plus pour chaque vue, en évaluant presque tous les paramètres cliniques. Encore une fois, la performance des nouveaux utilisateurs a été au même niveau que celle des utilisateurs experts.

L'évaluation par des experts de la précision du pronostic de l'algorithme sur l'échelle de 1 à 5 a généré un score moyen supérieur à 3,5 pour les deux algorithmes d'évaluation et de guidage. L'algorithme d'évaluation et de guidage a atteint le seuil de performances cibles pour valider les exigences de l'utilisateur et du système dans les études rétrospective et prospective destinées à la validation interne par EchoNous des performances de l'algorithme d'évaluation et de guidage.

En général, l'ensemble des données est considéré comme divers, car il est collecté par différents utilisateurs avec différents degrés de compétence (novice avec expérience médicale à cardiologue expert) et sur une population globale de sujets diverse.

Résumé des caractéristiques de l'ensemble de données utilisé pour développer l'outil d'étiquetage automatique abdominal

Une étude prospective a été menée pour évaluer les performances du système Kosmos. Algorithme d'étiquetage abdominal pour la validation des exigences de l'utilisateur et du système. Dans cette étude, 3 utilisateurs experts ont examiné 6 sujets et enregistré 146 clips, représentant 13 vues échographiques. Les étiquettes prévues sont vérifiées par 4 étiqueteurs pour l'évaluation de la performance de l'algorithme en deux parties : la partie détection d'objet et la partie pronostic de vue. Pour la partie détection d'objet, les étiqueteurs ont été d'accord avec l'algorithme pour 94,4 % des clips. Pour la partie pronostic de vue, la précision était de 96,4 %. Les deux sont supérieures au seuil cible de 80 %.

En outre, nous décomposons la performance de l'algorithme par vue et par structure. Une décomposition de la performance de l'algorithme par vue révèle que les pourcentages d'accord pour la détection d'objet et la précision du pronostic de vue sont plus élevés que le seuil de 80 % dans toutes les vues, sauf pour l'accord sur la détection d'objet dans la vue PSAX, dans laquelle le péricarde se situe trop près du VG et chevauche le VD dans certains cas. Pour régler ce problème, nous allons réduire la sensibilité de la détection du péricarde dans la vue PSAX pour réduire le risque. Une décomposition de la performance de l'algorithme par structure révèle que les pourcentages d'accord pour la détection des objets sont tous au-dessus de 80 % pour chaque structure détectée. Toutefois, nous n'avons pas été en mesure d'évaluer la vésicule biliaire et l'utérus en raison de contraintes dues à la conception de l'étude.

En résumé, l'algorithme de détection d'objet abdominal a atteint le seuil de performance cible pour valider les exigences de l'utilisateur et du système dans les études prospectives destinées à l'évaluation par EchoNous des performances de la détection d'objet abdominal.

En général, l'ensemble des données est considéré comme divers, car il est collecté par différents utilisateurs sur une population de sujets diverse.