AI Station

Kosmos

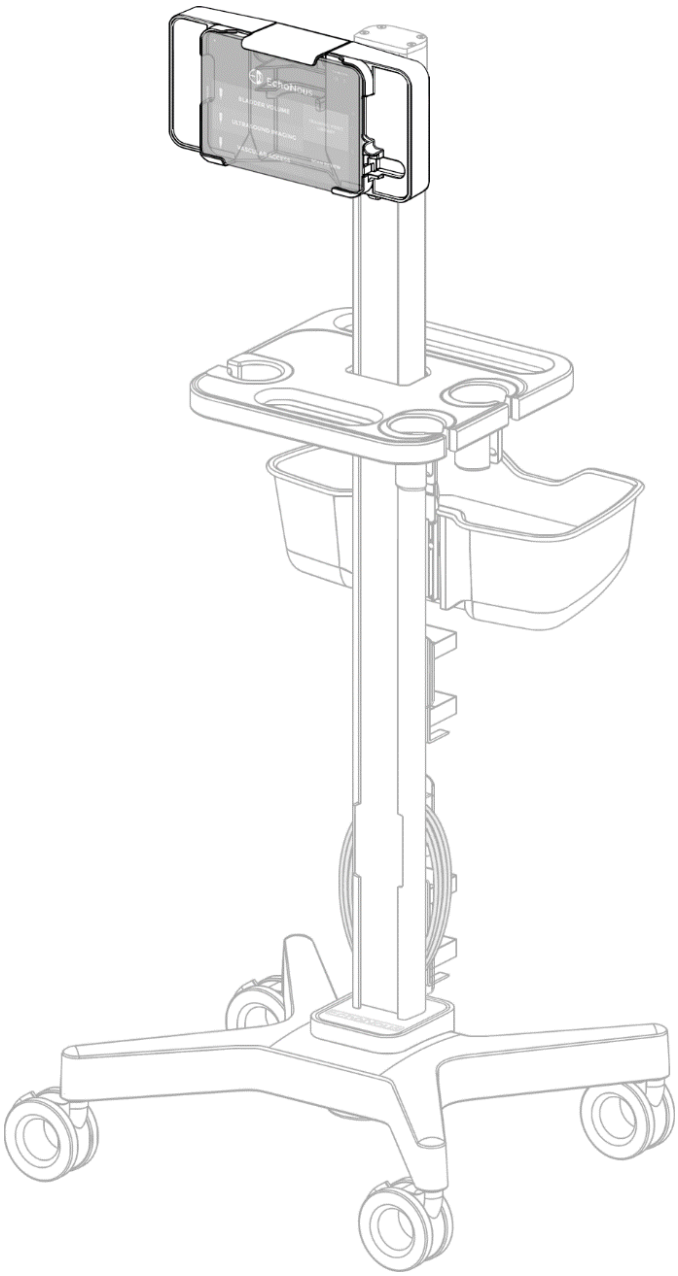

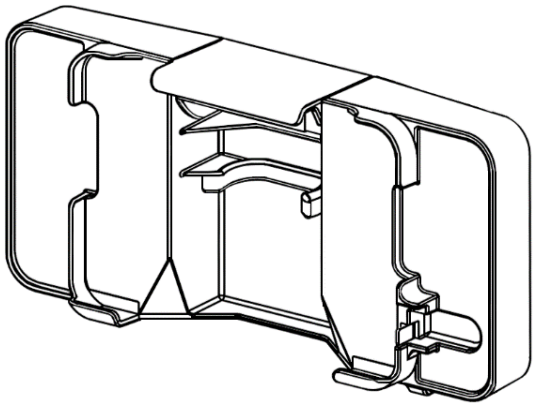

(4) M4 x 8mm ボタンヘッド Torx ネジ
（ボタンヘッドトルクスネジ）

(1) M3 x 8mm ボタンヘッド Torx ネジ

(1) T-10、(1) T-15、(1) T-20

(2) ケーブルクリップ

(2) M3.5 x 1.65 x 10mm ボタンヘッド Torx ネジ

タブレットマウントの円柱への取り付け

図のように、T20 Torx レンチを使用して、(4) M4 x 8mm ボタンヘッド Torx ネジで
タブレットマウントを固定します。

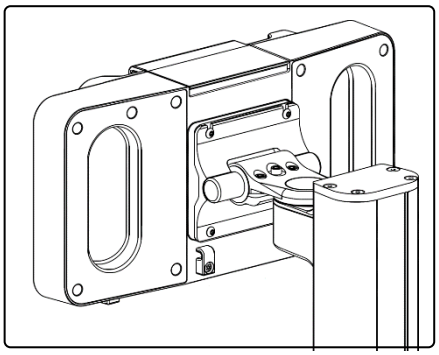

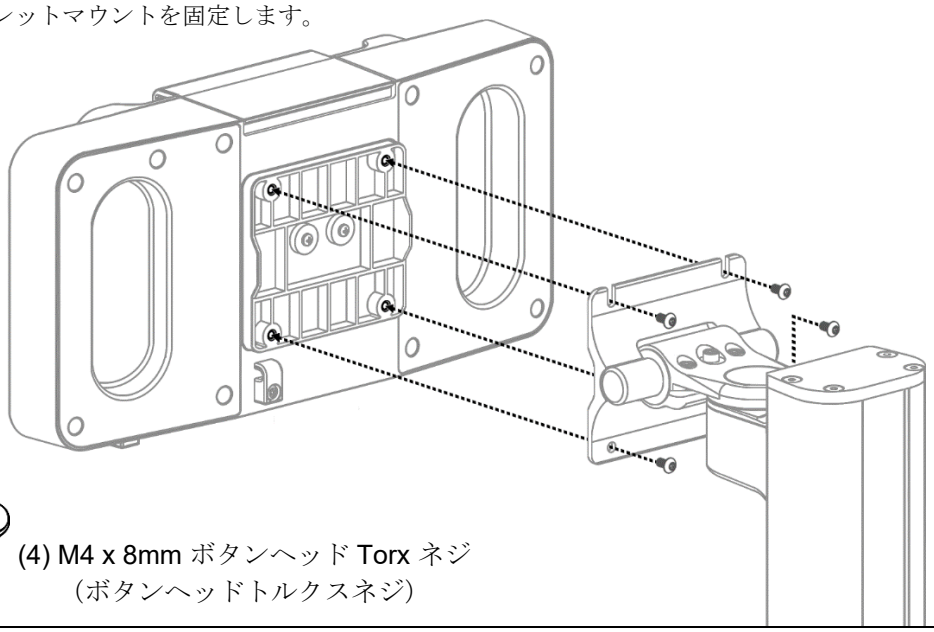

(4) M4 x 8mm ボタンヘッド Torx ネジ
（ボタンヘッドトルクスネジ）

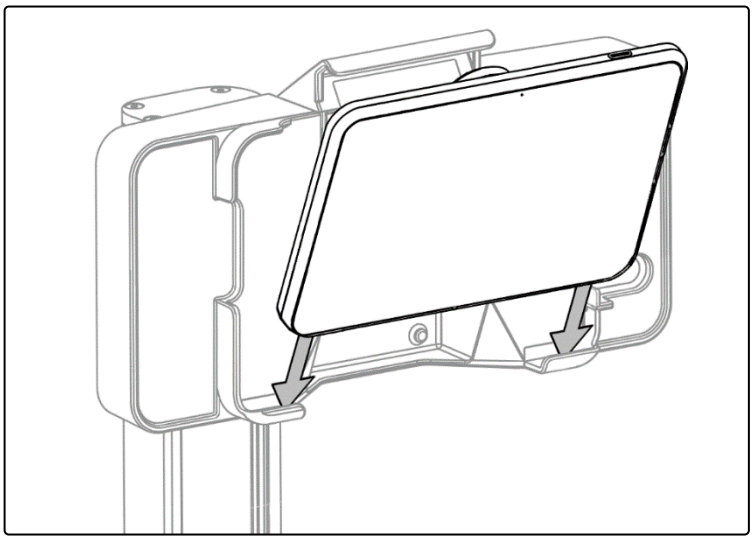

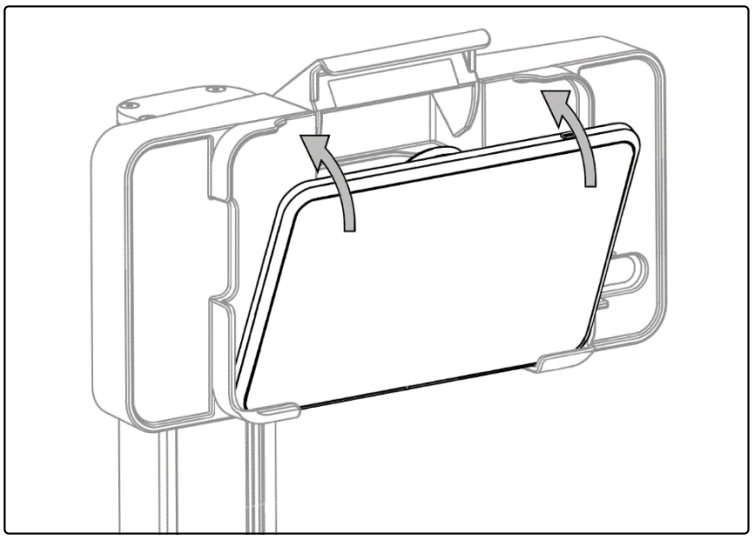

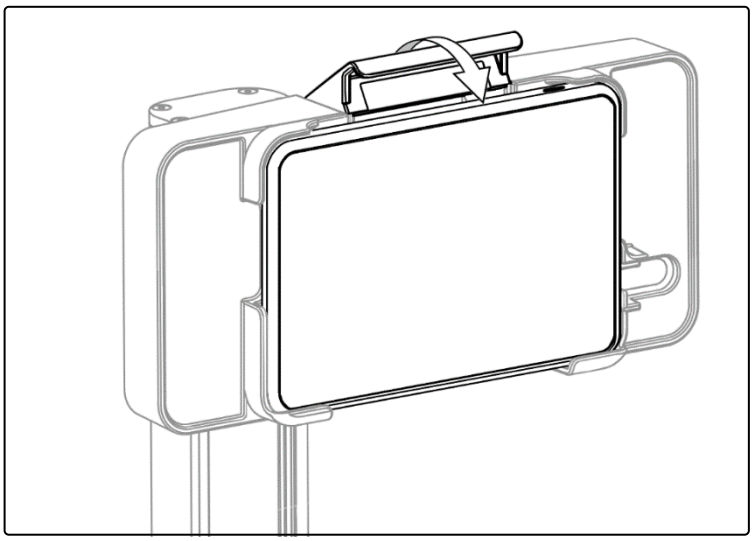

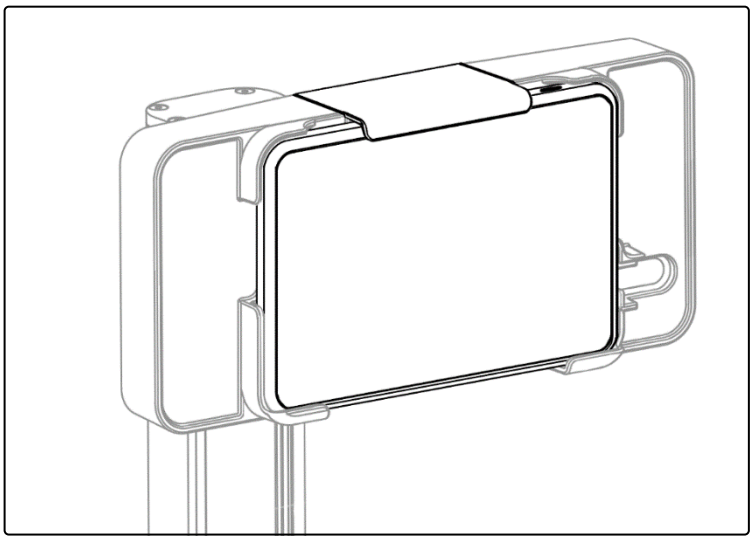

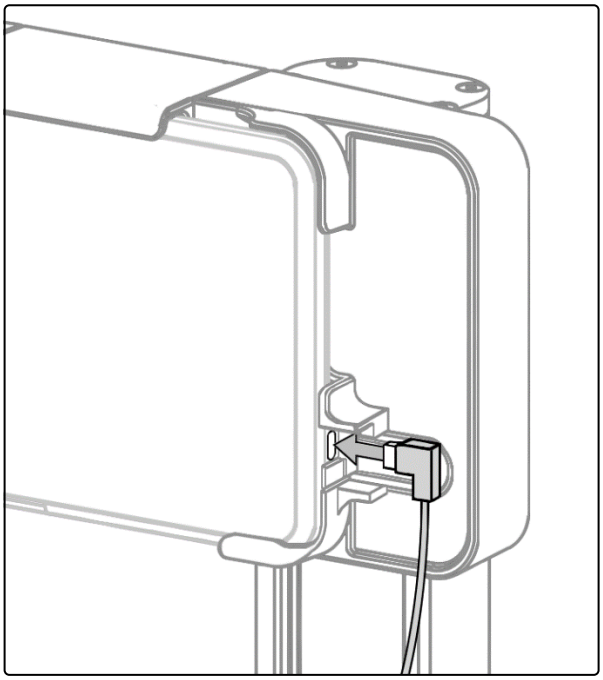

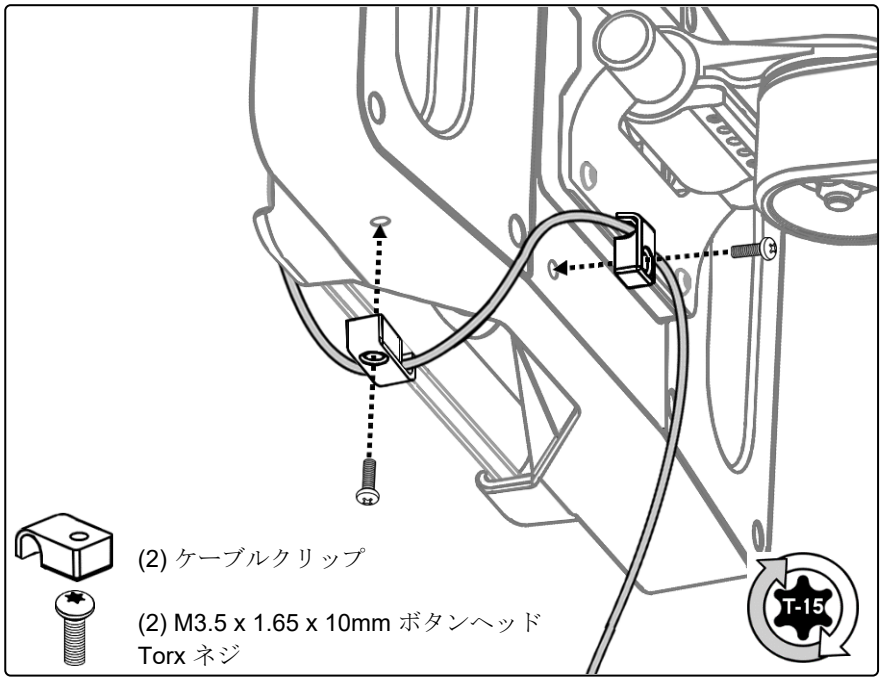
(2) ケーブルクリップ
(2) M3.5 x 1.65 x 10mm ボタンヘッド Torx ネジ
T-15

電源の取り付け

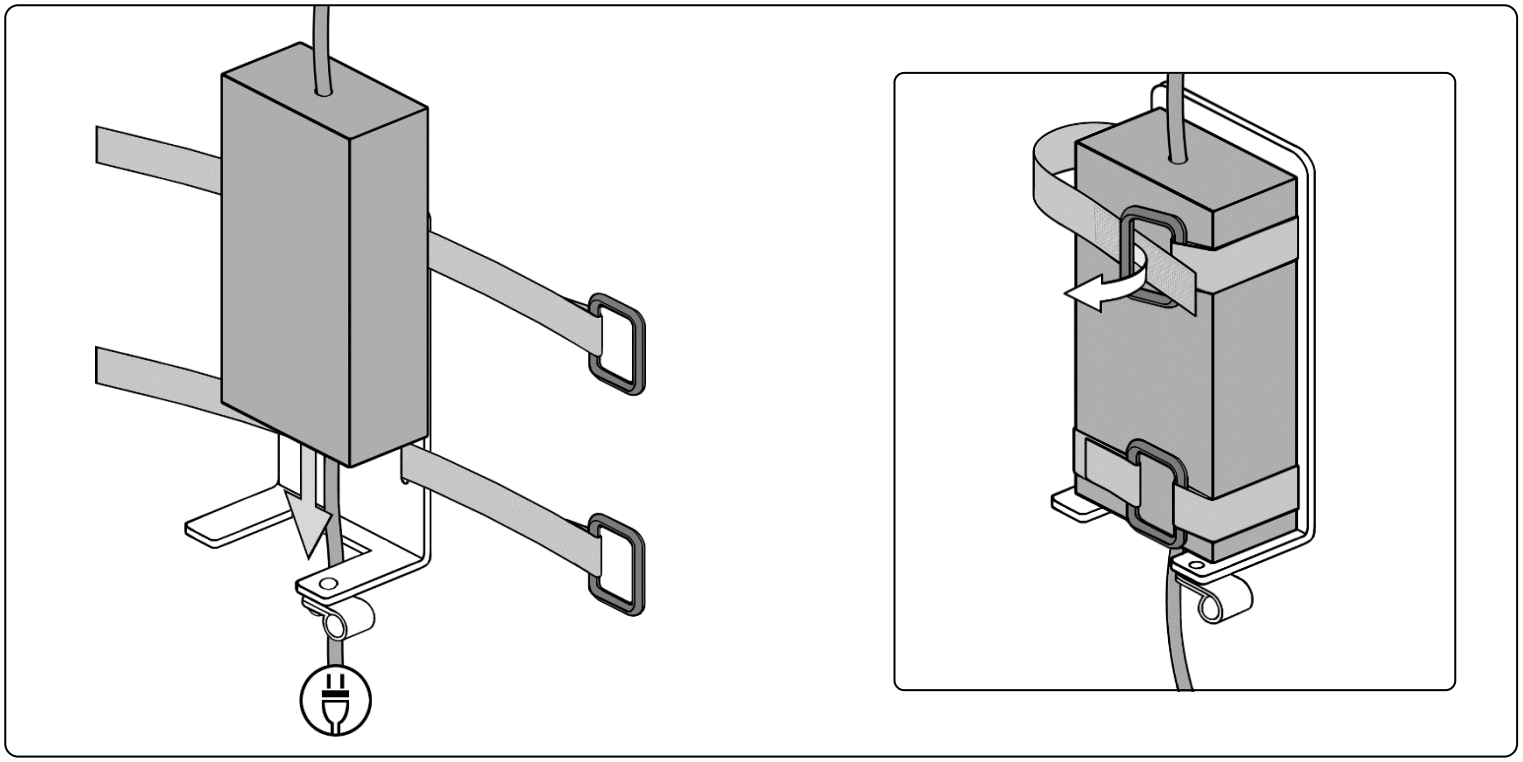

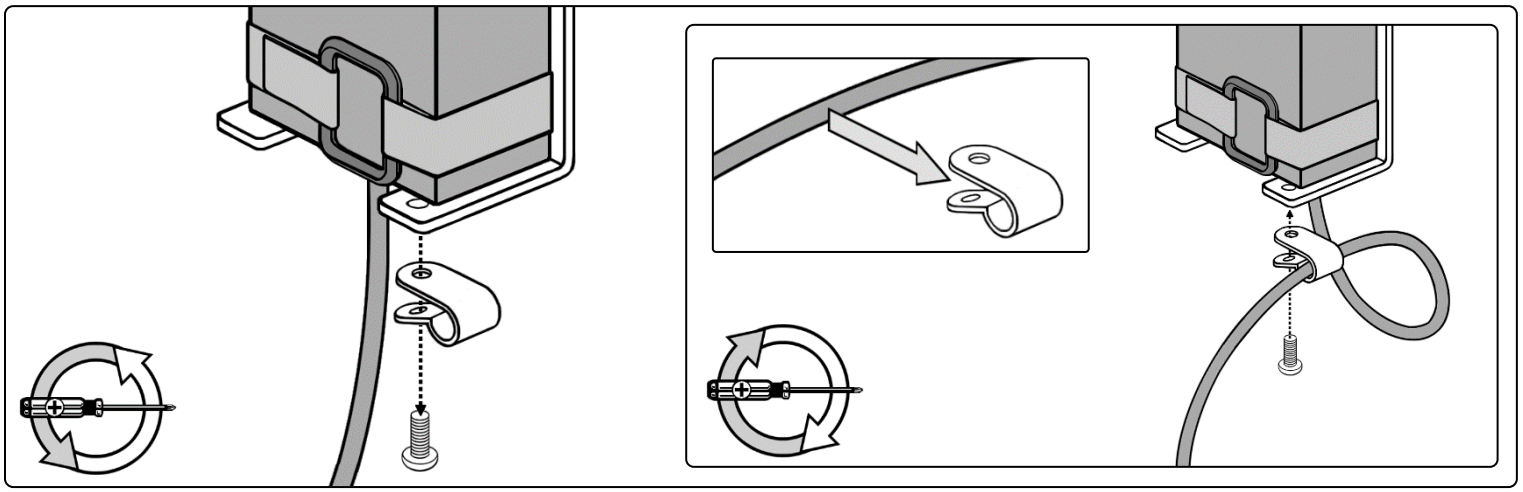

ケーブルルーティング

円柱のカットアウト

ケーブルを円柱の切り抜き部分からタブレットまで通します。

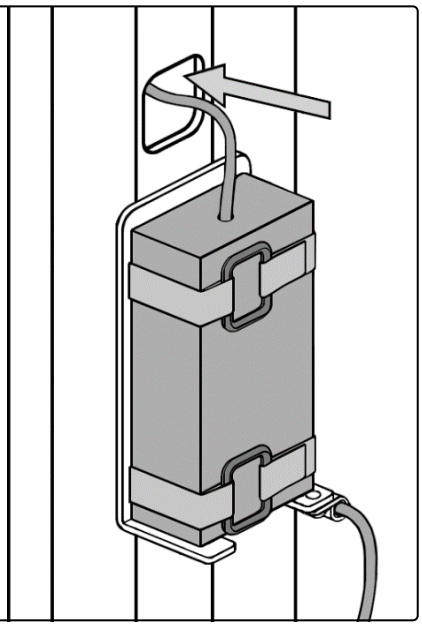

ケーブル留め具

電源コードをケーブル留め具に保管します。

ケーブルクリップ（カートに付属の粘着スタイル）

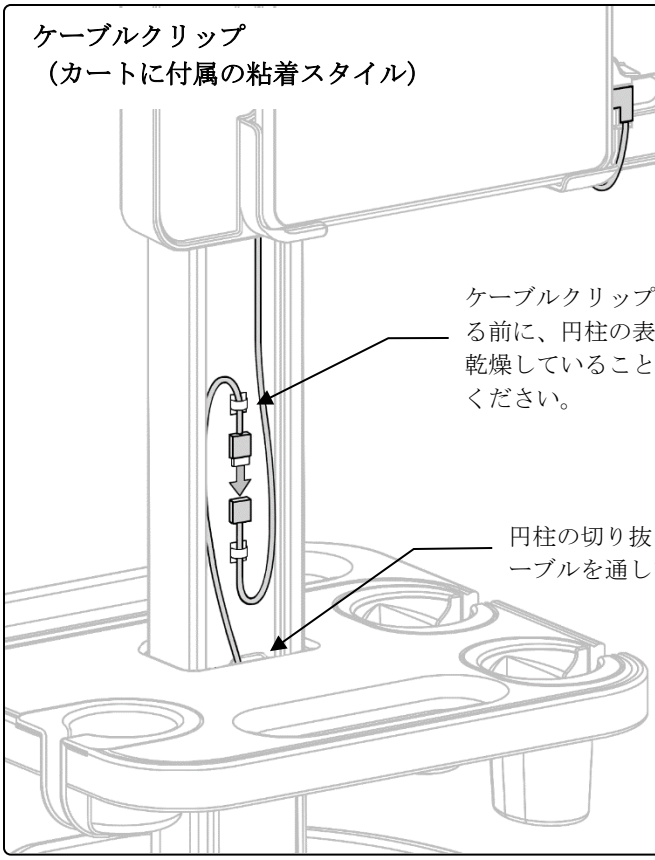

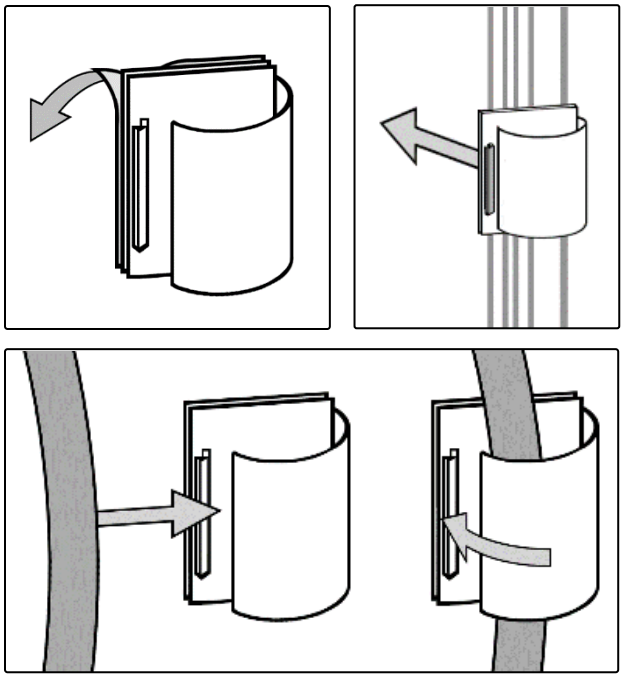

タブレットの取り外し

タブレット型ディスプレイ を取り外すには、取り外しボタン（マウントの背面にあります）を押します。タブレット型ディスプレイ を回転させて持ち上げ、マウントから外します。電源ケーブルは タブレット型ディスプレイ から自動的に切断されます。

取り外しボタンは、右側のハンドグリップエリア内の裏側にあります。

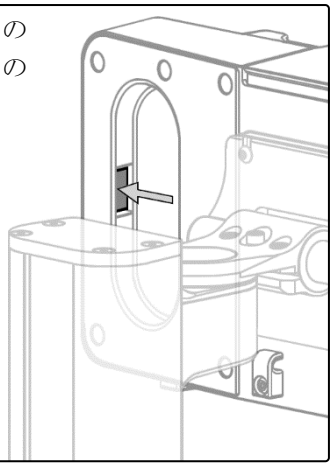

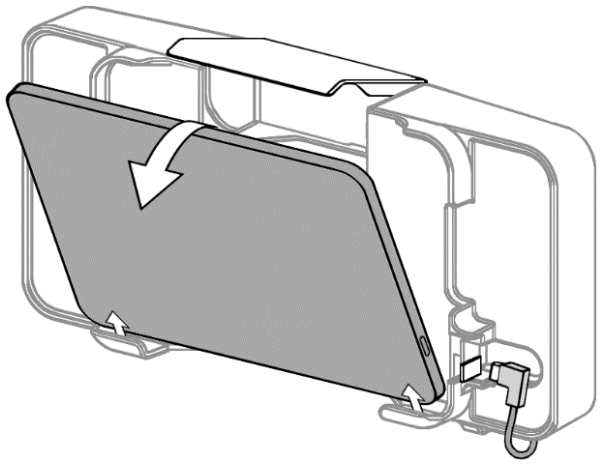

タブレット型ディスプレイ のロッキン

タブレット型ディスプレイ はタブレットホルダーの内側にロックする必要があります。タブレット型ディスプレイ を取り付けた後、以下に示すように、タブレットホルダーの背面から T-10 Torx ドライバーを使って (1) M3 x 8mm ボタンヘッド Torx ネジで留めます。これで取り外しボタンがロックされます。

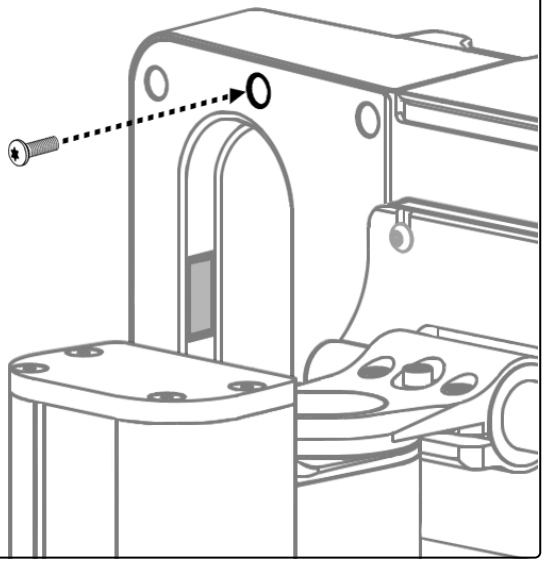

(1) M3 x 8mm ボタンヘッド Torx ネジ

一般的名称：汎用超音波画像診断装置（JMDN コード：40761000） 管理医療機器 特定保守管理医療機器 販売名：超音波画像診断装置 KOSMOS Series 認証番号：302AIBZI00008000 外国指定高度管理医療機器製造等事業者：ECHONOUS, INC.（米国） 選任製造販売業者： 有限会社ユーマンネットワーク